



# Меркурий-Интер-Лаб


НАШ ОПЫТ  
БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

ГОД ОСНОВАНИЯ  
1994 ГОД

отдел продаж+7 (831) 215-00-98  
горячая линия 8-800-200-10-16

[nn@mil-nn.ru](mailto:nn@mil-nn.ru)

[www.mil-nn.ru](http://www.mil-nn.ru)

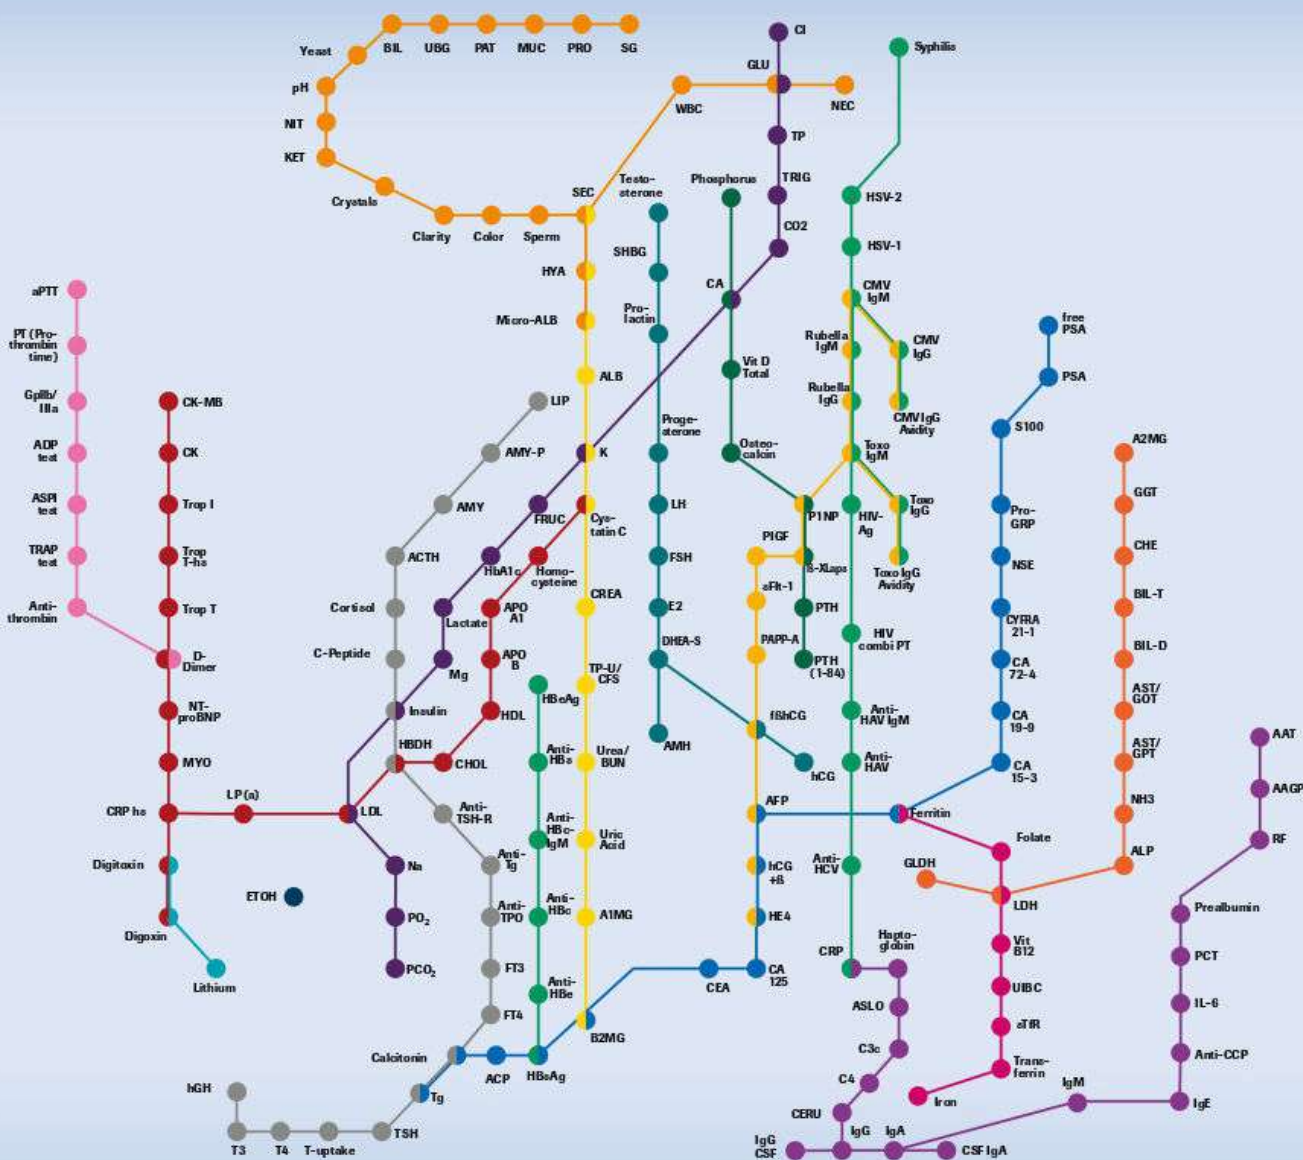

# Меркурий-Интер-Лаб

# Содержание



|  |          |
|--|----------|
| <b>Сывороточная рабочая зона</b> .....   | <b>3</b> |
| Реагенты для биохимического модуля <b>cobas</b> c702 .....   | 3        |
| Расходные материалы для биохимического модуля <b>cobas</b> c702 .....  | 6        |
| Реагенты для биохимического модуля <b>cobas</b> c501/502, и анализатора <b>cobas</b> c 311 .....                       | 8        |
| Расходные материалы для биохимического модуля <b>cobas</b> c501/502 и анализатора <b>cobas</b> c 311 .....             | 12       |
| Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора <b>Integra</b> 400plus .....                             | 14       |
| Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора <b>cobas</b> c111 .....                                  | 20       |
| Калибраторы и контрольные материалы для биохимических анализаторов <b>cobas</b> .....                                  | 23       |
| Таблица соответствия калибраторов и контрольных материалов для биохимических анализаторов <b>cobas</b> .....           | 25       |
| Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля <b>cobas</b> e601/602, анализатора <b>cobas</b> e411 ..... | 27       |
| Диагностика нарушений функции щитовидной железы .....  | 27       |
| Диагностика нарушений функции паращитовидной железы .....  | 28       |
| Диагностика эндокринных нарушений репродуктивной функции .....   | 28       |
| Диагностика и мониторинг беременности .....  | 30       |
| Диагностика нарушений роста .....  | 31       |
| Диагностика нарушений эндокринной функции поджелудочной железы .....   | 32       |
| Диагностика нарушений эндокринной функции надпочечников .....  | 32       |
| Диагностика онкологических заболеваний .....   | 33       |
| Диагностика инфекционных заболеваний .....   | 35       |
| Диагностика сердечно-сосудистой патологии .....  | 38       |
| Диагностика анемий .....   | 40       |
| Диагностика аллергических состояний .....  | 40       |
| Маркеры костного обмена .....  | 41       |
| Диагностика ревматоидного артрита .....  | 42       |
| Диагностика сепсиса .....  | 42       |
| Дополнительные растворы и разбавители проб .....   | 43       |
| Расходные материалы для анализатора <b>cobas</b> e411 .....  | 43       |
| Расходные материалы для анализаторов <b>cobas</b> e601, <b>Modular</b> E170 .....                                      | 44       |
| Таблица соответствия иммунохимических контрольных материалов .....   | 45       |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>Расходные материалы для преаналитических систем cobas p312, p512, p612</b> ..... | <b>49</b> |
|---|-----------|



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Реагенты и расходные материалы для анализаторов мочи</b> .....      | <b>50</b> |
| Реагенты и расходные материалы для <b>cobas</b> u 601 .....            | 50        |
| Реагенты и расходные материалы для <b>cobas</b> u 701 .....            | 50        |
| Реагенты и расходные материалы для <b>Urisys</b> 2400 .....            | 50        |
| Реагенты и расходные материалы для <b>cobas</b> u 411 .....            | 50        |
| Реагенты и расходные материалы для анализаторов серии «Мидитрон» ..... | 51        |
| Визуальные тест-полоски .....  | 51        |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Лабораторная экспресс-диагностика</b> .....                                   | <b>52</b> |
| Биохимический экспресс-анализатор Reflotron Plus .....                           | 52        |
| Анализатор функции тромбоцитов Multiplate Analyzer .....                         | 53        |
| Экспресс-тесты для бесприборного определения Тропонина Т .....                   | 54        |
| Иммунохимический портативный экспресс-анализатор <b>cobas</b> h 232 .....        | 55        |
| Профессиональная система для коагуляционного мониторинга CoaguChek Pro II .....  | 56        |
| Профессиональная система для коагуляционного мониторинга CoaguChek XS Plus ..... | 56        |
| Экспресс-анализатор биохимический портативный Accutrend Plus .....               | 56        |
| Система для анализа госпитальной глюкозы Accu-Chek Inform II .....               | 57        |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>Анализаторы газов крови и электролитов</b> .....               | <b>59</b> |
| Анализатор критических состояний <b>cobas</b> b 221 .....         | 59        |
| Анализаторы критических состояний <b>cobas</b> b 123 .....        | 61        |
| Анализаторы критических состояний <b>cobas</b> b 121 .....        | 64        |
| Анализаторы электролитов серии 91XX .....                         | 62        |
| Системы взятия крови для анализа электролитов и газов крови ..... | 64        |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Решения для самомониторинга</b> .....                           | <b>66</b> |
| Коагулометр портативный КоагуЧек ИксЭс (CoaguChek XS) .....        | 66        |
| Экспресс-анализатор биохимический портативный Accutrend Plus ..... | 66        |

# Сывороточная рабочая зона



## Реагенты для биохимического модуля cobas c702

### Ферменты

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка               | Примечание                  |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 05975905190 | <b>Acid Phosphatase</b><br>Кислая/простатическая фосфатаза                        | 4 x 200 тестов        |                             |
| 05166888190 | <b>Alkaline Phosphatase acc. to IFCC</b><br>Щелочная фосфатаза                    | 1050 тестов           | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05850797190 | <b>ALT IFCC</b><br>АЛТ  | 1100 тестов           | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05531462190 | <b>ALT IFCC with pyridoxal phosphate activation</b><br>АЛТ с пиридоксальфосфатом  | 780 тестов            | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05167027190 | <b>alpha-Amylase Gen.2</b><br>а-амилаза   | 750 тестов            | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05167035190 | <b>alpha-Amylase Pancreatic</b><br>Панкреатическая амилаза                        | 600 тестов            | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05850819190 | <b>AST IFCC</b><br>АСТ  | 1100 тестов           | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168503190 | <b>Cholinesterase Gen.2</b><br>Холинэстераза                                      | 650 тестов            | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168511190 | <b>Dibucaine</b><br>Дибукаиновое число  | 13 мл<br>(400 тестов) |                             |
| 05168546190 | <b>Creatine Kinase</b><br>Креатинкиназа   | 800 тестов            | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168562190 | <b>Creatine Kinase-MB</b><br>Креатинкиназа MB                                     | 600 тестов            | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168775190 | <b>Glutamyltransferase</b><br>ГГТ   | 1200 тестов           | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05975956190 | <b>GLDH Gen.3</b><br>Глутаматдегидрогеназа  | 3 x 120 тестов        |                             |
| 05480175190 | <b>Hydroxybutyrate Dehydrogenase Gen.2</b><br>ГБДГ (гидроксипутиратдегидрогеназа) | 500 тестов            |                             |
| 05169330190 | <b>Lactate Dehydrogenase acc. to IFCC</b><br>ЛДГ                                  | 750 тестов            | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 07041918190 | <b>Lipase colorimetric</b><br>Липаза  | 580 тестов            | 05172152190 Diluent NaCl 9% |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты для биохимического модуля cobas c702

### Субстраты

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка     | Примечание                  |
|-------------|--|-------------|-----------------------------|
| 05975573190 | <b>Albumin BCP</b><br>Альбумин в сыворотке                     | 400 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05166861190 | <b>Albumin BCG Gen.2</b><br>Альбумин                           | 750 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168384190 | <b>Bilirubin Direct Gen.2</b><br>Билирубин прямой              | 500 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05795419190 | <b>Bilirubin Total Gen.3</b><br>Билирубин общий                | 600 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168449190 | <b>Calcium Gen.2</b><br>Кальций                                | 2250 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168538190 | <b>Cholesterol Gen.2</b><br>Холестерин                         | 2100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 06407137190 | <b>Creatinine Jaffe Gen. 2</b><br>Креатинин Яффе               | 1500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168589190 | <b>Creatinine plus Gen.2</b><br>Креатинин плюс                 | 600 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171962190 | <b>Fructosamine</b><br>Фруктозамин                             | 250 тестов  |                             |
| 05168791190 | <b>Glucose HK Gen.3</b><br>Глюкоза                             | 2200 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05882095190 | <b>Glucose HK Gen.2</b><br>Глюкоза в гемолизате                | 500 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 07528582190 | <b>HDL-Cholesterol Gen.4</b><br>ЛПВП холестерин                | 500 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05169291190 | <b>Iron Gen.2</b><br>Железо                                    | 750 тестов  |                             |
| 06407358190 | <b>Magnesium Gen 2</b><br>Магний                               | 200 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171881190 | <b>Lactate Gen.2</b><br>Лактат                                 | 225 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 07005768190 | <b>LDL-Cholesterol Gen.3</b><br>ЛПНП холестерин                | 500 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05975581190 | <b>Ammonia</b><br>Аммиак                                       | 150 тестов  |                             |
| 05171377190 | <b>Phosphate (Inorganic) Gen.2</b><br>Фосфаты                  | 600 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171385190 | <b>Total Protein Gen.2</b><br>Общий белок                      | 700 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171954190 | <b>Total Protein Urine/CSF Gen.3</b><br>Общий белок в моче/ЦСЖ | 600 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171407190 | <b>Triglycerides</b><br>Триглицериды                           | 800 тестов  | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171857190 | <b>Uric Acid Gen.2</b><br>Мочевая кислота                      | 1000 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05975808190 | <b>Unsaturated Iron-Binding Capacity</b><br>НЖСС               | 300 тестов  |                             |
| 05171873190 | <b>Urea BUN</b><br>Мочевина                                    | 1900 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |



| Арт.№       | Наименование                   | Фасовка    | Примечание |
|-------------|--------------------------------|------------|------------|
| 05967104190 | <b>Ethanol Gen.2</b><br>Этанол | 300 тестов |            |
| 05841941190 | <b>Lithium</b><br>Литий        | 100 тестов |            |

#### Специфические белки

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание  |
|-------------|---|------------|---|
| 05167043190 | <b>Albumin Gen.2</b><br>Альбумин в моче   | 750 тестов | 05168376190 Antigen Excess Reagent (START)<br>05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05991960190 | <b>a1-Acid Glycoprotein Gen.2</b><br>alpha 1-кислый гликопротеин                                | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05991978190 | <b>a1-Antitrypsin Gen.2</b><br>alpha 1-антитрипсин  | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05950686190 | <b>Apolipoprotein A Gen.2</b><br>Аполипопротеин А   | 100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05950694190 | <b>Apolipoprotein B Gen.2</b><br>Аполипопротеин В   | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05219191190 | <b>Antistreptolysin O</b><br>Антистрептолизин О   | 400 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05950708190 | <b>Antithrombin</b><br>Антитромбин  | 100 тестов |   |
| 05950783190 | <b>b2-Microglobulin</b><br>beta2-микроглобулин  | 140 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05991986190 | <b>Complement C3c Gen.2</b><br>Комплемент С3с   | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05991994190 | <b>Complement C4 Gen.2</b><br>Комплемент С4   | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05950848190 | <b>Ceruloplasmin</b><br>Церулоплазмин   | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05950864190 | <b>C-Reactive Protein (Latex) High Sensitive</b><br>С-реактивный белок высокой чувствительности | 250 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05172373190 | <b>C-Reactive Protein Gen.3</b><br>С-реактивный белок   | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05172381190 | <b>D-Dimer Gen.2</b><br>Д-Димер   | 100 тестов |   |
| 05172390190 | <b>Ferritin Gen.4</b><br>Ферритин   | 650 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05992001190 | <b>Haptoglobin Gen.2</b><br>Гаптоглобин   | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05219205190 | <b>IgA Gen.2</b><br>Иммуноглобулин А  | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05220718190 | <b>IgG Gen.2</b><br>Иммуноглобулин G  | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05220726190 | <b>IgM Gen.2</b><br>Иммуноглобулин М  | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |
| 05992010190 | <b>Kappa Gen.2</b><br>Каппа цели  | 100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9%   |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты для биохимического модуля cobas c702

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание                  |
|-------------|---|------------|-----------------------------|
| 05992028190 | <b>Lambda Gen.2</b><br>Лямбда цепи  | 100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05950759190 | <b>Myoglobin Gen.2</b><br>Миоглобин                                       | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05950902190 | <b>Prealbumin</b><br>Преальбумин  | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05480167190 | <b>Rheumatoid Factors II</b><br>Ревматоидный фактор II                    | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05950821190 | <b>Soluble Transferrin Receptor</b><br>Растворимые рецепторы трансферрина | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05852633190 | <b>Lipoprotein (a) Gen.2</b><br>Липопротеин(а)                            | 100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05588855190 | <b>Transferrin Gen.2</b><br>Трансферрин                                   | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 06600263190 | <b>Cystatin C Gen.2</b><br>Цистатин С                                     | 225 тестов |                             |

## Расходные материалы для биохимического модуля cobas c702

### Дополнительные растворы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка             | Примечание     |
|-------------|---|---------------------|----------------|
| 05907543190 | <b>EcoTergent, cobas c 701/702</b><br>Экотергент  | 96 мл (с-пак)       |                |
| 04880285190 | <b>NaOH-D cell wash solution 1</b><br>Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки           | 2 x 1800 мл         |                |
| 04880307190 | <b>Acid wash cell wash solution 2</b><br>Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки | 2 x 1800 мл         |                |
| 05352991190 | <b>Sample Cleaner 1</b><br>Промывочный раствор 1  | 12 x 20 мл          | для c702, c502 |
| 05968828190 | <b>Sample Cleaner 2</b><br>Промывочный раствор 2  | 12 x 20 мл          | для c702, c502 |
| 05172128190 | <b>NAOHD Detergent 1</b><br>Промывочный раствор 1   | 102 мл (с-пак)      |                |
| 05172136190 | <b>SMS Detergent 2</b><br>Промывочный раствор 2   | 119 мл (с-пак)      |                |
| 05172152190 | <b>NaCl Diluent Cobas c pack</b><br>Дилуент NaCl 9%   | 119 мл (с-пак)      |                |
| 05168376190 | <b>Antigen Excess Reagen (START)</b><br>Старт (избыток антигена)                            | 11 мл               |                |
| 05172179190 | <b>Serum Index Gen.2</b><br>Сывороточные индексы  | 3000 тестов (с-пак) |                |



### Аксессуары

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка       | Примечание |
|-------------|---|---------------|------------|
| 10394246001 | <b>cobas sample cups (2 ml)</b><br>Пробирки для образцов (2 мл)                           | 5000 шт.      |            |
| 05085713001 | <b>Sample cups micro</b><br>Микропробирки   | 900 шт.       |            |
| 04740955001 | <b>cobas false bottom tube</b><br>Пробирки с фальшдном                                    | 2000 шт.      |            |
| 05353025190 | <b>cobas c pack MULTI</b><br>Контейнер реагентный для открытых каналов                    | 1 шт.         |            |
| 05463190001 | <b>Cup-adaptor for STD Rack</b><br>Адаптор для пробирок                                   | 260 шт.       |            |
| 04939719001 | <b>Reaction Cell Set for c701/c702 module</b><br>Реакционные кюветы для модулей c701/c702 | 4 x 406 кювет |            |

### Растворы и электроды для ион-селективного блока (ISE)

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка     | Примечание |
|-------------|---|-------------|------------|
| 03246353001 | <b>Cl Electrode</b><br>Cl-электрод  | 1 шт.       |            |
| 10825441001 | <b>K Electrode</b><br>K-электрод  | 1 шт.       |            |
| 10825468001 | <b>Na Electrode</b><br>Na-электрод  | 1 шт.       |            |
| 03149501001 | <b>Reference Electrode</b><br>Электрод референсный                            | 1 шт.       |            |
| 04880480190 | <b>ISE Diluent Gen.2</b><br>ISE Дилуэнт                                       | 2 x 2000 мл |            |
| 04880455190 | <b>ISE Internal Standard Gen.2</b><br>ISE Внутренний стандарт                 | 2 x 2000 мл |            |
| 10820652216 | <b>ISE Reference Electrode solution</b><br>Раствор для электрода референсного | 500 мл      |            |
| 11183982216 | <b>ISE Std High</b><br>Стандарт Высокий                                       | 10 x 3 мл   |            |
| 11183974216 | <b>ISE Std Low</b><br>Стандарт Низкий   | 10 x 3 мл   |            |
| 11298500316 | <b>ISE Cleaning Solution</b><br>Раствор моющих                                | 5 x 100 мл  |            |
| 04663632190 | <b>Activator</b><br>Активатор   | 9 x 12 мл   |            |

# Сывороточная рабочая зона

Реагенты для биохимического модуля cobas c501/502 и анализатора cobas c 311

## Ферменты

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка  | Примечание                                     |
|-------------|---|--|--|
| 04375351190 | <b>Acid Phosphatase</b><br>Фосфатаза кислая   | 8 x 17 мл,<br>8 x 17 мл, 4 x 17 мл,<br>2 x 10 мл | Multi pack 04593138190<br>на «открытом канале» |
| 03333701190 | <b>ALP IFCC Large</b><br>Щелочная Фосфатаза (большая упаковка)                                  | 400 тестов                                       |  |
| 03333752190 | <b>ALP IFCC Small</b><br>Щелочная Фосфатаза (малая упаковка)                                    | 200 тестов                                       |  |
| 20764957322 | <b>ALT IFCC</b><br>Аланиновая трансаминаза  | 500 тестов                                       |  |
| 04467388190 | <b>ALT IFCC with pyridoxal phosphate activation</b><br>АЛТ с активацией пиридоксальфосфатом     | 275 тестов                                       | 04489357190 Diluent NaCl 9%                    |
| 03183742122 | <b>alfa-Amylase EPS</b><br>Амилаза  | 300 тестов                                       |  |
| 20766623322 | <b>alfa-Amylase EPS Pancreatic</b><br>Амилаза панкреатическая                                   | 200 тестов                                       |  |
| 20764949322 | <b>AST IFCC</b><br>Аспарагиновая трансаминаза   | 500 тестов                                       |  |
| 04467493190 | <b>AST IFCC with pyridoxal phosphate activation 425</b><br>АСТ с активацией пиридоксальфосфатом | 425 тестов                                       | 04489357190 Diluent NaCl 9%                    |
| 04498577190 | <b>Cholinesterase Gen.2</b><br>Холинэстераза  | 200 тестов                                       |  |
| 07190794190 | <b>Creatine Kinase</b><br>Креатинкиназа   | 200 тестов                                       |  |
| 07190808190 | <b>Creatine Kinase-MB</b><br>Креатинкиназа-MB   | 100 тестов                                       |  |
| 03002721122 | <b>GGT IFCC</b><br>Гамма-Глутамилтрансфераза  | 400 тестов                                       |  |
| 03004732122 | <b>LDH IFCC</b><br>Лактатдегидрогеназа  | 300 тестов                                       | 04489357190 Diluent NaCl 9%                    |
| 03029590322 | <b>Lipase</b><br>Липаза   | 200 тестов                                       |  |
| 05385415190 | <b>Homocysteine</b><br>Гомоцистеин  | 100 тестов                                       | 04489357190 Diluent NaCl 9%                    |





## Субстраты

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание  |
|-------------|---|------------|---|
| 03183688122 | <b>Albumin BCG</b><br>Альбумин в сыворотке                        | 300 тестов |   |
| 20766682322 | <b>NH3L / Ammonia</b><br>Аммоний                                  | 150 тестов |   |
| 05795397190 | <b>Bilirubin Total Gen.3</b><br>Общий билирубин                   | 250 тестов |   |
| 05589061190 | <b>Bilirubin Direct Gen.2</b><br>Прямой билирубин                 | 350 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%                                   |
| 03289923190 | <b>CO2-L / Bicarbonate</b><br>Двуокись углерода                   | 250 тестов |   |
| 05061482190 | <b>Calcium Gen.2</b><br>Кальций                                   | 300 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%                                   |
| 04810716190 | <b>Creatinine Jaffe Gen.2</b><br>Креатинин Яффе                   | 700 тестов |   |
| 03263991190 | <b>Creatinin PAP</b><br>Креатинин ферментативный                  | 250 тестов |   |
| 03039773190 | <b>Cholesterol</b><br>Холестерин                                  | 400 тестов |   |
| 07528566190 | <b>HDL-Cholesterol Gen.4</b><br>ЛПВП холестерин                   | 350 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%                                   |
| 07005717190 | <b>LDL-Cholesterol Gen.3</b><br>ЛПНП холестерин                   | 200 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%                                   |
| 03183777190 | <b>Ethanol</b><br>Этанол  | 100 тестов |   |
| 04537939190 | <b>Fructosamine</b><br>Фруктозамин                                | 150 тестов |   |
| 04404483190 | <b>Glucose HK</b><br>Глюкоза                                      | 800 тестов |   |
| 20767131322 | <b>Glucose HK</b><br>Глюкоза в гемолизате                         | 200 тестов | Для гемолизата: Glucose Hemolyzing Reagent Gen. 2 05067235191 |
| 05067235191 | <b>Hemolyzing reagent Gen.2</b><br>Реагент лизирующий для глюкозы | 1000 мл    |   |
| 03183700190 | <b>Lactate</b><br>Лактат  | 100 тестов |   |
| 04679598190 | <b>Lithium</b><br>Литий   | 100 тестов |   |
| 03183696122 | <b>Iron Gen.2</b><br>Железо                                       | 200 тестов |   |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты для биохимического модуля cobas c501/502 и анализатора cobas c 311

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка    | Примечание                  |
|-------------|--|------------|-----------------------------|
| 06481647190 | <b>Magnesium Gen.2</b><br>Магний   | 250 тестов |                             |
| 03183793122 | <b>Phosphate Gen.2</b><br>Фосфор   | 250 тестов |                             |
| 03183734190 | <b>Total Protein Gen.2</b><br>Общий белок  | 300 тестов |                             |
| 20767107322 | <b>Triglycerides</b><br>Триглицериды   | 250 тестов |                             |
| 04536355190 | <b>Unsaturated Iron Binding Capacity</b><br>Ненасыщенная железосвязывающая способность | 100 тестов |                             |
| 04460715190 | <b>UREAL</b><br>Мочевина   | 500 тестов |                             |
| 03183807190 | <b>Uric Acid</b><br>Мочевая кислота  | 400 тестов |                             |
| 03333825190 | <b>Total protein in Urine Gen.3</b><br>Общий белок в моче                              | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |

### Специфические белки

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка       | Примечание  |
|-------------|---|---------------|---|
| 04469658190 | <b>Albumin</b><br>Альбумин в моче                                   | 100 тестов    |   |
| 03005771322 | <b>Alfa1 Antitripsin Gen.2</b><br>Альфа-1-антитрипсин               | 100 тестов    | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 03333795190 | <b>Alfa1 acid glycoprotein Gen.2</b><br>Альфа-1-кислый гликопротеин | 100 тестов    | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 04489403190 | <b>Antistreptolisin O</b><br>Антистрептолизин O                     | 150 тестов    | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 03032566122 | <b>Apo A1</b><br>Аполипопротеин A                                   | 100 тестов    | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 03032574122 | <b>Apo B</b><br>Аполипопротеин B                                    | 100 тестов    | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 03036081122 | <b>Antitrombin III</b><br>Антитромбин III                           | 100 тестов    | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 11660551216 | <b>b2-Microglobulin</b><br>beta2-микροглобулин                      | 2 x 70 тестов | Калибратор входит в набор Multi pack 04593138190 на «открытом канале» Diluent NaCl 9% 04489357190 |
| 04956842190 | <b>C-Reactive Protein Gen.3</b><br>С-реактивный белок               | 250 тестов    | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |



| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание  |
|-------------|---|------------|---|
| 20764930322 | <b>C-Reactive Proteine Latex</b><br>С-реактивный белок (латекс) (не для с502) | 300 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 04628918190 | <b>CPR High Sensitive</b><br>С-реактивный белок высокочувствительный          | 300 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 03001938322 | <b>Complement C3c Gen.2</b><br>Комплемент С3                                  | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 03001962322 | <b>Complement C4 Gen.2</b><br>Комплемент С4                                   | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 20764663322 | <b>Ceruloplasmin</b><br>Церулоплазмин   | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 04912551190 | <b>D-Dimer Gen.2</b><br>Д-Димер   | 100 тестов |   |
| 04885317190 | <b>Ferritin Gen.4</b><br>Ферритин   | 250 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 03005593322 | <b>Haptoglobin Gen.2</b><br>Гаптоглобин                                       | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 05336163190 | <b>Hemoglobin A1c Gen.3</b><br>Гликированный гемоглобин ген.3                 | 150 тестов | Hemolyzing Reagent Gen.<br>04528182190 HbA1c<br>Для ручной пробоподготовки<br>Hemolyzing Reagent<br>11488457122 |
| 04528182190 | <b>HbA1c Tina-Quant hemolyzing reagent</b><br>Лизирующий реагент (в кассете)  | 51 мл      |   |
| 11488457122 | <b>Hemolysing reagent HbA1c</b><br>Реагент гемолизирующий для HbA1c           | 1000 мл    |   |
| 03507343190 | <b>IgA Gen.2</b><br>Иммуноглобулин А  | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 03507432190 | <b>IgG Gen.2</b><br>Иммуноглобулин G  | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 03507190190 | <b>IgM Gen.2</b><br>Иммуноглобулин М  | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 05852625190 | <b>Lipoprotein (a) Gen.2</b><br>Липопротеин(а)                                | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 04580010190 | <b>Myoglobin Gen.2</b><br>Миоглобин   | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 20764655322 | <b>Prealbumin</b><br>Преальбумин  | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |
| 20764574322 | <b>Rheumatoid Factors</b><br>Ревматоидный фактор                              | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%   |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты для биохимического модуля cobas c501/502 и анализатора cobas c 311

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка    | Примечание                  |
|-------------|--|------------|-----------------------------|
| 03015050122 | <b>Transferrin Gen.2</b><br>Трансферрин                                    | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 20763454122 | <b>Soluble Transferrin Receptors</b><br>Растворимые рецепторы трансферрина | 80 тестов  | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 06600239190 | <b>Cystatin C Gen.2</b><br>Цистатин С                                      | 225 тестов |                             |

## Расходные материалы для биохимического модуля cobas c501/502 и анализатора cobas c 311

### Дополнительные растворы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка              | Примечание                            |
|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| 06544410190 | <b>EcoTergent, cobas c 501/502</b><br>Экотергент, cobas c501/502                              | 12 x 59 мл           |                                       |
| 05422485190 | <b>EcoTergent, cobas c 311</b><br>Экотергент, cobas c 311                                     | 60 мл (c-pack)       |                                       |
| 04880285190 | <b>NaOH-D cell wash solution 1</b><br>Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки             | 2 x 1800 мл          |                                       |
| 04880307190 | <b>Acid wash - cell wash solution 2</b><br>Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки | 2 x 1800 мл          |                                       |
| 04708725190 | <b>Sample Cleaner 1 NaOH Multiclean</b><br>(не для 502) Промывочный раствор 1                 | 12 x 59 мл           | для c502 05352991190 Sample Cleaner 1 |
| 05958024190 | <b>Sample Cleaner 2</b><br>(не для 502) Промывочный раствор 2                                 | 12 x 68 мл           | для c502 05968828190 Sample Cleaner 2 |
| 04489241190 | <b>NAOHD Detergent 1</b><br>Промывочный раствор 1   | 66 мл                |                                       |
| 04489225190 | <b>SMS Detergent 2</b><br>Промывочный раствор 2   | 50 мл (c-pack)       |                                       |
| 04489357190 | <b>NaCl Diluent Cobas c pack</b><br>Дилуэнт NaCl 9%   | 50 мл (c-pack)       |                                       |
| 04880994190 | <b>SCCS</b><br>Раствор для спец. промывки кювет   | 50 мл (c-pack)       |                                       |
| 05168376190 | <b>Antigen Excess Reagen (START)</b><br>Старт (избыток антигена)                              | 11 мл                |                                       |
| 04489365190 | <b>Serum Index</b><br>Сывороточные индексы  | 2750 тестов (c-pack) |                                       |



### Аксессуары

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 10394246001 | <b>cobas sample cups (2 ml)</b><br>Пробирки для образцов (2 мл)                   | 5000 шт.     |            |
| 05085713001 | <b>Sample cups micro</b><br>Микропробирки   | 900 шт.      |            |
| 04740955001 | <b>cobas false bottom tube,</b><br>Пробирки с фальшдном                           | 2000 шт.     |            |
| 04593138190 | <b>cobas c pack MULTI</b><br>Контейнер реагентный для открытых каналов            | 1 шт.        |            |
| 05463190001 | <b>Cup-adaptor for STD Rack</b><br>Адаптор для пробирок                           | 260 шт.      |            |
| 04854241001 | <b>Reaction Cell Set for c 501/502</b><br>Реакционные кюветы для модулей с501/502 | 24 сегмента  |            |
| 04555040001 | <b>Reaction Cell Set c 311</b><br>Реакционные кюветы для с 311                    | 18 сегментов |            |

### Растворы и электроды для ион-селективного блока (ISE)

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание |
|-------------|---|------------|------------|
| 03246353001 | <b>Cl Electrode</b><br>Cl-электрод  | 1 шт.      |            |
| 10825441001 | <b>K Electrode</b><br>K-электрод  | 1 шт.      |            |
| 10825468001 | <b>Na Electrode</b><br>Na-электрод  | 1 шт.      |            |
| 03149501001 | <b>Reference Electrode</b><br>Электрод референсный                            | 1 шт.      |            |
| 04522630190 | <b>ISE Diluent</b><br>Дилуэнт   | 5 x 300 мл |            |
| 04522320190 | <b>ISE Internal standard</b><br>Стандарт внутренний                           | 5 x 600 мл |            |
| 11360981216 | <b>ISE Reference Electrode solution</b><br>Раствор для электрода референсного | 5 x 300 мл |            |
| 11183982216 | <b>ISE Std High</b><br>Стандарт Высокий                                       | 10 x 3 мл  |            |
| 11183974216 | <b>ISE Std Low</b><br>Стандарт Низкий   | 10 x 3 мл  |            |
| 11298500316 | <b>ISE Cleaning Solution</b><br>Раствор моющих                                | 5 x 100 мл |            |
| 04663632190 | <b>Activator</b><br>Активатор   | 9 x 12 мл  |            |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Integra 400 Plus

### Ферменты

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка  | Примечание  |
|-------------|---|--|---|
| 04375351190 | <b>ACP (Acid Phosphatase)</b><br>Фосфатаза кислая                   | 8 x 17 мл,<br>8 x 17 мл, 4 x 17 мл, 2<br>x 10 мл | необходима кассета Multi pack<br>04593138190,<br>на «открытом канале» |
| 03333752190 | <b>ALP IFCC Small</b><br>Щелочная фосфатаза (малая упаковка)        | 200 тестов                                       |   |
| 03333701190 | <b>ALP IFCC Large</b><br>Щелочная фосфатаза (большая упаковка)      | 400 тестов                                       |   |
| 20764957322 | <b>ALT IFCC</b><br>АЛТ  | 500 тестов                                       |   |
| 03183742122 | <b>alfa-Amylase EPS</b><br>альфа-Амилаза                            | 300 тестов                                       |   |
| 20766623322 | <b>alfa-Amylase EPS Pancreatic</b><br>альфа-Амилаза панкреатическая | 200 тестов                                       |   |
| 20764949322 | <b>AST IFCC</b><br>АСТ  | 500 тестов                                       |   |
| 04498577190 | <b>Cholinesterase Gen. 2</b><br>Холинэстераза                       | 200 тестов                                       |   |
| 07190794190 | <b>Creatine Kinase</b><br>Креатинкиназа                             | 200 тестов                                       |   |
| 07190808190 | <b>Creatine Kinase MB</b><br>Креатинфосфокиназа MB                  | 100 тестов                                       |   |
| 03002721122 | <b>GGT</b><br>Гамма-глутамилтрансфераза                             | 400 тестов                                       |   |
| 03004732122 | <b>LDH IFCC</b><br>Лактатдегидрогеназа (лактат->пируват)            | 300 тестов                                       | Diluent NaCl 9%<br>20756350322  |
| 03029590322 | <b>Lipase</b><br>Липаза (колориметрический метод)                   | 200 тестов                                       |   |
| 05385415190 | <b>Homocysteine</b><br>Гомоцистеин                                  | 100 тестов                                       | Diluent NaCl 9%<br>20756350322  |

### Субстраты

| Арт.№       | Наименование                                    | Фасовка    | Примечание                     |
|-------------|---|------------|--------------------------------|
| 03183688122 | <b>Albumin BCG</b><br>Альбумин (в сыворотке)    | 300 тестов |                                |
| 20766682322 | <b>Ammonia</b><br>Аммоний                       | 150 тестов |                                |
| 03289923190 | <b>Bicarbonate</b><br>Бикарбонат                | 250 тестов |                                |
| 05795397190 | <b>Bilirubin Total Gen.3</b><br>Билирубин общий | 250 тестов |                                |
| 05589061190 | <b>Bilirubin Direct</b><br>Билирубин прямой     | 350 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 05061482190 | <b>Calcium Gen. 2</b><br>Кальций                | 300 тестов |                                |



| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание   |
|-------------|---|------------|--|
| 04810716190 | <b>Creatinine Jaffe Gen. 2</b><br>Креатинин Яффе  | 700 тестов |  |
| 03263991190 | <b>Creatinine PAP</b><br>Креатинин (энзиматический)                                       | 250 тестов |  |
| 03039773190 | <b>Cholesterol</b><br>Холестерин  | 400 тестов |  |
| 03183777190 | <b>Ethanol</b><br>Этанол  | 100 тестов |  |
| 07528566190 | <b>HDL-Cholesterol Gen. 4</b><br>ЛПВП холестерин  | 350 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322                                       |
| 07005717190 | <b>LDL-Cholesterol Gen. 3</b><br>ЛПНП холестерин  | 200 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322                                       |
| 04537939190 | <b>Fructosamine</b><br>Фруктозамин  | 150 тестов |  |
| 04404483190 | <b>Glucose HK 800</b><br>Глюкоза  | 800 тестов |  |
| 20767131322 | <b>Glucose HK 200</b><br>Глюкоза (в гемолизате)   | 200 тестов | Для гемолизата: Glucose<br>Hemolyzing Reagent Gen. 2<br>05067235 191 |
| 05067235191 | <b>Hemolyzing reagent</b><br>Реагент лизирующий (для глюкозы)                             | 1000 мл    |  |
| 03183700190 | <b>Lactate</b><br>Лактат  | 100 тестов |  |
| 03183696122 | <b>Iron Gen. 2</b><br>Железо  | 200 тестов |  |
| 04536355190 | <b>Unsaturated Iron Binding Capacity</b><br>Ненасыщенная железосвязывающая<br>способность | 100 тестов |  |
| 06481647190 | <b>Magnesium Gen.2</b><br>Магний  | 250 тестов |  |
| 03183793122 | <b>Phosphate Gen. 2</b><br>Фосфор   | 250 тестов |  |
| 03333825190 | <b>Total protein in Urine Gen. 3</b><br>Общий белок (в моче)                              | 150 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322                                       |
| 03183734190 | <b>Total Protein Gen. 2</b><br>Общий белок  | 300 тестов |  |
| 20767107322 | <b>Triglycerides</b><br>Триглицериды  | 250 тестов |  |
| 04460715190 | <b>UREAL</b><br>Мочевина  | 500 тестов |  |
| 03183807190 | <b>Uric Acid</b><br>Мочевая кислота   | 400 тестов |  |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Integra 400 Plus

### Специфические белки

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание   |
|-------------|---|------------|--|
| 04469658190 | <b>Tina-Quant Albumin Gen. 2</b><br>Альбумин в моче                             | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 03005771322 | <b>Tina-Quant alfa1 Antitripsin Gen. 2</b><br>Альфа-1-антитрипсин               | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 03333795190 | <b>Tina-Quant alfa1 acid glycoprotein Gen. 2</b><br>Альфа-1-кислый гликопротеин | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 03032566122 | <b>Tina-Quant Apo A1</b><br>Аполипопротеин А                                    | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 03032574122 | <b>Tina-Quant Apo B</b><br>Аполипопротеин В                                     | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 20750948322 | <b>Antistreptolisin O</b><br>Антистрептолизин О                                 | 100 тестов |  |
| 03036081122 | <b>Antitrombin III</b><br>Антитромбин   | 100 тестов |  |
| 04912551190 | <b>Tina-Quant D-Dimer Gen.2</b><br>Д-димер                                      | 100 тестов |  |
| 03005593322 | <b>Tina-Quant Haptoglobin Gen.2</b><br>Гаптоглобин                              | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 05336163190 | <b>Tina-Quant Hemoglobin A1c Gen.3</b><br>Гликированный гемоглобин ген. 3       | 150 тестов | Hemolyzing Reagent Gen. 2<br>04528328190, для ручной<br>пробоподготовки Hemolyzing<br>Reagent 11488457122                              |
| 04528328190 | <b>Hemolyzing reagent HbA1c</b><br>Реагент лизирующий (для HbA1c)               | 6 x 10 мл  |  |
| 11488457122 | <b>Hemolysing reagent HbA1c</b><br>Реагент гемолизирующий для HbA1c             | 1000 мл    |  |
| 20737755322 | <b>IGA</b><br>Иммуноглобулин А  | 100 тестов | Калибровка Serumproteins<br>T Standard 20737267<br>322, NaCl Diluent 9%<br>20756350322, Accelerator<br>I 2072 1867 322 (для педиатрии) |
| 20766631322 | <b>IGG</b><br>Иммуноглобулин G  | 100 тестов | Калибровка Serumproteins<br>T Standard 20737267<br>322, NaCl Diluent 9%<br>20756350322, Accelerator<br>I 2072 1867 322 (для педиатрии) |
| 20737771322 | <b>IGM</b><br>Иммуноглобулин М  | 100 тестов | Калибровка Serumproteins<br>T Standard 20737267<br>322, NaCl Diluent 9%<br>20756350322, Accelerator<br>I 2072 1867 322 (для педиатрии) |
| 05852625190 | <b>Lipoprotein (a) Gen.2</b><br>Липопротеин(а)                                  | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9%  |





| Арт.№       | Наименование   | Фасовка     | Примечание   |
|-------------|--|-------------|--|
| 20721867322 | <b>Accelerator I</b><br>Акселератор  | 100 мл      |  |
| 03001938322 | <b>Tina-Quant Complement C3c Gen. 2</b><br>Комплемент С3                     | 100 тестов  | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 03001962322 | <b>Tina-Quant Complement C4 Gen. 2</b><br>Комплемент С4                      | 100 тестов  | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 11820176316 | <b>Tina Quant KAPPA</b><br>Тина-Квант Каппа                                  | 150 тестов  | Multi pack 04593138190, на<br>«открытом канале» Diluent<br>NaCl 9% 20756350322 |
| 11820184316 | <b>Tina Quant LAMBDA</b><br>Тина-Квант Лямбда                                | 100 тестов  | Multi pack 04593138190, на<br>«открытом канале» Diluent<br>NaCl 9% 20756350322 |
| 04580010190 | <b>Myoglobin Gen. 2</b><br>Миоглобин   | 100 тестов  | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 20764655322 | <b>Prealbumin</b><br>Преальбумин   | 100 тестов  | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 20764574322 | <b>Rheumatoid Factors</b><br>Ревматоидные факторы                            | 100 тестов  | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 20764930322 | <b>C-Reactive Proteine</b><br>С-реактивный белок (латекс)                    | 300 тестов  | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 04628918190 | <b>CPR High Sensitive</b><br>С-реактивный белок (высокочувствительный)       | 300 тестов  | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 03528995190 | <b>Tina Quant Ferritin Gen. 2</b><br>Ферритин                                | 200 тестов  | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 20763454122 | <b>Soluble Transferrin Receptors</b><br>Растворимые рецепторы трансферрина   | 80 тестов   | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 03015050122 | <b>Transferrin Gen. 2</b><br>Трансферрин                                     | 100 тестов  | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 20764663322 | <b>Ceruloplasmin</b><br>Церулоплазмин  | 100 тестов  | Diluent NaCl 9%<br>20756350322   |
| 04489365190 | <b>Serum Index Gen.2</b><br>Реагент для определения сывороточных<br>индексов | 2750 тестов |  |
| 06600239190 | <b>Cystatin C Gen.2</b><br>Цистатин С  | 225 тестов  |  |

#### Лекарственный мониторинг

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка                | Примечание |
|-------------|--|------------------------|------------|
| 04340892190 | <b>CSA2 / Cyclosporin A-2</b><br>Набор реагентов для определения<br>циклоsporина А | 100 тестов             |            |
| 20766305122 | <b>Cyclosporine Calibrators</b><br>Калибратор циклоsporина                         | 1 x 2.5мл,<br>5 x 2 мл |            |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Integra 400 Plus

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка    | Примечание |
|-------------|--|------------|------------|
| 20766399122 | <b>Cyclosporine Calibrators 0 ng/ml</b><br>Нулевой калибратор Циклоспорина                         | 3 x 2.5 мл |            |
| 20766364122 | <b>COBAS INTEGRA Cyclosporine Sample Pretreatment</b><br>Реагент для обработки проб на циклоспорин | 4 x 40 мл  |            |

### Растворы и расходные материалы для ион-селективного блока (ISE)

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка     | Примечание |
|-------------|--|-------------|------------|
| 21029355001 | <b>K electrode</b><br>K электрод                                       | 1 шт.       |            |
| 21029371001 | <b>Na electrode</b><br>Na электрод                                     | 1 шт.       |            |
| 03003523001 | <b>Cl electrode</b><br>Cl электрод                                     | 1 шт.       |            |
| 21044303001 | <b>Li electrode</b><br>Li электрод                                     | 1 шт.       |            |
| 21029398001 | <b>Reference Electrode</b><br>Референсный электрод                     | 1 шт.       |            |
| 20763055122 | <b>ISE Calibrator direct</b><br>Калибратор прямой                      | 250 мл      |            |
| 20738050122 | <b>ISE Solution 1</b><br>Стандартный раствор № 1                       | 6 x 17,5 мл |            |
| 20738069122 | <b>ISE Solution 2</b><br>Стандартный раствор № 2                       | 6 x 9,5 мл  |            |
| 20738077122 | <b>ISE Solution 3</b><br>Стандартный раствор № 3 (Li-электрод)         | 6 x 9,5 мл  |            |
| 20738085122 | <b>ISE REF. Electrolyte</b><br>Референсный раствор                     | 250 мл      |            |
| 20763098122 | <b>ISE Etcher</b><br>Чистящий раствор                                  | 6 x 11 мл   |            |
| 20763063122 | <b>ISE Calibrator indirect urine</b><br>Калибратор непрямой (для мочи) | 1 x 250 мл  |            |

### Растворы и расходные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка   | Примечание |
|-------------|---|-----------|------------|
| 04663632190 | <b>Activator</b><br>Активатор                           | 9 x 12 мл |            |
| 20764337322 | <b>INTEGRA CLEAN 150</b><br>Кассета с моющим раствором  | 1 шт.     |            |
| 20763071122 | <b>Deproteinizer</b><br>Чистящий раствор                | 6 x 21 мл |            |
| 20756350322 | <b>cobas INTEGRA NaCl Diluent 9%</b><br>NaCl 9% дилуент | 6 x 22 мл |            |
| 20754765322 | <b>Cleaner Interga</b><br>Раствор моющий                | 1000 мл   |            |



### Аксессуары

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка       | Примечание |
|-------------|--|---------------|------------|
| 21045318001 | <b>cobas cups white with hole</b><br>Чашечки для проб белые с отверстием                   | 1000 шт.      |            |
| 21044869001 | <b>cobas cups blue with hole</b><br>Чашечки для проб голубые с отверстием                  | 1000 шт.      |            |
| 11902997001 | <b>BM/HIT Standert Racks 5001-5050 Standart</b><br>Штативы для проб                        | 50 шт.        |            |
| 21043862001 | <b>Microcuv / INTEGRA</b><br>Измерительные кюветы  | 20 x 1000 шт. |            |
| 21046179001 | <b>Waste Container INTEGRA 400</b><br>Сливной контейнер                                    | 20 шт.        |            |
| 28086834001 | <b>Adapter for cup sample</b><br>Адаптеры для проб к анализатору Integra 400               | 1 x 30 шт.    |            |
| 28048762001 | <b>Rack 15 Sample Assay</b><br>Штатив для проб к анализатору Integra 400                   | 1 шт.         |            |
| 28073929001 | <b>Reagent cassette rack INTEGRA 400</b><br>Штатив для реагентов к анализатору Integra 400 | 1 шт.         |            |

### Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора с111

#### Ферменты

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка        | Примечание           |
|-------------|--|----------------|----------------------|
| 04657373190 | <b>ALP IFCC</b><br>Щелочная фосфатаза                    | 4 x 50 тестов  | Chimneys 11930630001 |
| 05401496190 | <b>a- Amylase</b><br>a-Амилаза                           | 2 x 100 тестов |                      |
| 05401771190 | <b>a-Amylase Pancreatic</b><br>a-Амилаза панкреатическая | 2 x 50 тестов  |                      |
| 04657543190 | <b>ASTL IFCC</b><br>АСТ                                  | 4 x 100 тестов |                      |
| 04718569190 | <b>ALTL IFCC</b><br>АЛТ                                  | 4 x 100 тестов |                      |
| 07442017190 | <b>Creatine Kinase</b><br>Креатинкиназа                  | 2 x 100 тестов |                      |
| 07442050190 | <b>Creatine Kinase MB</b><br>Креатинкиназа MB            | 2 x 50 тестов  |                      |
| 05401461190 | <b>GGT2</b><br>Гамма-глутамилтрансфераза                 | 2 x 100 тестов |                      |
| 05401674190 | <b>LDH</b><br>Лактатдегидрогеназа                        | 2 x 50 тестов  | Chimneys 11930630001 |
| 05401704190 | <b>Lipase</b><br>Липаза                                  | 2 x 50 тестов  | Cleaner 04774248190  |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора с111

### Субстраты

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка        | Примечание   |
|-------------|--|----------------|--|
| 04657357190 | <b>Albumin</b><br>Альбумин   | 4 x 100 тестов | Cleaner 04774248190                                    |
| 05401739190 | <b>Ammonia (NH3)</b><br>Аммоний                                      | 2 x 50 тестов  |  |
| 05455308190 | <b>Bicarbonate (CO2-L)</b><br>Бикарбонат                             | 2 x 100 тестов |  |
| 05589134190 | <b>Bilirubin Direct Gen.2</b><br>Прямой билирубин                    | 2 x 50 тестов  | NaCl Diluent 9%<br>04774230190                         |
| 05795648190 | <b>Bilirubin Total Gen.3</b><br>Общий билирубин                      | 4 x 100 тестов |  |
| 05061504190 | <b>Calcium Gen.2</b><br>Кальций                                      | 4 x 100 тестов | NaCl Diluent 9%<br>04774230190                         |
| 04718917190 | <b>Cholesterol</b><br>Холестерол                                     | 4 x 100 тестов |  |
| 05401755190 | <b>Creatinine Jaffe Gen.2</b><br>Креатинин Яффе                      | 4 x 100 тестов |  |
| 05401470190 | <b>Creatinine Plus Gen.2</b><br>Креатинин Плюс, энзиматический метод | 2 x 100 тестов |  |
| 04657527190 | <b>Glucose HK</b><br>Глюкоза (гексокиназный метод)                   | 4 x 100 тестов |  |
| 05067235191 | <b>Hemolyzing reagent</b><br>Реагент лизирующий для глюкозы          | 1000 мл        |  |
| 07528604190 | <b>HDL-Cholesterol Gen.4</b><br>ЛПВП холестерин                      | 2 x 100 тестов | NaCl Diluent 9%<br>04774230190                         |
| 07005806190 | <b>LDL-Cholesterol Gen.3</b><br>ЛПНП холестерин                      | 2 x 50 тестов  | NaCl Diluent 9%<br>04774230190                         |
| 05401658190 | <b>Iron Gen.2</b><br>Железо  | 2 x 50 тестов  |  |
| 05401666190 | <b>Lactate</b><br>Лактат   | 2 x 50 тестов  |  |
| 05401712190 | <b>Magnesium</b><br>Магний   | 2 x 50 тестов  | Cleaner 04774248190                                    |
| 05401780190 | <b>Phosphorus</b><br>Фосфор  | 2 x 50 тестов  |  |
| 04657586190 | <b>Total Protein Gen.2</b><br>Общий белок                            | 4 x 100 тестов | Chimneys 11930630001                                   |
| 04657594190 | <b>Triglycerides</b><br>Триглицериды                                 | 4 x 50 тестов  |  |
| 04657616190 | <b>Urea</b><br>Мочевина  | 4 x 100 тестов | Chimneys 11930630001<br>NaCl Diluent 9%<br>04774230190 |
| 04657608190 | <b>Uric Acid Gen.2</b><br>Мочевая кислота                            | 4 x 100 тестов | Cleaner 04774248190                                    |



### Специфические белки

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка        | Примечание   |
|-------------|---|----------------|--|
| 05401500190 | <b>Albumin in Urine</b><br>Альбумин в моче  | 2 x 100 тестов | Chimneys 11930630001<br>Cleaner 04774248190<br>NaCl Diluent 9% 04774230190   |
| 05401615190 | <b>C-reactive protein (latex)</b><br>С-реактивный белок (латексное усиление)                    | 2 x 100 тестов | Chimneys 11930630001<br>NaCl Diluent 9%<br>04774230190   |
| 05401607190 | <b>C-reactive protein (High sensitive)</b><br>С-реактивный белок высокочувствительный           | 2 x 50 тестов  | NaCl Diluent 9%<br>04774230190   |
| 05077753190 | <b>D-Dimer Gen.2</b><br>Д-димер   | 4 x 50 тестов  | NaCl Diluent 9%<br>04774230190   |
| 05336180190 | <b>HbA1c TQ Gen.3</b><br>Гликированный гемоглобин   | 2 x 100 тестов | Hemolyzing reagent Gen.<br>05007232190<br>Для ручной<br>пробоподготовки HbA1c<br>Hemolyzing Reagent<br>11488457122 |
| 11488457122 | <b>Hemolyzing reagent HbA1c</b><br>Реагент гемолизирующий для HbA1c<br>(для ручного разведения) | 1000 мл        |  |
| 05007232190 | <b>Hemolyzing Reagent cobas c systems</b><br>Гемолизирующий реагент                             | 8 x 6,3 мл     |  |

### Дополнительные растворы для с111

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка   | Примечание |
|-------------|--|-----------|------------|
| 04663632190 | <b>Activator</b><br>Активатор                                      | 9 x 12 мл |            |
| 04774248190 | <b>Detergent I (NAOH-D)</b><br>Детергент 1                         | 4 x 21 мл |            |
| 04774230190 | <b>Diluent NAACL 9%</b><br>Дилуент NAACL 9%                        | 4 x 12 мл |            |
| 20754765322 | <b>Cleaner acid Integra</b><br>Моющий раствор кислый (для Интегра) | 1000 мл   |            |

### Аксессуары и расходные материалы для с111

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 10394246001 | <b>cobas sample cups (2 ml)</b><br>Пробирки для образцов (2 мл)         | 5000 шт.     |            |
| 04357108001 | <b>Cuvette segments cobas c 111</b><br>Измерительные кюветы в сегментах | 168 x 10 шт. |            |
| 04352483001 | <b>Paper Thermoprinter</b><br>Бумага для термопринтера                  | 5 шт.        |            |
| 11930630001 | <b>Chimneys</b><br>Вкладыш для реагента                                 | 3 x 32 шт.   |            |
| 04793811001 | <b>Reagent Disk</b><br>Дополнительный реагентный ротор                  | 1 шт.        |            |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора с111

### Растворы и расходные материалы для ион-селективного блока (ISE)

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание |
|-------------|---|------------|------------|
| 04834925001 | <b>K electrode</b><br>K электрод  | 1шт.       |            |
| 04838084001 | <b>Na electrode</b><br>Na электрод  | 1шт.       |            |
| 04834909001 | <b>Cl electrode</b><br>Cl электрод  | 1шт.       |            |
| 04838092001 | <b>Reference Electrode</b><br>Референсный электрод                            | 1шт.       |            |
| 04842367001 | <b>Dummy Electrode</b><br>Электрод-заглушка                                   | 1шт.       |            |
| 04838106001 | <b>ISE Calibration kit</b><br>Набор калибраторов ISE                          | 6 x 8 мл   |            |
| 04838157001 | <b>ISE REF. SOLUTION с 111</b><br>Раствор для референсного электрода          | 2 x 115 мл |            |
| 04838165001 | <b>ISE Etcher</b><br>Чистящий раствор   | 2 x 11 мл  |            |
| 04838149001 | <b>ISE Calibrator indirect (urine)</b><br>Калибратор не прямой / для мочи ISE | 2 x 230 мл |            |
| 04838181001 | <b>ISE Deproteinizer</b><br>Депротеинизатор cobas с 111                       | 2 x 11 мл  |            |



## Калибраторы и контрольные материалы для биохимических анализаторов cobas

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка      | Примечание |
|-------------|--|--------------|------------|
| 10759350190 | <b>Calibrator for automated systems (C.f.a.s.)</b><br>Калибратор для автоматизированных систем                     | 12 x 3 мл    |            |
| 12172623122 | <b>C.f.a.s. Lipids</b><br>Калибратор липидов   | 3 x 1 мл     |            |
| 11355279216 | <b>C.f.a.s. Protein</b><br>Калибратор белков для автоматизированных систем   | 5 x 1 мл     |            |
| 11447394216 | <b>C.f.a.s. CK-MB</b><br>Калибратор для автоматизированных систем CK-MB  | 3 x 1 мл     |            |
| 12146401216 | <b>Fe Standard</b><br>Калибратор для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности (UIBC) | 1 x 75 мл    |            |
| 05117003190 | <b>PreciControl ClinChem Multi 1</b><br>Контроль универсальный I   | 20 x 5 мл    |            |
| 05947626190 | <b>PreciControl ClinChem Multi 1</b><br>Контроль универсальный I   | 4 x 5 мл     |            |
| 05117216190 | <b>PreciControl ClinChem Multi 2</b><br>Контроль универсальный II  | 20 x 5 мл    |            |
| 05947774190 | <b>PreciControl ClinChem Multi 2</b><br>Контроль универсальный II  | 4 x 5 мл     |            |
| 10557897122 | <b>Precinorm Protein</b><br>Прецинорм Протеин  | 3 x 1 мл     |            |
| 11333127122 | <b>Precipath Protein</b><br>Преципат Протеин   | 3 x 1 мл     |            |
| 11098993122 | <b>Precimat Fructosamine</b><br>Прецимат Фруктозамин   | 3 x 1 мл     |            |
| 11098985122 | <b>Precinorm Fructosamine</b><br>Прецинорм Фруктозамин   | 3 x 1 мл     |            |
| 11174118122 | <b>Precipath Fructosamine</b><br>Преципат Фруктозамин  | 3 x 1 мл     |            |
| 20751995190 | <b>AMMONIAK / ETHANOL / CO2 CALIBRATOR</b><br>Аммоний/этанол/CO2 калибратор  | 2 x 4 мл     |            |
| 20752401190 | <b>AMMONIAK / ETHANOL / CO2 CONTROL N</b><br>Аммоний/Этанол/CO2 контроль норма                                     | 5 x 4 мл     |            |
| 20753009190 | <b>AMMONIAK / ETHANOL / CO2 CONTROL P</b><br>Аммоний/Этанол/CO2 контроль патология                                 | 5 x 4 мл     |            |
| 05142423190 | <b>Homocysteine Control Kit</b><br>Контроль Гомоцистеина   | 2 x 2 x 3 мл |            |
| 05385504190 | <b>Homocysteine Calibrator Kit</b><br>Калибратор Гомоцистеина  | 2 x 3 мл     |            |
| 20766321322 | <b>CRP Control N</b><br>Контроль С-реактивного белка (норма)   | 5 x 0,5 мл   |            |
| 03121305122 | <b>C.f.a.s. PUC</b><br>Калибратор белков мочи  | 5 x 1 мл     |            |

# Сывороточная рабочая зона

## Калибраторы и контрольные материалы для биохимических анализаторов cobas

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка        | Примечание           |
|-------------|---|----------------|----------------------|
| 03121313122 | <b>Precinorm PUC</b><br>Прецином белки мочи   | 4 x 3 мл       |                      |
| 03121291122 | <b>Precipath (PUC)</b><br>Преципат белки мочи   | 4 x 3 мл       |                      |
| 03555941190 | <b>C.f.a.s. PAC</b><br>Калибратор ПАЦ (преальбумин, антистрептолизин, церулоплазмин)            | 3 x 1 мл       |                      |
| 04528417190 | <b>C.f.a.s. HbA1c</b><br>Калибратор HbA1c   | 3 x 2 мл       |                      |
| 05479207190 | <b>PreciControl HbA1c normal</b><br>Гликозилированный гемоглобин контроль норма                 | 4 x 1 мл       |                      |
| 05912504190 | <b>PreciControl HbA1c pathological</b><br>Гликозилированный гемоглобин контроль патология       | 4 x 1 мл       |                      |
| 05852641190 | <b>Preciset Lp (a) Gen.2</b><br>Калибратор Lp(a)  | 5 x 1 мл       |                      |
| 05852650190 | <b>PreciControl Lp(a) Gen.2 Roche systems</b><br>Контроль Lp(a)                                 | 2 x 2 x 1 мл   |                      |
| 12172828322 | <b>PRECISSET RF</b><br>Набор калибраторов РФ  | 5 x 1 мл       |                      |
| 03005496122 | <b>Control Set RF</b><br>Набор контролей РФ   | 2 x 2 x 1 мл   |                      |
| 12148331122 | <b>Preciset sTfR</b><br>Набор калибраторов рецепторов трансферрина                              | 5 x 1 мл       |                      |
| 12148340122 | <b>Control Set sTfR</b><br>Набор контролей рецепторов трансферрина                              | 2 x 2 x 3 мл   |                      |
| 04580044190 | <b>C.f.a.s. Myoglobin</b><br>Стандарт миоглобина  | 3 x 1 мл       |                      |
| 11730835216 | <b>Control Set Myoglobin</b><br>Набор контролей Миоглобина                                      | 2 x 2 x 3 мл   |                      |
| 05050901190 | <b>D-Dimer Calibrator Gen.2</b><br>Д-Димер Калибратор   | 6 x 0,5 мл     |                      |
| 05050936190 | <b>D-Dimer Control I/II Gen.2</b><br>D-Димер контроль I/II                                      | 2 x 2 x 1 мл   |                      |
| 11012002122 | <b>PreciChrom I / II</b><br>Контрольная плазма для определения показателей свертывания крови    | 12 x 1 мл      |                      |
| 11012045122 | <b>Precimat Chromogen</b><br>Калибровочная плазма для определения показателей свертывания крови | 6 x 0,5 мл     |                      |
| 11729683216 | <b>b2-MICROGLOBULIN Control-Set Serum</b><br>Контроль b2-микроглобулина                         | 2 x 2 x 1 мл   |                      |
| 20737267322 | <b>Serumproteins T-Standard</b><br>Стандарт белков сыворотки                                    | 5 x 0,5 мл     | для Integra 400 plus |
| 04975901191 | <b>C.f.a.s. Cystatin C</b><br>Калибратор цистатин С   | 4 x 1.0 мл     |                      |
| 06729371190 | <b>Cystatin C Control Set</b><br>Контроль цистатин С  | 3 x 3 x 1.0 мл |                      |





## Таблица соответствия калибраторов и контрольных материалов для биохимических анализаторов cobas

|                             | Калибратор        | Контроль норма       | Контроль патология   |                      |                      |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ферменты</b>             |                   |                      |                      |                      |                      |
| Acid Phosphatase            | Cfas              | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |                      |                      |
| Alkaline phosphatase        |                   |                      |                      |                      |                      |
| ALT                         |                   |                      |                      |                      |                      |
| a-Amylase                   |                   |                      |                      |                      |                      |
| Pancreatic a-Amylase        |                   |                      |                      |                      |                      |
| AST                         |                   |                      |                      |                      |                      |
| Cholinesterase              |                   |                      |                      |                      |                      |
| Cholinesterase Dibucain     |                   |                      |                      |                      |                      |
| CK                          |                   |                      |                      |                      |                      |
| CK - MB                     |                   |                      |                      | Cfas CK-MB           |                      |
| GLDH Gen.3                  | Cfas              |                      |                      |                      |                      |
| HBDH Gen.2                  |                   |                      |                      |                      |                      |
| GGT                         |                   |                      |                      |                      |                      |
| LDH12 IFCC                  |                   |                      |                      |                      |                      |
| Lipase                      |                   |                      |                      |                      |                      |
| Homocysteine                | HCYS Calib Kit    | HCYS Control Kit     |                      |                      |                      |
| <b>Субстраты</b>            |                   |                      |                      |                      |                      |
| Albumin ( BCG)              | Cfas              | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |                      |                      |
| Bilirubin Total Gen.3       |                   |                      |                      |                      |                      |
| Bilirubin Direct Gen.2      |                   |                      |                      |                      |                      |
| Ammonia                     | NH3/Etho/CO2 Std. | NH3/Etho/CO2 Cont. N | NH3/Etho/CO2 Cont. P |                      |                      |
| Bicarbonate                 |                   |                      |                      |                      |                      |
| Ethanol Gen.2               |                   |                      |                      |                      |                      |
| Calcium                     | Cfas              | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |                      |                      |
| Creatinine Jaffe            |                   | PN PUC               | PP PUC               |                      |                      |
| Creatinine Jaffe (моча)     |                   |                      |                      |                      |                      |
| Creatinine enzymatic        |                   |                      |                      | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Creatinine enzymatic (моча) |                   |                      |                      | PN PUC               | PP PUC               |
| Cholesterol                 | Cfas              | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |                      |                      |
| HDL - Cholesterol direct    | Cfas Lipid        |                      |                      |                      |                      |
| LDL - Cholesterol direct    |                   |                      |                      |                      |                      |
| Fructosamine                | Precimat Fructo   | PN Fructo            | PP Fructo            |                      |                      |
| Glucose HK                  | Cfas              | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |                      |                      |
| Lactate                     |                   |                      |                      |                      |                      |
| Iron                        |                   |                      |                      |                      |                      |
| Magnesium                   |                   |                      |                      |                      |                      |
| Phosphate Inorganic         |                   |                      |                      |                      |                      |
| Total Protein               |                   |                      |                      |                      |                      |

# Сывороточная рабочая зона

## Калибраторы и контрольные материалы для биохимических анализаторов cobas

|                                      | Калибратор  | Контроль норма       | Контроль патология   |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Total Protein in Urine + CSF (TPUC3) | Cfas PUC    | PN PUC               | PP PUC               |
| Triglycerides                        | Cfas        | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Urea ***                             |             |                      |                      |
| Uric Acid                            |             |                      |                      |
| Un. Iron Bind Capacity (UIBC)        | Fe Standard |                      |                      |

### Специфические белки

|                               |  |   |   |
|-------------------------------|--|---|---|
| Albumin turbidimetric         | Cfas PUC   | PreciControl Multi 1<br>PN PUC (для Integra 400 Plus) | PreciControl Multi 2<br>PP PUC (для Integra 400 Plus) |
| alpha 1 Antitrypsin           | Cfas Proteins  | PreciControl Multi 1                                  | PreciControl Multi 2                                  |
| AAGP                          |  |   |   |
| Apolipoprotein A-1            | Cfas Lipid   | PreciControl Multi 1                                  | PreciControl Multi 2                                  |
| Apolipoprotein B              |  |   |   |
| Antistreptolysin O            | Cfas PAC   |   |   |
| Antitrombine                  | Precimat Chrom.  | Precichrom I/II                                       |   |
| b-2 Microglobulin             | входит в состав набора   | Beta2-microglobulin Control Set Serum                 |   |
| D-Dimer                       | D-Dimer Calib.   | D-Dimer Control Set I/II                              |   |
| Haptoglobin                   | Cfas Proteins  | PreciControl Multi 1                                  | PreciControl Multi 2                                  |
| Glycated Hemoglobin A1C Gen.3 | Cfas HbA1c   | PreciControl HbA1c nom                                | PreciControl HbA1c nom                                |
| Immunoglobulin A**            | Cfas Proteins*;<br>Serumproteins T<br>Standards (для cobas<br>Integra) | PreciControl Multi 1                                  | PreciControl Multi 2                                  |
| Immunoglobulin G**            |  |   |   |
| Immunoglobulin M**            |  |   |   |
| Complement C3c                |  |   |   |
| Complement C4                 | Cfas Proteins  | PreciControl Multi 1*                                 | PreciControl Multi 2*                                 |
| Kappa light                   |  |   |   |
| Lambda light                  |  |   |   |
| Lp(a)                         | Cfas Lp(a)   | Lp(a) Control Set I/II                                |   |
| Myoglobin                     | Cfas Myo   | Myo Control Set I/II                                  |   |
| Prealbumin                    | Cfas PAC   | PreciControl Multi 1                                  | PreciControl Multi 2                                  |
| Rheumatoid Factor             | Preciset RF  | RF Control Set I/II                                   |   |
| C - Reactive Protein Gen.3*   | Cfas Proteins  | PreciControl Multi 1                                  | PreciControl Multi 2                                  |
| C - Reactive Protein LX       |  | CRP Control N   | PreciControl Multi 1                                  |
| C - Reactive Protein HS       |  |   |   |
| Ferritin Gen.2                |  | PreciControl Multi 1                                  | PreciControl Multi 2                                  |
| Ferritin Gen.4*               |  |   |   |
| sTfR                          | Preciset sTfR  | sTfR Control Set I/II                                 |   |
| Transferrin                   | Cfas Proteins  | PreciControl Multi 1                                  | PreciControl Multi 2                                  |
| Ceruloplasmin                 | Cfas PAC   |   |   |
| Cystatin C                    | Cfas Cystatin C  | Cystatin C Control Set I/II                           |   |

\*не для cobas Integra

\*\*для стандартной аппликации

\*\*\* для аппликации мочи используется сторонний контроль



## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического анализатора cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

### Диагностика нарушений функции щитовидной железы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание                             |
|-------------|---|------------|--|
| 11731459122 | <b>TSH</b><br>Тиреотропный гормон (ТТГ)             | 200 тестов | 0,005-100 мкМЕ/мл                      |
| 11731360122 | <b>T3</b><br>Трийодтиронин (Т3)                     | 200 тестов | 0,3-10 нмоль/л                         |
| 06437206190 | <b>FT3 III</b><br>Свободный трийодтиронин (СТ3)     | 200 тестов | 0,4-50 пмоль/л                         |
| 12017709122 | <b>T4</b><br>Тироксин (Т4)                          | 200 тестов | 5,4-320 нмоль/л                        |
| 07976836190 | <b>FT4 III</b><br>Свободный тироксин (СТ4)          | 200 тестов | 0,5-100 пмоль/л                        |
| 11731394122 | <b>T-Uptake</b><br>Т-захват                         | 200 тестов | Индекс связанного тироксина<br>0,2-1,9 |
| 06445896190 | <b>Tg II</b><br>Тиреоглобулин (ТГ)                  | 100 тестов | 0,04-500 нг/мл                         |
| 06513107190 | <b>Tg II Confirmatory Test</b><br>ТГ подтверждающий | 50 тестов  |  |
| 06368590190 | <b>Anti-TPO</b><br>Антитела к тиреопероксидазе      | 100 тестов | 5-600 МЕ/мл                            |
| 06368697190 | <b>Anti-TG</b><br>Антитела к тиреоглобулину         | 100 тестов | 10-4000 МЕ/мл                          |
| 04388780190 | <b>Anti-TSHR*</b><br>Антитела к рецепторам ТТГ      | 100 тестов | 0,3-40 МЕ/л                            |

\* Калибраторы входят в состав набора.

### Калибраторы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка        | Примечание |
|-------------|--|----------------|------------|
| 04738551190 | <b>TSH CalSet</b><br>Калибратор для ТТГ                | 2 x 2 x 1,3 мл |            |
| 11731548122 | <b>T3 CalSet</b><br>Калибратор для Т3                  | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 06437222190 | <b>FT3 III CalSet</b><br>Калибратор для СТ3            | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 12017717122 | <b>T4 CalSet</b><br>Калибратор для Т4                  | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 07976879190 | <b>FT4 III CalSet</b><br>Калибратор для СТ4            | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 06472931190 | <b>Anti-TPO CalSet</b><br>Калибратор для антител к ТПО | 2 x 2 x 1,5 мл |            |
| 06368603190 | <b>Anti-TG CalSet</b><br>Калибратор для антител к ТГ   | 2 x 2 x 1,5 мл |            |
| 06528309190 | <b>T-uptake CalSet</b><br>Калибратор для Т-захвата     | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 06445900190 | <b>Tg II CalSet</b><br>Калибратор для тиреоглобулина   | 2 x 2 x 1 мл   |            |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка      | Примечание |
|-------------|--|--------------|------------|
| 05618860190 | <b>PreciControl Varia</b><br>Контрольная сыворотка Varia для определения: витамина В12, ферритина, фолатов, β-CrossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина Д | 2 x 2 x 3 мл |            |

### Диагностика ревматоидного артрита

| Арт.№       | Наименование                  | Фасовка    | Примечание |
|-------------|-------------------------------|------------|------------|
| 05031656190 | <b>Anti-CCP*</b><br>Анти- ЦЦП | 100 тестов | 7-500 Е/мл |

\* Калибраторы входят в состав набора.

### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 05031664190 | <b>PreciControl Anti-CCP</b><br>Контрольная сыворотка по анти-ЦЦП | 2 x 2 x 2 мл |            |

### Диагностика сепсиса

| Арт.№       | Наименование                         | Фасовка    | Примечание     |
|-------------|--------------------------------------|------------|----------------|
| 05056888200 | <b>BRAHMS PCT*</b><br>Прокальцитонин | 100 тестов | 0,02-100 нг/мл |
| 05109442190 | <b>IL6</b><br>IL-6 (интерлейкин-6)   | 100 тестов | 1,5-5000 пг/мл |

\* Калибраторы и контроль входят в состав набора.

### Калибраторы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 05109469190 | <b>IL6 CalSet</b><br>Калибратор для IL-6 (интерлейкина-6) | 2 x 2 x 2 мл |            |

### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 05341787190 | <b>PreciControl MultiMarker</b><br>Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFit-1), плацентарного фактора роста (PlGF), АКТГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина | 2 x 3 x 2 мл |            |



### Дополнительные растворы и разбавители проб

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка    | Примечание  |
|-------------|--|------------|---|
| 11732277122 | <b>Diluent Universal</b><br>Универсальный разбавитель проб   | 2 x 16 мл  |   |
| 03183971122 | <b>Diluent Universal</b><br>Универсальный разбавитель проб   | 2 x 36 мл  |   |
| 05192943190 | <b>Diluent Universal 2</b><br>Универсальный разбавитель проб 2   | 2 x 36 мл  | Совместим с реагентами 07957190190 AMH Plus и 06687733190 Cortisol II, для автоматического и ручного разведения образцов. |
| 03004864122 | <b>NSE Diluent</b><br>Разбавитель проб при определении NSE   | 4 x 3 мл   |   |
| 03028542122 | <b>Diluent Estradiol/Progesteron</b><br>Разбавитель только для прогестерона  | 2 x 22 мл  |   |
| 03609987190 | <b>Diluent MultiAssay</b><br>Разбавитель проб Мультитест при определении: С-пептида (сыворотка и моча), СГСГ (SHBG), ТТГ, эстрадиола | 2 x 16 мл  |   |
| 11361252122 | <b>Diluent Hepatitis A</b><br>Разбавитель проб при определении: Анти-ВГА-антител   | 2 x 15 мл  |   |
| 11298500316 | <b>ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean</b><br>Чистящий раствор  | 5 x 100 мл |   |

### Расходные материалы для анализатора cobas e411

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка        | Примечание<br>Кол-во тестов** |
|-------------|---|----------------|-------------------------------|
| 11662988122 | <b>Procell Elecsys</b><br>Субстрат-реагент Procell  | 6 x 380 мл     | ~900-1000 тестов              |
| 08243875190 | <b>Cleancell Elecsys</b><br>Промывающий буфер Cleancell   | 6 x 380 мл     | ~900-1000 тестов              |
| 08243930190 | <b>Assay Cup Elecsys</b><br>Реакционные пробирки  | 60 x 60 шт.    | 3500-3600 тестов              |
| 11706799001 | <b>Assay Tip Elecsys</b><br>Наконечники для дозатора  | 30 x 120 шт.   | 1700-1800 тестов              |
| 11800507001 | <b>Clean Liner Elecsys 2010/cobas e 411</b><br>Пластиковые контейнеры для твердых отходов       | 1 уп. x 14 шт. |                               |
| 05151643001 | <b>Measuring Cell with reference electrode</b><br>Измерительная ячейка с референсным электродом | 1 шт.          |                               |
| 11729306122 | <b>BlankCell Elecsys</b><br>Реагент для проведения фоновой пробы                                | 2 x 50 мл      |                               |

# Анализаторы газов крови и электролитов

## Анализатор критических состояний cobas b 221

### Приборы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка | Примечание                      |
|-------------|---|---------|---------------------------------|
| 03337111001 | <b>cobas b 221&lt;2&gt; (BG/COOX)</b><br>Анализатор критических состояний cobas b 221 мод. 2 (Газы крови/Оксиметрия)                                  | 1 штука |                                 |
| 03337138001 | <b>cobas b 221&lt;4&gt; (BG/ISE/COOX)</b><br>Анализатор критических состояний cobas b 221 мод. 4 (Газы крови/Электролиты/ Оксиметрия)                 | 1 штука |                                 |
| 03337154001 | <b>cobas b 221&lt;6&gt; (BG/ISE/MSS/COOX)</b><br>Анализатор критических состояний cobas b 221 мод. 6 (Газы крови/Электролиты/ Метаболиты/ Оксиметрия) | 1 штука |                                 |
| 03313522001 | <b>AUTO QC MODUL cobas</b><br>Модуль автоматического контроля качества  | 1 штука | МАКК. Устанавливается инженером |

### Реагенты и контрольные материалы к анализаторам cobas b 221, OMNI S

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка                   | Примечание |
|-------------|--|---------------------------|------------|
| 03260917184 | <b>S1 Rinse Solution</b><br>Промывочный раствор Эс 1   | 2 контейнера              |            |
| 03260925184 | <b>S2 Fluid Pack</b><br>Контейнер с реагентами Эс 2  | 1 контейнер               |            |
| 03260933184 | <b>S3 Fluid Pack A</b><br>Контейнер с реагентами Эс 3А   | 1 контейнер               |            |
| 03321193001 | <b>COMBITROL PLUS B, LEVEL 1 (COOX)</b><br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 1 (30x1.7мл) | 30 ампул по 1,7 мл каждая |            |
| 03321207001 | <b>COMBITROL PLUS B, LEVEL 2 (COOX)</b><br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 2 (30x1.7мл) | 30 ампул по 1,7 мл каждая |            |
| 03321215001 | <b>COMBITROL PLUS B, LEVEL 3 (COOX)</b><br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 3 (30x1.7мл) | 30 ампул по 1,7 мл каждая |            |
| 03321169001 | <b>AUTO-TROL PLUS B, LEVEL 1 (COOX)</b><br>Контрольный материал АВТО-трол Плюс Б, уровень 1 (40x1.7мл) | 40 ампул по 1,7 мл каждая | Для МАКК   |
| 03321177001 | <b>AUTO-TROL PLUS B, LEVEL 2 (COOX)</b><br>Контрольный материал АВТО-трол Плюс Б, уровень 2 (40x1.7мл) | 40 ампул по 1,7 мл каждая | Для МАКК   |
| 03321185001 | <b>AUTO-TROL PLUS B, LEVEL 3 (COOX)</b><br>Контрольный материал АВТО-трол Плюс Б, уровень 3 (40x1.7мл) | 40 ампул по 1,7 мл каждая | Для МАКК   |

### Расходные материалы и принадлежности к анализаторам cobas b 221, OMNI S

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка | Примечание |
|-------------|--|---------|------------|
| 03111598180 | <b>Electrode Sodium (Na+)</b><br>Натриевый микроэлектрод | 1 штука |            |



| Арт.№       | Наименование   | Фасовка                     | Примечание                                  |
|-------------|--|-----------------------------|---|
| 03111628180 | <b>Potassium Electrode (K+)</b><br>Калиевый микроэлектрод                    | 1 штука                     |   |
| 03111644180 | <b>Calcium Electrode (Ca+ +)</b><br>Кальциевый микроэлектрод                 | 1 штука                     |   |
| 03111571180 | <b>AVL Micro Electrode - Cl-</b><br>Хлорный микроэлектрод                    | 1 штука                     |   |
| 03111679180 | <b>PCO2 Electrode</b><br>pCO2-микроэлектрод                                  | 1 штука                     |   |
| 03111695180 | <b>PO2 Electrode</b><br>pO2-микроэлектрод                                    | 1 штука                     |   |
| 03111717180 | <b>pH Electrode</b><br>pH-микроэлектрод                                      | 1 штука                     |   |
| 03111873180 | <b>Ref. Electrode</b><br>Референсный микроэлектрод                           | 1 штука                     |   |
| 03111849035 | <b>Electrode Dummy</b><br>Микроэлектрод-заглушка                             | 1 штука                     | Позиция обязательна для инсталляции прибора |
| 03261085184 | <b>GLU/LAC/UREA (BUN) Cassette</b><br>Кассета Глюкоза/ Лактат/ Мочевина      | 1 штука                     |   |
| 03260887184 | <b>GLU/LAC Cassette</b><br>Картридж Глюкоза/Лактат                           | 1 штука                     |   |
| 03260895184 | <b>GLU Cassette</b><br>Картридж Глюкоза                                      | 1 штука                     |   |
| 03351262001 | <b>MSS Dummy Sensor cobas b 221</b><br>Заглушка для метаболического контакта | 1 штука                     | Позиция обязательна для инсталляции прибора |
| 03260909184 | <b>Sensor contact (SCON)</b><br>Сенсорный контакт SCON                       | 1 штука                     | Позиция обязательна для инсталляции прибора |
| 03112071180 | <b>Reference contact (RCON), OMNI/cobas b221</b><br>Референсный контакт      | 1 штука                     | Позиция обязательна для инсталляции прибора |
| 03113361180 | <b>Termo Printer Paper</b><br>Термобумага, 6шт.                              | 6 роликов                   |   |
| 03110435180 | <b>Deproteinizer</b><br>Раствор для антисептики                              | 1 флакон<br>емкость 125 мл  |   |
| 03110923035 | <b>Hb-Calibrator</b><br>Калибратор гемоглобина (5x1.2 мл)                    | 5 ампул<br>по 1.2 мл каждая |   |
| 03112098035 | <b>CLEANING KIT FOR CL-ELECTRODE</b><br>Набор для чистки хлорного электрода  | 1 штука                     |   |
| 03144054001 | <b>W Waste Container</b><br>Контейнер для отходов W, 2 шт.                   | 2 штуки                     |   |
| 03112071180 | <b>Reference Contact (RCon)</b><br>Референсный контакт                       | 1 штука                     |   |
| 03087603001 | <b>Tube holder (cobas b 221)</b><br>Держатель трубок                         | 1 штука                     |   |

# Сывороточная рабочая зона

Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

## Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 11731416190 | <b>Precicontrol Universal</b><br>Универсальная контрольная сыворотка                                  | 2 x 2 x 3 мл |            |
| 06445918190 | <b>PreciControl Thyro Sensitive</b><br>Контрольная сыворотка для ТТГ и ТГ                             | 4 x 2 мл     |            |
| 05042666191 | <b>PreciControl ThyroAB</b><br>Контрольная сыворотка для антител к рецепторам ТТГ, антител к ТГ и ТПО | 4 x 2 мл     |            |

## Диагностика нарушений функции паращитовидной железы

| Арт.№       | Наименование                                    | Фасовка    | Примечание   |
|-------------|---|------------|--|
| 11972103122 | <b>PTH</b><br>Паратгормон                       | 100 тестов | 0,127-530 пмоль/л<br>18 минут  |
| 04892470190 | <b>PTH STAT</b><br>Паратгормон - экспресс-метод | 100 тестов | 0,127-530 пмоль/л<br>9 минут<br>Нельзя использовать на анализаторе MODULAR E170! |
| 05608546190 | <b>PTH (1-84)</b><br>Паратгормон 1-84           | 100 тестов | 0,583-244 пмоль/л<br>18 минут  |

## Калибраторы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка      | Примечание |
|-------------|--|--------------|------------|
| 08243875190 | <b>PTH CalSet</b><br>Калибратор для паратгормона                     | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 08243930190 | <b>PTH STAT CalSet</b><br>Калибратор для паратгормона экспресс-метод | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 05608554190 | <b>PTH (1-84) CalSet</b><br>Калибратор для паратгормона (1-84)       | 2 x 2 x 1 мл |            |

## Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка      | Примечание |
|-------------|--|--------------|------------|
| 05618860190 | <b>PreciControl Varia</b><br>Контрольная сыворотка Varia для: витамина В12, ферритина, фолатов, β-CrossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина D | 2 x 2 x 3 мл |            |

## Диагностика эндокринных нарушений репродуктивной функции

| Арт.№       | Наименование                                 | Фасовка    | Примечание     |
|-------------|--|------------|----------------|
| 07957190190 | <b>AMH Plus</b><br>Антимюллеров гормон (АМГ) | 100 тестов | 0,01-23 нг/мл  |
| 11732234122 | <b>LH</b><br>Лютеинизирующий гормон (ЛГ)     | 100 тестов | 0,1-200 мМЕ/мл |





| Арт.№       | Наименование   | Фасовка    | Примечание         |
|-------------|--|------------|--------------------|
| 11775863122 | <b>FSH</b><br>Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)          | 100 тестов | 0,1-200 мМЕ/мл     |
| 06656021190 | <b>Estradiol III</b><br>Эстрадиол                          | 100 тестов | 18,4-11010 пмоль/л |
| 03203093190 | <b>Prolactin II</b><br>Пролактин                           | 100 тестов | 1,0-10000 мкМЕ/мл  |
| 07092539190 | <b>Progesterone III</b><br>Прогестерон                     | 100 тестов | 0,159-191 нмоль/л  |
| 05200067190 | <b>Testosterone II</b><br>Тестостерон                      | 100 тестов | 0,087-52 нмоль/л   |
| 03052001190 | <b>SHBG</b><br>Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 100 тестов | 0,35-200 нмоль/л   |

#### Калибраторы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка      | Примечание |
|-------------|--|--------------|------------|
| 07957203190 | <b>CalSet AMH Plus</b><br>Калибратор для антимюллерова гормона (АМГ)               | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03561097190 | <b>LH CalSet II</b><br>Калибратор для лютеинизирующего гормона (ЛГ)                | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03032680122 | <b>FSH CalSet II</b><br>Калибратор для фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)       | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 06656048190 | <b>Estradiol III CalSet II</b><br>Калибратор для эстрадиола                        | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03277356190 | <b>Prolactin II CalSet</b><br>Калибратор для пролактина                            | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 07092547190 | <b>Progesterone III CalSet</b><br>Калибратор для прогестерона                      | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 05202230190 | <b>Testosterone II CalSet II</b><br>Калибратор для тестостерона                    | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03052028190 | <b>SHBG CalSet</b><br>Калибратор для глобулина связывающего половые гормоны (ГСПГ) | 2 x 2 x 1 мл |            |

#### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 07957211190 | <b>PreciControl AMH Plus</b><br>Контрольная сыворотка для антимюллерова гормона (АМГ) | 2 x 2 x 2 мл |            |
| 11731416190 | <b>Precicontrol Universal</b><br>Универсальная контрольная сыворотка                  | 2 x 2 x 3 мл |            |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

### Диагностика и мониторинг беременности

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка    | Примечание  |
|-------------|--|------------|---|
| 03300811190 | <b>HCG Stat</b><br>Хорионический гонадотропин (ХГЧ)<br>экспресс-метод          | 100 тестов | 0,5-10 000 мМЕ/мл<br>9 минут<br>Нельзя использовать на анализаторе MODULAR E170!  |
| 03271749190 | <b>HCG+β</b><br>Суммарный хорионический гонадотропин (ХГЧ + β-ХГЧ)             | 100 тестов | 0,1-10 000 мМЕ/мл   |
| 04481798190 | <b>AFP</b><br>Альфа- фетопроtein (АФП)   | 100 тестов | 0,5-1000 МЕ/мл  |
| 04491742190 | <b>AFP</b><br>Альфа- фетопроtein (АФП)   | 200 тестов | 0,5-1000 МЕ/мл<br>Для анализаторов cobas e 601 / 602 и MODULAR E170   |
| 04854071200 | <b>Free βHCG</b><br>Свободный β-хорионический гонадотропин                     | 100 тестов | 0,1-190 МЕ/л<br>пренатальный скрининг I триместра   |
| 04854098200 | <b>PAPP-A</b><br>Ассоциированный с беременностью плазменный протеин А (PAPP-A) | 100 тестов | 4-10000 мМЕ/л<br>пренатальный скрининг I триместра  |
| 05109523190 | <b>sFit-1</b><br>Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFit-1)             | 100 тестов | 10-85 000 пг/мл<br>Диагностика и прогнозирование развития преэклампсии – тест используется в паре с PIGF Elecsys (арт.№05144671190)   |
| 05144671190 | <b>PIGF</b><br>Плацентарный фактор роста (PIGF)                                | 100 тестов | 3-10 000 пг/мл<br>Расчет риска развития преэклампсии в I триместре.<br>Диагностика и прогнозирование развития преэклампсии – тест используется в паре с sFit-1 Elecsys (арт.№05109523190) |

### Калибраторы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 03303071190 | <b>HCG Stat CalSet</b><br>Калибратор для хорионического гонадотропина (ХГЧ) экспресс-метод              | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03302652190 | <b>HCG+b CalSet</b><br>Калибратор для суммарного хорионического гонадотропина (ХГЧ + β-ХГЧ)             | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 04487761190 | <b>AFP CalSet</b><br>Калибратор для альфа-фетопроteина (АФП)  | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 04854080200 | <b>Free βHCG CalSet</b><br>Калибратор для свободного β-хорионического гонадотропина                     | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 04854101200 | <b>PAPP-A CalSet</b><br>Калибратор для ассоциированного с беременностью плазменного протеина А (PAPP-A) | 2 x 2 x 1 мл |            |



| Арт.№       | Наименование   | Фасовка      | Примечание |
|-------------|--|--------------|------------|
| 05109531190 | <b>sFIt-1 CalSet</b><br>Калибратор для растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFIt-1) | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 05144701190 | <b>PIGF CalSet</b><br>Калибратор для определения плацентарного фактора роста (PIGF)      | 2 x 2 x 1 мл |            |

#### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 11731416190 | <b>Precicontrol Universal</b><br>Универсальная контрольная сыворотка (HCG Stat, HCG+b, AFP)   | 2 x 2 x 3 мл |            |
| 11776452122 | <b>Precicontrol Tumormarker</b><br>Контрольная сыворотка для онкомаркеров (HCG+b, AFP)  | 2 x 2 x 3 мл |            |
| 04899881200 | <b>PreciControl Maternal Care</b><br>Контрольная сыворотка для маркеров материнского скрининга (free b-HCG и PAPP-A)  | 3 x 2 x 2 мл |            |
| 05341787190 | <b>PreciControl MultiMarker</b><br>Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFIt-1), плацентарного фактора роста (PIGF), АКПГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина | 2 x 3 x 2 мл |            |

#### Программа расчета риска синдрома Дауна у плода

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка | Примечание |
|-------------|--|---------|------------|
| 05126193001 | <b>SSdwLab Software (single-userlicense)</b><br>Программа для расчета риска синдрома Дауна у плода, монолицензионная | 1 шт.   |            |

#### Диагностика нарушений роста

| Арт.№       | Наименование                        | Фасовка    | Примечание       |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| 05390125190 | <b>hGH</b><br>Гормон роста человека | 100 тестов | 0,030-50,0 нг/мл |

#### Калибраторы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка      | Примечание |
|-------------|--|--------------|------------|
| 05390133190 | <b>hGH CalSet</b><br>Калибратор для гормона роста человека | 2 x 2 x 1 мл |            |

#### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 05341787190 | <b>PreciControl MultiMarker</b><br>Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFIt 1), плацентарного фактора роста (PIGF), АКПГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина | 2 x 3 x 2 мл |            |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

### Диагностика нарушений эндокринной функции поджелудочной железы

| Арт.№       | Наименование                 | Фасовка    | Примечание       |
|-------------|------------------------------|------------|------------------|
| 12017547122 | <b>Insulin</b><br>Инсулин    | 100 тестов | 0,2-1000 мкМЕ/мл |
| 03184897190 | <b>C-peptide</b><br>С-пептид | 100 тестов | 0,01-40 нг/мл    |

### Калибраторы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 12017504122 | <b>Insulin CalSet</b><br>Калибратор для инсулина    | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03184919190 | <b>C-peptide CalSet</b><br>Калибратор для С-пептида | 2 x 2 x 1 мл |            |

### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 05341787190 | <b>PreciControl MultiMarker</b><br>Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFit 1), плацентарного фактора роста (PIGF), АКГГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина | 2 x 3 x 2 мл |            |

### Диагностика нарушений эндокринной функции надпочечников

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание        |
|-------------|---|------------|-------------------|
| 06687733190 | <b>Cortisol II</b><br>Кортизол (для слюны, сыворотки и плазмы крови)    | 100 тестов | 1,5-1750 нмоль/л  |
| 11875116122 | <b>Cortisol</b><br>Кортизол (для мочи, слюны, сыворотки и плазмы крови) | 100 тестов | 0,5-1750 нмоль/л  |
| 03000087122 | <b>DHEAs</b><br>Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАс)                   | 100 тестов | 0,003-27 мкмоль/л |
| 03255751190 | <b>ACTH</b><br>Адренокортикотропный гормон (АКТГ)                       | 100 тестов | 0,220-440 пмоль/л |

### Калибраторы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание  |
|-------------|---|--------------|---|
| 06687750190 | <b>Cortisol II CalSet</b><br>Калибратор для кортизола (для аппликаций слюны, сыворотки и плазмы крови)    | 2 x 2 x 1 мл | Совместим с реагентом Cortisol II Elecsys<br>Кортизол (для аппликаций слюны, сыворотки и плазмы крови), арт№ 06687733190    |
| 11875124122 | <b>Cortisol CalSet</b><br>Калибратор для кортизола (для аппликаций мочи, слюны, сыворотки и плазмы крови) | 2 x 2 x 1 мл | Совместим с реагентом Cortisol Elecsys<br>Кортизол (для аппликаций мочи, слюны, сыворотки и плазмы крови), арт№ 11875116122 |



| Арт.№       | Наименование   | Фасовка      | Примечание |
|-------------|--|--------------|------------|
| 03000095122 | <b>DHEAs CalSet</b><br>Калибратор для Дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭАс) | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03255760190 | <b>ACTH CalSet</b><br>Калибратор для адренокортикотропного гормона (АКТГ)    | 2 x 2 x 1 мл |            |

#### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 11731416190 | <b>Precicontrol Universal</b><br>Универсальная контрольная сыворотка  | 2 x 2 x 3 мл |            |
| 05341787190 | <b>PreciControl MultiMarker</b><br>Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt 1), плацентарного фактора роста (PlGF), АКТГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина | 2 x 3 x 2 мл |            |

#### Диагностика онкологических заболеваний

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка    | Примечание   |
|-------------|--|------------|--|
| 03271749190 | <b>HCG+β</b><br>Суммарный хорионический гонадотропин (ХГЧ + β-ХГЧ) | 100 тестов | 0,1-10 000 мМЕ/мл  |
| 04481798190 | <b>AFP</b><br>Альфа- фетопроtein (АФП)                             | 100 тестов | 0,5-1000 МЕ/мл   |
| 04491742190 | <b>AFP</b><br>Альфа- фетопроtein (АФП)                             | 200 тестов | 0,5-1000 МЕ/мл<br>Для анализаторов cobas e 601 / 602 и MODULAR E170  |
| 11731629322 | <b>CEA</b><br>Раково-эмбриональный антиген (РЭА)                   | 100 тестов | 0,2-1000 нг/мл   |
| 04491777190 | <b>CEA</b><br>Раково-эмбриональный антиген (РЭА)                   | 200 тестов | 0,2-1000 нг/мл<br>Для анализаторов cobas e 601 / 602 и MODULAR E170  |
| 04641655190 | <b>Total PSA</b><br>Общий простато-специфический антиген (ПСА)     | 100 тестов | 0,003-100 нг/мл  |
| 04491734190 | <b>Total PSA</b><br>Общий простато-специфический антиген (ПСА)     | 200 тестов | 0,003-100 нг/мл<br>Для анализаторов cobas e 601 / 602 и MODULAR E170 |
| 03289788190 | <b>Free PSA</b><br>Свободный простато-специфический антиген (ПСА)  | 100 тестов | 0,01-50 нг/мл  |
| 11776223190 | <b>CA 125 II</b><br>Онкомаркер CA 125                              | 100 тестов | 0,6-5000 МЕ/мл   |
| 05950929190 | <b>HE4</b><br>Онкомаркер HE4                                       | 100 тестов | 15,0-1500 пмоль/л  |
| 11776193122 | <b>CA 19-9</b><br>Онкомаркер CA 19-9                               | 100 тестов | 0,6-1000 МЕ/мл   |

# Сывороточная рабочая зона

Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка    | Примечание   |
|-------------|--|------------|--|
| 03045838122 | <b>CA 15-3 II</b><br>Онкомаркер CA 15-3                    | 100 тестов | 1-300 МЕ/мл<br>Дополнительно требуется дилуэнт № 03183971122 (1 уп. на 3 набора) |
| 11820966122 | <b>CYFRA 21-1</b><br>Онкомаркер Cyfra 21-1                 | 100 тестов | 0,1-500 нг/мл  |
| 03737551190 | <b>Ferritin</b><br>Ферритин                                | 100 тестов | 0,5-2000 нг/мл   |
| 04491785190 | <b>Ferritin</b><br>Ферритин                                | 200 тестов | 0,5-2000 нг/мл   |
| 11776258122 | <b>CA 72-4</b><br>Онкомаркер CA 72-4                       | 100 тестов | 0,2-300 МЕ/мл  |
| 12133113122 | <b>NSE</b><br>Онкомаркер нейроспецифическая эндолаза (NSE) | 100 тестов | 0,05-370 нг/мл   |
| 03175243190 | <b>S100</b><br>Онкомаркер S100                             | 100 тестов | 0,005-39 мкг/л   |
| 06445853190 | <b>Calcitonin</b><br>Кальцитонин                           | 100 тестов | 0,5-2000 пг/мл   |
| 06445896190 | <b>Tg II</b><br>Тиреоглобулин (ТГ)                         | 100 тестов | 0,04-500 нг/мл   |
| 06513107190 | <b>Tg II Confirmatory Test</b><br>ТГ подтверждающий        | 50 тестов  | 0,1-1000 мкг/л   |
| 06505961190 | <b>ProGRP</b><br>Прогастрин релизинг пептид                | 100 тестов | 3.00-5000 пг/мл  |

## Калибраторы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 03302652190 | <b>HCG+b CalSet</b><br>Калибратор для суммарного хорионического гонадотропина (ХГЧ + β-ХГЧ) | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 04487761190 | <b>AFP CalSet</b><br>Калибратор для альфа- фетопroteина (АФП)                               | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 11731645322 | <b>CEA CalSet</b><br>Калибратор для раково-эмбрионального антигена (РЭА)                    | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 04485220190 | <b>Total PSA CalSet</b><br>Калибратор для общего простато-специфического антигена (ПСА)     | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03289796190 | <b>Free PSA CalSet</b><br>Калибратор для свободного простато-специфического антиген (ПСА)   | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 07030207190 | <b>CA 125 II CalSet</b><br>Калибратор для онкомаркера CA 125                                | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 05950945190 | <b>HE4 CalSet</b><br>Калибратор для онкомаркера HE4   | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 11776215122 | <b>CA 19-9 CalSet</b><br>Калибратор для онкомаркера CA 19-9                                 | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03045846122 | <b>CA 15-3 II CalSet</b><br>Калибратор для онкомаркера CA 15-3                              | 2 x 2 x 1 мл |            |



| Арт.№       | Наименование   | Фасовка      | Примечание |
|-------------|--|--------------|------------|
| 11820974322 | <b>CYFRA 21-1 CalSet</b><br>Калибратор для онкомаркера Cyfra 21-1                | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03737586190 | <b>Ferritin CalSet</b><br>Калибратор для ферритина                               | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 11776274122 | <b>CA 72-4 CalSet</b><br>Калибратор для онкомаркера CA 72-4                      | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 12133121122 | <b>NSE CalSet</b><br>Калибратор для онкомаркера нейроспецифической энолазы (NSE) | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03289834190 | <b>S100 CalSet</b><br>Калибратор для онкомаркера S100                            | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 06445861190 | <b>Calcitonin CalSet</b><br>Калибратор для кальцитонина                          | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 06445900190 | <b>Tg II CalSet</b><br>Калибратор для тиреоглобулина                             | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 06505970190 | <b>ProGRP CalSet</b><br>Калибратор для прогастрин релизинг пептида               | 2 x 2 x 1 мл |            |

#### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 11776452122 | <b>Precicontrol Tumormarker</b><br>Контрольная сыворотка для определения онкомаркеров   | 2 x 2 x 3 мл |            |
| 11731416190 | <b>Precicontrol Universal</b><br>Универсальная контрольная сыворотка (включены онкомаркеры: HCG+b, CEA, AFP, Total PSA, Tg, S100) | 2 x 2 x 3 мл |            |
| 05950953190 | <b>PreciControl HE4</b><br>Контрольная сыворотка для онкомаркера HE4  | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 05618860190 | <b>PreciControl Varia</b><br>Контрольная сыворотка Varia для кальцитонина   | 2 x 2 x 3 мл |            |
| 06505988190 | <b>PreciControl ProGRP</b><br>Контрольная сыворотка для прогастрин релизинг пептида   | 2 x 2 x 1 мл |            |

#### Диагностика инфекционных заболеваний

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание        |
|-------------|---|------------|-------------------|
| 04687787190 | <b>HBsAg II*</b><br>Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)  | 100 тестов | Качественный тест |
| 07914482190 | <b>HBsAg II*</b><br>Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)  | 200 тестов | Качественный тест |
| 11820648122 | <b>HBsAg confirmatory test</b><br>Подтверждение присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) | 20 тестов  | Качественный тест |
| 05894816190 | <b>Anti-HBs II*</b><br>Антитела к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg)                                  | 100 тестов | 2,00-1000 МЕ/л    |
| 06771823190 | <b>Anti-HBs II*</b><br>Антитела к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg)                                  | 200 тестов | 2,0-1000 МЕ/л     |
| 07374160190 | <b>Anti-HBc II*</b><br>Антитела IgM и IgG к ядерному антигену вируса гепатита В (Anti-HBc)                    | 100 тестов | Качественный тест |
| 07394764190 | <b>Anti-HBc II*</b><br>Антитела IgM и IgG к ядерному антигену вируса гепатита В (Anti-HBc)                    | 200 тестов | Качественный тест |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка       | Примечание   |
|-------------|--|---------------|--|
| 11820613122 | <b>Anti-HBe*</b><br>Антитела к антигену гепатита В (HBeAg)   | 100 тестов    | Качественный тест  |
| 11820583122 | <b>HBeAg*</b><br>Поверхностный антиген гепатита В (HBeAg)  | 100 тестов    | Качественный тест  |
| 11820567122 | <b>Anti-HBc IgM*</b><br>Антитела к ядерному антигену вирусу гепатита В IgM   | 100 тестов    | Качественный тест<br>Дополнительно требуется дилуэнт №11732277122 или № 03183971122                                |
| 11820591122 | <b>Anti-HAV IgM*</b><br>Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM)   | 100 тестов    | Качественный тест<br>Дополнительно требуется дилуэнт №11732277122 или № 03183971122                                |
| 04854977190 | <b>Anti-HAV*</b><br>Общие антитела к вирусу гепатита А (Anti-HAV)  | 100 тестов    | 3,0-60 МЕ/л  |
| 06368921190 | <b>Anti-HCV* II</b><br>Антитела к вирусу гепатита С (HCV)  | 100 тестов    | Качественный тест  |
| 06427405190 | <b>Anti-HCV* II</b><br>Антитела к вирусу гепатита С (HCV)  | 200 тестов    | Качественный тест  |
| 11971611122 | <b>HIV Ag*</b><br>Антиген р24 вируса иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ1, группы М и О)  | 100 тестов    | Качественный тест  |
| 12001101122 | <b>HIV Ag Confirmatory Test</b><br>Подтверждение по ВИЧ-1 р24-антигену   | 2 x 20 тестов | Качественный тест  |
| 05390095190 | <b>HIV Combi PT* (включая группу O)</b><br>Скрининг на антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 р24-антигену (с предварительной обработкой образца) | 100 тестов    | Качественный тест  |
| 07914504190 | <b>HIV combi PT* (включая группу O)</b><br>Скрининг на антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 р24-антигену (с предварительной обработкой образца) | 200 тестов    | Качественный тест  |
| 04618793190 | <b>Rubella IgG*</b><br>IgG-антитела к вирусу краснухи  | 100 тестов    | 0,17-500 МЕ/мл   |
| 04618831190 | <b>Rubella IgM*</b><br>IgM-антитела к вирусу краснухи  | 100 тестов    | Качественный тест<br>Дополнительно требуется дилуэнт № 03183971122, 1 уп. на 3 набора                              |
| 04618815190 | <b>Toxo IgG*</b><br>IgG-антитела к токсоплазме   | 100 тестов    | 0,13-650 МЕ/мл   |
| 04618858190 | <b>Toxo IgM*</b><br>IgM-антитела к токсоплазме   | 100 тестов    | Качественный тест<br>Дополнительно требуется дилуэнт № 03183971122, 1 уп. на 3 набора                              |
| 05802571190 | <b>Toxo IgG Avidity*</b><br>Авидность>Toxo IgG-антител   | 100 тестов    | Качественный тест<br>100 тестов соответствует 50 исследованиям для определения авидности IgG-антител к токсоплазме |
| 04784596190 | <b>CMV IgG*</b><br>IgG- антитела к цитомегаловирусу  | 100 тестов    | 0,25-500 МЕ/мл   |
| 04784618190 | <b>CMV IgM*</b><br>IgM- антитела к цитомегаловирусу  | 100 тестов    | Качественный тест<br>Дополнительно требуется дилуэнт № 03183971122, 1 уп. на 3 набора                              |





| Арт.№       | Наименование   | Фасовка    | Примечание   |
|-------------|--|------------|--|
| 05909708190 | <b>CMV IgG* Avidity</b><br>Авидность IgG-антител к ЦМВ             | 100 тестов | Качественный тест<br>100 тестов соответствует<br>50 исследованиям для<br>определения avidности IgG-<br>антител к ЦМВ |
| 05572185190 | <b>HSV-1 IgG*</b><br>IgG-антитела к ВПГ 1-го типа                  | 100 тестов | Качественный тест  |
| 05572193190 | <b>HSV-2 IgG*</b><br>IgG-антитела к ВПГ 2-го типа                  | 100 тестов | Качественный тест  |
| 06923348190 | <b>Syphilis*</b><br>Суммарные антитела к <i>Treponema pallidum</i> | 100 тестов | Качественный тест  |

\* Калибраторы входят в состав набора.

#### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка         | Примечание  |
|-------------|---|-----------------|---|
| 04687876190 | <b>PreciControl HBsAg II</b><br>Контрольная сыворотка для HBsAg II  | 2 x 8 x 1,3 мл  |   |
| 11876317122 | <b>Precicontrol anti-HBs</b><br>Контрольная сыворотка для anti-HBs  | 2 x 8 x 1,3 мл  |   |
| 04927931190 | <b>Precicontrol anti-HBc</b><br>Контрольная сыворотка для anti-HBc  | 2 x 8 x 1,3 мл  |   |
| 11876333122 | <b>Precicontrol anti-HBc IgM</b><br>Контрольная сыворотка для anti-HBc IgM  | 2 x 8 x 1 мл    |   |
| 11876376122 | <b>Precicontrol HBeAg</b><br>Контрольная сыворотка для HBeAg  | 2 x 8 x 1,3 мл  |   |
| 11876384122 | <b>Precicontrol Anti-Hbe</b><br>Контрольная сыворотка для anti-HBe  | 2 x 8 x 1,3 мл  |   |
| 11876368122 | <b>Precicontrol anti-HAV IgM</b><br>Контрольная сыворотка для anti-HAV IgM  | 2 x 8 x 0,67 мл |   |
| 04855043190 | <b>Precicontrol anti-HAV</b><br>Контрольная сыворотка по anti-HAV   | 2 x 2 x 4 мл    |   |
| 03290379190 | <b>PreciControl Anti-HCV</b><br>Контрольная сыворотка по anti-HCV   | 2 x 8 x 1,3 мл  |   |
| 05162645190 | <b>PreciControl HIV</b><br>Контрольная сыворотка для ВИЧ (при использовании тест-систем «HIV Combi», «HIV Combi PT», «HIV Ag»)        | 3 x 2 x 2 мл    | Контрольная сыворотка только для ВИЧ HIV combi PT* (арт. № 05390095190) |
| 06924107190 | <b>PreciControl HIV Gen II</b><br>Контрольная сыворотка для ВИЧ (при использовании тест-систем «HIV Combi», «HIV Combi PT», «HIV Ag») | 3 x 2 x 2 мл    |   |
| 04618807190 | <b>PreciControl Rubella IgG</b><br>Контрольная сыворотка для Rubella IgG  | 2 x 8 x 1 мл    |   |
| 04618840190 | <b>PreciControl Rubella IgM</b><br>Контрольная сыворотка для Rubella IgM  | 2 x 4 x 1 мл    |   |
| 04618823190 | <b>PreciControl Toxo IgG</b><br>Контрольная сыворотка для Toxo IgG  | 2 x 8 x 1 мл    |   |
| 04618866190 | <b>PreciControl Toxo IgM</b><br>Контрольная сыворотка для Toxo IgM  | 2 x 8 x 0,67 мл |   |
| 05802580190 | <b>PreciControl Toxo IgG Avidity</b><br>Контрольная сыворотка для определения avidности Toxo IgG-антител                              | 2 x 3 x 2 мл    |   |

# Сывороточная рабочая зона

Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 04784600190 | <b>PreciControl CMV IgG</b><br>Контрольная сыворотка для определения анти-тел класса IgG к цитомегаловирусу | 2 x 8 x 1 мл |            |
| 04784626190 | <b>PreciControl CMV IgM</b><br>Контрольная сыворотка для определения анти-тел класса IgM к цитомегаловирусу | 2 x 8 x 1 мл |            |
| 05942322190 | <b>PreciControl CMV IgG Avidity</b><br>Контрольная сыворотка для определения авидности IgG- антител к ЦМВ   | 2 x 3 x 1 мл |            |
| 05572207190 | <b>PreciControl HSV</b><br>Контрольная сыворотка для определения IgG-антител к ВПГ 1-го и 2-го типов        | 2 x 2 x 3 мл |            |
| 06923364190 | <b>PreciControl Syphilis</b><br>Контрольная сыворотка для суммарных антител к <i>Treponema pallidum</i>     | 2 x 2 x 2 мл |            |

## Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний

| Арт.№        | Наименование  | Фасовка    | Примечание   |
|--------------|---|------------|--|
| 05092728190  | <b>Troponin T hs STAT</b><br>Тропонин Т высокочувствительный экспресс-метод     | 100 тестов | 3-10000 нг/л<br>9 минут<br>Нельзя использовать на анализаторе MODULAR E170!  |
| 05092744190  | <b>Troponin T hs</b><br>Тропонин Т высокочувствительный метод                   | 200 тестов | 3-10000 нг/л<br>18 минут   |
| 05094810190  | <b>Troponin I</b><br>Тропонин I   | 100 тестов | 0,16-25,00 нг/мл<br>Только для анализаторов MODULAR E170 и cobas e 601/602!  |
| 05094798190  | <b>Troponin I STAT</b><br>Тропонин I экспресс-метод                             | 100 тестов | 0,16-25 нг/мл<br>9 минут<br>Нельзя использовать на анализаторе MODULAR E170! |
| 05957648190  | <b>CK-MB STAT</b><br>МВ-изоэнзим креатинкиназы (CK-MB) экспресс-метод           | 100 тестов | 0,3-300 нг/мл<br>9 минут<br>Нельзя использовать на анализаторе MODULAR E170! |
| 05894808190  | <b>CK-MB</b><br>МВ-изоэнзим креатинкиназы (CK-MB)                               | 100 тестов | 0,3-300 нг/мл<br>18 минут  |
| 011820788122 | <b>Myoglobin STAT</b><br>Миоглобин экспресс-метод                               | 100 тестов | 21-3000 нг/мл<br>9 минут<br>Нельзя использовать на MODULAR E170!             |
| 12178214122  | <b>Myoglobin</b><br>Миоглобин   | 100 тестов | 21-3000 нг/мл<br>18 минут  |
| 04842464190  | <b>proBNP II</b><br>N-концевой пронатрийуретический пептид B-типа (NT-proB- NP) | 100 тестов | 0,6-4130 пкмоль/л  |
| 11820796190  | <b>Digoxin</b><br>Дигоксин  | 100 тестов | 0,15-5,0 нг/мл   |
| 03002659122  | <b>Digitoxin</b><br>Дигитоксин  | 100 тестов | 2,62-105 нмоль/л   |



### Калибраторы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка        | Примечание |
|-------------|--|----------------|------------|
| 05092736190 | <b>Troponin T hs STAT CalSet</b><br>Калибратор для тропонина Т высокочувствительного STAT                | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 05092752190 | <b>Troponin T hs CalSet</b><br>Калибратор для тропонина Т высокочувствительного                          | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 05094828190 | <b>Troponin I CalSet</b><br>Калибратор для тропонина I   | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 05094801190 | <b>Troponin I STAT CalSet</b><br>Калибратор для тропонина I STAT   | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 05957656190 | <b>CK-MB (STAT) CalSet</b><br>Калибратор для MB-изоэнзим креатинкиназы (CK-MB) STAT                      | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 05957664190 | <b>CK-MB CalSet</b><br>Калибратор для MB-изоэнзим креатинкиназы (CK-MB)                                  | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 11820893122 | <b>Myoglobin (STAT) CalSet</b><br>Калибратор для миоглобина STAT   | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 12178222122 | <b>Myoglobin CalSet</b><br>Калибратор для миоглобина   | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 04842472190 | <b>proBNP II CalSet</b><br>Калибратор для N-концевого пронатрийуретического пептида B-типа (NT-proB- NP) | 2 x 2 x 1 мл   |            |
| 11820907322 | <b>Digoxin CalSet</b><br>Калибратор для дигоксина  | 2 x 2 x 1,5 мл |            |
| 03002667122 | <b>Digitoxin CalSet</b><br>Калибратор для дигитоксина  | 2 x 2 x 1 мл   |            |

### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 04917049190 | <b>Precicontrol Cardiac</b><br>Контрольная сыворотка для CK-MB, миоглобина, дигоксина, дигитоксина, NT-proB- NP                                 | 2 x 2 x 2 мл |            |
| 05095107190 | <b>PreciControl Troponin</b><br>Контрольная сыворотка для тропонина Т высокочувствительного (экспресс-метод - 9 минут и 18 минут) и тропонина I | 2 x 2 x 2 мл |            |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

### Диагностика анемий

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание        |
|-------------|---|------------|-------------------|
| 07212771190 | <b>B12</b><br>Витамин B12   | 100 тестов | 36,9-1476 пмоль/л |
| 07559992190 | <b>Folate III</b><br>Фолиевая кислота   | 100 тестов | 1,45-45,4 нмоль/л |
| 05944295190 | <b>Folate RBC</b><br>Фолиевая кислота в эритроцитах                                 | 100 тестов | 272-1407 нмоль/л  |
| 05944317190 | <b>Folate RBC Hemolyzing reagents</b><br>Набор реагентов, гемолизирующих эритроциты | 4 x 200 мл |                   |
| 03737551190 | <b>Ferritin</b><br>Ферритин   | 100 тестов | 0,5-2000 нг/мл    |
| 04491785190 | <b>Ferritin</b><br>Ферритин   | 200 тестов | 0,5-2000 нг/мл    |

### Калибраторы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 07212780190 | <b>B12 CalSet</b><br>Калибратор для витамина B12                          | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 07560001190 | <b>Folate III CalSet</b><br>Калибратор для фолиевой кислоты               | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03737586190 | <b>Ferritin CalSet</b><br>Калибратор для ферритина                        | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 05944309190 | <b>Folate RBC CalSet</b><br>Калибратор для фолиевой кислоты в эритроцитах | 2 x 2 x 1 мл |            |

### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 05618860190 | <b>PreciControl Varia</b><br>Контрольная сыворотка Varia для: витамина B12, ферритина, фолатов, $\beta$ -CrossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина Д | 2 x 2 x 3 мл |            |

### Диагностика аллергических состояний

| Арт.№       | Наименование                            | Фасовка    | Примечание     |
|-------------|---|------------|----------------|
| 04827031190 | <b>IgE II</b><br>Иммуноглобулин E (IgE) | 100 тестов | 0,1-2500 МЕ/мл |

### Калибраторы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 11930427122 | <b>IgE CalSet</b><br>Калибратор для иммуноглобулина E (IgE) | 2 x 2 x 1 мл |            |



### Контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка      | Примечание |
|-------------|--|--------------|------------|
| 11731416190 | <b>Precicontrol Universal</b><br>Универсальная контрольная сыворотка | 2 x 2 x 3 мл |            |

### Маркеры костного обмена

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка    | Примечание                               |
|-------------|--|------------|--|
| 12149133122 | <b>N-MID Osteocalcin</b><br>N-MID Остеокальцин   | 100 тестов | 0,5-300 нг/мл                            |
| 11972103122 | <b>PTH</b><br>Паратгормон (18 минут)   | 100 тестов | 0,127-530 пмоль/л                        |
| 04892470190 | <b>PTH STAT</b><br>Паратгормон экспресс-метод (9 минут)  | 100 тестов | 0,127-530 пмоль/л<br>Не для Modular e170 |
| 05608546190 | <b>PTH (1-84)</b><br>Паратгормон 1-84 (18 минут)   | 100 тестов | 0,583-244 пмоль/л                        |
| 11972308122 | <b>b-CrossLaps/Serum</b><br>b-CrossLaps в сыворотке крови (C концевой телопептид коллагена I типа) | 100 тестов | 0,01-6,0 нг/мл                           |
| 03141071190 | <b>Total P1NP</b><br>Общий P1NP (N-терминальный пропептид коллагена I типа)                        | 100 тестов | 5-1200 мкг/л                             |
| 05894913190 | <b>Vitamin D Total</b><br>Общий Витамин Д  | 100 тестов | 3,00-70,0 нг/мл<br>или 7,50-175 нмоль/л  |

### Калибраторы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание |
|-------------|---|--------------|------------|
| 11972111122 | <b>N-MID Osteocalcin CalSet</b><br>Калибратор для N-MID остеокальцина             | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 11972219122 | <b>PTH CalSet</b><br>Калибратор для паратгормона (18 минут)                       | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 04894138190 | <b>PTH STAT CalSet</b><br>Калибратор для паратгормона экспресс-метод (9 минут)    | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 05608554190 | <b>PTH (1-84) CalSet</b><br>Калибратор для паратгормона (1-84)                    | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 11972316122 | <b>b-CrossLaps CalSet</b><br>Калибратор для b-CrossLaps                           | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 03141080190 | <b>Total P1NP CalSet</b><br>Калибратор для общего P1NP                            | 2 x 2 x 1 мл |            |
| 05894921190 | <b>Vitamin D Total CalSet</b><br>Калибратор для количественного общего витамина Д | 2 x 2 x 1 мл |            |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка    | Примечание<br>Кол-во тестов** |
|-------------|--|------------|-------------------------------|
| 11776576322 | <b>CalSet Vials Elecsys</b><br>Набор флаконов для аликвотирования разведенных калибраторов | 2 x 56 шт. |                               |
| 11930346122 | <b>Sys Wash Elecsys</b><br>Моющий раствор для добавления в дистиллированную воду           | 500 мл     | 3300 тестов                   |
| 10394246001 | <b>SAMPLE CUPS (5000 рс/пак)</b><br>Пробирки для образцов (5000 шт. / уп.)                 | 5000 шт.   |                               |
| 11933159001 | <b>SysClean-Adapter</b><br>Адаптер для промывки  | 1 шт.      |                               |

### Расходные материалы для анализаторов cobas e601/602, Modular E170

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка        | Примечание<br>Кол-во тестов**                      |
|-------------|---|----------------|--|
| 03004899190 | <b>PreClean M</b><br>Буфер для предварительной промывки M                                       | 5 x 600 мл     | 3000-4000 тестов                                   |
| 03005712190 | <b>ProbeWash M</b><br>Буфер для промывки пробозаборника   | 12 x 70 мл     | 2 уп/год<br>12 уп/год если есть инф. маркеры       |
| 04880340190 | <b>Procell M</b><br>Субстрат-реагент Procell M  | 2 бут. x 2 л   | 1300-1500 тестов + 10 шт на ежегодное обслуживание |
| 04880293190 | <b>Cleancell M</b><br>Промывающий буфер Cleancell M для платформы MODULAR и cobas 6000          | 2 бут. x 2 л   | 1300-1500 тестов + 10 шт на ежегодное обслуживание |
| 12102137001 | <b>AssayCups/Tips Combi M</b><br>Комплект аналитических пробирок и одноразовых наконечников     | 1 уп.          | 3600-4000 тестов                                   |
| 11729306122 | <b>BlankCell Elecsys</b><br>Реагент для проведения фоновой пробы                                | 2 x 50 мл      |  |
| 05151643001 | <b>Measuring Cell with reference electrode</b><br>Измерительная ячейка с референсным электродом | 1 шт.          | ~2 шт/год  |
| 03023141001 | <b>PC/CC-Cups</b><br>Флаконы для Procell и Cleancell  | 1 уп. x 12 шт. | 4 шт/год   |
| 03027651001 | <b>SysClean-Adapter M</b><br>Адаптер для промывки ячейки  | 1 шт.          | 2 шт/год   |
| 10394246001 | <b>SAMPLE CUPS</b><br>Пробирки для образцов   | 5000 шт./уп.   |  |

\*\* Ориентировочный расход при средней загрузке прибора.



## Универсальные контроли

## Индивидуальные контроли

|  | PreciControl Universal | PreciControl Thyro AB | PreciControl Tumor Marker | PreciControl Varia | PreciControl Maternal Care | PreciControl MultiMarker | PreciControl Troponin | PreciControl Cardiac | PreciControl Thyro Sensitive |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|

|  | PreciControl HE4 | PreciControl Anti-CCP | PreciControl AMH Plus | PreciControl ProGRP |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|

### Диагностика нарушений функции щитовидной железы

|           | PreciControl Universal | PreciControl Thyro AB | PreciControl Tumor Marker | PreciControl Varia | PreciControl Maternal Care | PreciControl MultiMarker | PreciControl Troponin | PreciControl Cardiac | PreciControl Thyro Sensitive |
|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| TSH       | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      | •                            |
| T3        | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| FT3       | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| T4        | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| FT4       | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| T-Uptake  | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| Tg        | •                      |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      | •                            |
| Anti-TPO  |                        | •                     |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| Anti-TG   |                        | •                     |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| Anti-TSHR |                        | •                     |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |

|  | PreciControl HE4 | PreciControl Anti-CCP | PreciControl AMH Plus | PreciControl ProGRP |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |

### Диагностика нарушений функции паращитовидной железы

|          | PreciControl Universal | PreciControl Thyro AB | PreciControl Tumor Marker | PreciControl Varia | PreciControl Maternal Care | PreciControl MultiMarker | PreciControl Troponin | PreciControl Cardiac | PreciControl Thyro Sensitive |
|----------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| PTH      |                        |                       |                           | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |
| PTH STAT |                        |                       |                           | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |
| PTH 1-84 |                        |                       |                           | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |

|  | PreciControl HE4 | PreciControl Anti-CCP | PreciControl AMH Plus | PreciControl ProGRP |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |

### Диагностика эндокринных нарушений репродуктивной функции

|                  | PreciControl Universal | PreciControl Thyro AB | PreciControl Tumor Marker | PreciControl Varia | PreciControl Maternal Care | PreciControl MultiMarker | PreciControl Troponin | PreciControl Cardiac | PreciControl Thyro Sensitive |
|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| AMH              |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| LH               | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| FSH              | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| Estradiol III    | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| Prolactin II     | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| Progesterone III | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| Testosterone II  | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |
| SHBG             | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |

|  | PreciControl HE4 | PreciControl Anti-CCP | PreciControl AMH Plus | PreciControl ProGRP |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|  |                  |                       | •                     |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |
|  |                  |                       |                       |                     |

# Сывороточная рабочая зона

## Универсальные контроли

## Индивидуальные контроли

|   | PreciControl Universal | PreciControl Thyro AB | PreciControl Tumor Marker | PreciControl Varia | PreciControl Maternal Care | PreciControl MultiMarker | PreciControl Troponin | PreciControl Cardiac | PreciControl Thyro Sensitive | PreciControl HE4 | PreciControl Anti-CCP | PreciControl AMH Plus | PreciControl ProGRP |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Диагностика и мониторинг беременности</b>                          |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| HCG STAT  | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Free b-HCG  |                        |                       |                           |                    | •                          |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| PAPP-A  |                        |                       |                           |                    | •                          |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| sFit-1  |                        |                       |                           |                    |                            | •                        |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| PIGF  |                        |                       |                           |                    |                            | •                        |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| <b>Диагностика нарушений роста</b>                                    |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| hGH   |                        |                       |                           |                    |                            | •                        |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| <b>Диагностика нарушений эндокринной функции поджелудочной железы</b> |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Insulin   | •                      |                       |                           |                    |                            | •                        |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| C-peptide   |                        |                       |                           |                    |                            | •                        |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| <b>Диагностика нарушений эндокринной функции надпочечников</b>        |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Cortisol  | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| DHEA  | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| ACTH  |                        |                       |                           |                    |                            | •                        |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| <b>Онкомаркеры</b>  |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| HCG+b   | •                      |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| AFP   | •                      |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| CEA   | •                      |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Total PSA   | •                      |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Free PSA  |                        |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| CA 125  |                        |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| HE4   |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      | •                            |                  |                       |                       |                     |
| CA 19-9   |                        |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| CA 15-3   |                        |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| CYFRA 21-1  |                        |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Ferritin  |                        |                       | •                         | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| CA 72-4   |                        |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| NSE   |                        |                       | •                         |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| S100  | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Calcitonin  |                        |                       |                           | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| proGRP  |                        |                       |                           | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       | •                   |





## Универсальные контроли      Индивидуальные контроли

|  | PreciControl Universal | PreciControl Thyro AB | PreciControl Tumor Marker | PreciControl Varia | PreciControl Maternal Care | PreciControl MultiMarker | PreciControl Troponin | PreciControl Cardiac | PreciControl Thyro Sensitive | PreciControl HE4 | PreciControl Anti-CCP | PreciControl AMH Plus | PreciControl ProGRP |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Диагностика сердечно-сосудистой патологии</b> |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Troponin I                                       |                        |                       |                           |                    |                            |                          | •                     |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Troponin T hs                                    |                        |                       |                           |                    |                            |                          | •                     |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| CK-MB  |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       | •                    |                              |                  |                       |                       |                     |
| Myo  |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       | •                    |                              |                  |                       |                       |                     |
| proBNP   |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       | •                    |                              |                  |                       |                       |                     |
| Digoxin  |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       | •                    |                              |                  |                       |                       |                     |
| Digitoxin  |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       | •                    |                              |                  |                       |                       |                     |
| <b>Диагностика анемий</b>                        |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| B12  |                        |                       |                           | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Folate   |                        |                       |                           | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| <b>Диагностика аллергических состояний</b>       |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| IgE  | •                      |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| <b>Маркеры костного обмена</b>                   |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| N-MID  |                        |                       |                           | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| b-CrossLaps                                      |                        |                       |                           | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Total P1NP                                       |                        |                       |                           | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Vitamin D  |                        |                       |                           | •                  |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| <b>Диагностика ревматоидного артрита</b>         |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| Anti-CCP   |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              | •                |                       |                       |                     |
| <b>Диагностика сепсиса</b>                       |                        |                       |                           |                    |                            |                          |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |
| IL-6   |                        |                       |                           |                    |                            | •                        |                       |                      |                              |                  |                       |                       |                     |

# Сывороточная рабочая зона

## Индивидуальные контроли

|                  | PreciControl Anti-HAV | PreciControl Anti-HAV IgM | PreciControl Anti-HBc | PreciControl Anti-HBc IgM | PreciControl Anti-Hbe | PreciControl Anti-Hbs | PreciControl Anti-HCV | PreciControl CMV IgG | PreciControl CMV IgG Avidity | PreciControl CMV IgM | PreciControl HBeAg | PreciControl HBsAg | PreciControl HIV | PreciControl HSV | PreciControl Rubella IgG | PreciControl Rubella IgM | PreciControl Toxo IgG | PreciControl Toxo IgG Avidity | PreciControl Toxo IgM | PreciControl Syphilis |
|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anti-HAV         | •                     |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| Anti-HAV IgM     |                       | •                         |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| Anti-HBc         |                       |                           | •                     |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| Anti-HBc IgM     |                       |                           |                       | •                         |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| Anti-Hbe         |                       |                           |                       |                           | •                     |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| Anti-HBs         |                       |                           |                       |                           |                       | •                     |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| Anti-HCV II      |                       |                           |                       |                           |                       |                       | •                     |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| CMV IgG          |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       | •                    |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| CMV IgG Avidity  |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      | •                            |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| CMV IgM          |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              | •                    |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| HBeAg            |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      | •                  |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| HBsAg            |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    | •                  |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| HIV Ag           |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    | •                |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| HIV Combi        |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    | •                |                  |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| HSV-1 IgG        |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  | •                |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| HSV-2 IgG        |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  | •                |                          |                          |                       |                               |                       |                       |
| Rubella IgG      |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  | •                        |                          |                       |                               |                       |                       |
| Rubella IgM      |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          | •                        |                       |                               |                       |                       |
| Toxo IgG         |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          | •                     |                               |                       |                       |
| Toxo IgG Avidity |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       | •                             |                       |                       |
| Toxo IgM         |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               | •                     |                       |
| Syphilis         |                       |                           |                       |                           |                       |                       |                       |                      |                              |                      |                    |                    |                  |                  |                          |                          |                       |                               |                       | •                     |

# Расходные материалы для преаналитических систем



| Арт.№       | Наименование  | Фасовка      | Примечание                 |
|-------------|---|--------------|----------------------------|
| 04453999001 | <b>BC label 50x18mm (4x7500 pcs)</b><br>Этикетки штрих-кода, 50x18мм  | 4 x 7500 шт. |                            |
| 04454111001 | <b>Ribbon tape 50x18mm (2x360m)</b><br>Лента красящая для принтера штрих-кода, 50x18мм  | 2 x 360м     | Расход 20 мм на 1 аликвоту |
| 04976274001 | <b>Disposable tips non-conductive 1000 ul, 10x960 pcs, in racks</b><br>Наконечники одноразовые непроводящие, 1000 мкл, в лотках   | 10 x 960 шт. |                            |
| 08785147001 | <b>ep Dualfilter TIPS, 50-1000ul, 10x96</b><br>Изделия Eppendorf из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники с фильтрами epDualfilter T.I.P.S. для дозаторов объемом от 50 мкл до 1000 мкл, в боксах, стерильные (epDualfilter T.I.P.S.), 10X96 шт | 960 шт.      |                            |
| 04453859001 | <b>Sealing foil d=21 for Recapper (4500pcs)</b><br>Фольга алюминиевая для запечатывания, d=21мм   | 9 x 500 шт.  |                            |

\*\* Ориентировочный расход при средней загрузженности прибора.

# Реагенты и расходные материалы для анализаторов мочи

## Реагенты и расходные материалы для автоматического анализатора мочи cobas u 601

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка       | Примечание |
|-------------|--|---------------|------------|
| 06334601001 | <b>cobas u pack (400 strips)</b><br>Кассета с тест-полосками cobas u pack для автоматического анализатора мочи cobas u 601 | 1 x 400 шт.   |            |
| 06390579001 | <b>cobas u calibration strip, 25 pcs</b><br>Калибровочные тест-полоски cobas u calibration strip, 25 шт.                   | 1 x 25 шт.    |            |
| 04537211001 | <b>Liquichek Urinalysis Control</b><br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи»            | 2 x 6 x 12 мл |            |
| 03110435180 | <b>Deproteinizer</b><br>Раствор для антисептики  | 1 x 125 мл    |            |
| 06390544001 | <b>Waste box carton, 30 pcs</b><br>Картонная коробка, 30 шт.   | 1 x 30 шт.    |            |

## Реагенты и расходные материалы для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка       | Примечание |
|-------------|---|---------------|------------|
| 06390552001 | <b>cobas u cuvette</b><br>Кассета cobas u cuvette для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701       | 1 x 400 шт.   |            |
| 04537211001 | <b>Liquichek Urinalysis Control</b><br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи» | 2 x 6 x 12 мл |            |
| 03110435180 | <b>Deproteinizer</b><br>Раствор для антисептики   | 1 x 125 мл    |            |
| 06390544001 | <b>Waste box carton, 30 pcs</b><br>Картонная коробка, 30 шт.  | 1 x 30 шт.    |            |

## Реагенты и расходные материалы для анализатора мочи Urisys 2400

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка       | Примечание |
|-------------|---|---------------|------------|
| 03012557061 | <b>Urisys 2400 Cassette 400 Str.</b><br>Кассеты Urisys 2400, 400 тест-полосок                                   | 1 x 400 шт.   |            |
| 03012590061 | <b>Urisys 2400 Calibration Strip</b><br>Калибровочные тест-полоски Urisys 2400                                  | 1 x 25 шт.    |            |
| 04880285190 | <b>NaOH-D cell wash solution 1 (base wash Detergent 1)</b><br>Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки       | 2 x 1,8 л     |            |
| 04537211001 | <b>Liquichek Urinalysis Control</b><br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи» | 2 x 6 x 12 мл |            |

## Реагенты и расходные материалы для анализатора мочи cobas u 411

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка     | Примечание |
|-------------|--|-------------|------------|
| 11379208077 | Тест-полоски <b>Combur 10 Test M</b><br>Тест-полоски Combur 10 Test M для анализа мочи на приборах по 10 параметрам: относительная плотность, кислотность (pH), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь | 1 x 100 шт. |            |



| Арт.№       | Наименование  | Фасовка       | Примечание |
|-------------|---|---------------|------------|
| 11379194263 | <b>Control-Test M 50 tests</b><br>Тест-полоски калибровочные Control-Test M                                     | 1 x 50 шт.    |            |
| 04352483001 | <b>Printer Paper, 5 rolls</b><br>Бумага для принтера  | 1 x 5 шт.     |            |
| 04537211001 | <b>Liquichek Urinalysis Control</b><br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи» | 2 x 6 x 12 мл |            |

#### Расходные материалы для анализатора мочи Urisys 1100

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка       | Примечание |
|-------------|---|---------------|------------|
| 11544373191 | <b>Combur 10 test UX 100 tests</b><br>Тест полоски «Комбур 10 тест УИкс» для анализа мочи по 10 параметрам: относительная плотность, кислотность (pH), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь | 1 x 100 шт.   |            |
| 11379194263 | <b>Control-Test M 50 tests</b><br>Тест-полоски калибровочные «Контрол Тест М»   | 1 x 50 шт.    |            |
| 04409019001 | Thermo-printer paper, 57 mm<br>Термобумага для принтера, 57 мм  | 1 x 1 шт.     |            |
| 04537211001 | <b>Liquichek Urinalysis Control</b><br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи»   | 2 x 6 x 12 мл |            |

#### Расходные материалы для анализаторов мочи серии «Мидитрон» (Мидитрон М+СТ, Мидитрон Юниор)

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка       | Примечание |
|-------------|--|---------------|------------|
| 11379208077 | Тест-полоски <b>Combur 10 Test M</b><br>Тест-полоски Combur 10 Test M для анализа мочи на приборах по 10 параметрам: относительная плотность, кислотность (pH), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь | 1 x 100 шт.   |            |
| 11379194263 | <b>Control-Test M 50 tests</b><br>Тест-полоски калибровочные Control-Test M  | 1 x 50 шт.    |            |
| 04537211001 | <b>Liquichek Urinalysis Control</b><br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи»  | 2 x 6 x 12 мл |            |
| 04409019001 | <b>Thermo-printer paper, 57 mm</b><br>Термобумага для принтера, 57 мм  | 1 x 1 шт.     |            |

#### Визуальные тест-полоски

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание |
|-------------|---|------------|------------|
| 11544039172 | <b>Micral Test 30</b><br>Тест-полоски для иммунологического полуколичественного определения микроальбуминурии Micral-Test | 1 x 30 шт. |            |

# Лабораторная экспресс-диагностика

## Биохимический экспресс-анализатор Reflotron Plus

### Расходные материалы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка                         | Примечание |
|-------------|--|---------------------------------|------------|
| 10745235001 | <b>Printer Ribbon</b><br>Картридж для матричного принтера  | 5 шт,                           |            |
| 04409043001 | <b>Printer paper, 57 mm (M-57)</b><br>Бумага для матричного принтера (M-57)                          | 1 рулон                         |            |
| 11142577196 | <b>Reflotron Clean + Check</b><br>Набор для чистки и контроля оптической системы прибора «Рефлотрон» | 15 контр. полосок и 16 салфеток |            |

### Реагенты и контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка   | Примечание |
|-------------|---|---|------------|
| 11183893196 | <b>Precinorm HDL for Reflotron</b><br>Контрольная плазма для «Рефлотрона» со значением по холестерину ЛПВП «Прецинорм HDL холестерол»   | 2x2 мл (низкий уровень); 2x2 мл (высокий уровень) |            |
| 10745154196 | <b>Precinorm U for Reflotron</b><br>Универсальная контрольная плазма «Прецинорм У» для «Рефлотрона» со значениями по всем определяемым параметрам, кроме гемоглобина и холестерина ЛПВП | 4x2 мл  |            |
| 11200658202 | <b>Reflotron Amylase</b><br>Тест-полоски для определения Общей Амилазы  | 15 тест-полосок                                   |            |
| 11622773202 | <b>Reflotron Alkaline Phosphatase</b><br>Тест-полоски для определения Щелочной Фосфатазы  | 30 тест-полосок                                   |            |
| 10905321202 | <b>Reflotron Bilirubin</b><br>Тест-полоски для определения Билирубина   | 30 тест-полосок                                   |            |
| 10745065202 | <b>Reflotron Cholesterol</b><br>Тест-полоски для определения Общего Холестерина   | 30 тест-полосок                                   |            |
| 11126695202 | <b>Reflotron CK</b><br>Тест-полоски для определения КФК   | 15 тест-полосок                                   |            |
| 10886874202 | <b>Reflotron Creatinin</b><br>Тест-полоски для определения Креатинина   | 30 тест-полосок                                   |            |
| 10745081202 | <b>Reflotron GammaGT</b><br>Тест-полоски для определения ГТТ  | 30 тест-полосок                                   |            |
| 10744948202 | <b>Reflotron Glucose</b><br>Тест-полоски для определения Глюкозы  | 30 тест-полосок                                   |            |
| 10745120202 | <b>Reflotron GOT</b><br>Тест-полоски для определения АСТ  | 30 тест-полосок                                   |            |



| Арт.№       | Наименование  | Фасовка         | Примечание |
|-------------|---|-----------------|------------|
| 10745138202 | <b>Reflotron GPT</b><br>Тест-полоски для определения АЛТ                                  | 30 тест-полосок |            |
| 11208756202 | <b>Reflotron HDL-Cholesterol</b><br>Тест-полоски для определения Холестерина ЛПВП         | 30 тест-полосок |            |
| 11126679202 | <b>Reflotron Pancreas Amylase</b><br>Тест-полоски для определения Панкреатической Амилазы | 15 тест-полосок |            |
| 11208764202 | <b>Reflotron Potassium</b><br>Тест-полоски для определения Калия                          | 30 тест-полосок |            |
| 10745049202 | <b>Reflotron Triglycerides</b><br>Тест-полоски для определения Триглицеридов              | 30 тест-полосок |            |
| 11200666202 | <b>Reflotron Urea</b><br>Тест-полоски для определения Мочевины                            | 15 тест-полосок |            |
| 10745103202 | <b>Reflotron Uric Acid</b><br>Тест-полоски для определения Мочевой Кислоты                | 30 тест-полосок |            |

## Анализатор функции тромбоцитов Multiplate Analyzer

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка | Примечание                  |
|-------------|---|---------|-----------------------------|
| 06675069001 | <b>Multiplate Analyzer</b><br>Анализатор функции тромбоцитов Multiplate Analyzer с принадлежностями | 1 шт.   |                             |
| 08884366001 | <b>Monitor DELL TFT 19" (1280x1024)</b><br>Монитор  | 1 шт.   |                             |
| 06675344300 | <b>Mini Keyboard</b><br>Мини-клавиатура   | 1 шт.   |                             |
| 06675492001 | <b>Keyboard Cover</b><br>Защитное покрытие для мини-клавиатуры                                      | 1 шт.   |                             |
| 06675506001 | <b>Trolley</b><br>Тележка   | 1 шт.   |                             |
| 06675174001 | <b>PC Mouse</b><br>Мышь компьютерная  | 1 шт.   | Входит в состав анализатора |
| 06675204001 | <b>Sensor Cables, 7 pcs</b><br>Кабели сенсорные, 7 шт.  | 7 шт.   | Входит в состав анализатора |
| 06675212001 | <b>Reagent Holder</b><br>Держатель для реагентов  | 1 шт.   | Входит в состав анализатора |
| 06675239001 | <b>Pipette Holder</b><br>Pipette Holder Держатель для пипетки                                       | 1 шт.   | Входит в состав анализатора |

# Лабораторная экспресс-диагностика

## Анализатор функции тромбоцитов Multiplate Analyzer

### Расходные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка                      | Примечание  |
|-------------|---|------------------------------|---|
| 06675590001 | <b>Multiplate Test Cells</b><br>Диспосистемы для измерений                                      | 60 шт.                       | Для анализатора функции тромбоцитов Multiplate Analyzer |
| 06675654001 | <b>Pre-heating tubes, 10 pcs x 1 pack</b><br>Пробирки для предварительного прогрева дилуэнта    | 10 шт.                       | Входит в состав анализатора                             |
| 06675999190 | <b>Liquid Control Set</b><br>Набор жидких контролей   | R1: 2 x 4 мл<br>R2: 1 x 1 мл |   |
| 06675948190 | <b>GpIIb/IIIa Antagonist, 3 x 0.5 ml</b><br>GpII-b/IIIa-антагонист                              | 3 x 0,5 мл                   |   |
| 06675905190 | <b>Prostaglandin E1, 3 x 1ml</b><br>Простагландин   | 3 x 1 мл                     |   |
| 06675816190 | <b>ASPItest, 3 x 1ml</b><br>Реагент для активации агрегации тромбоцитов арахидоновой кислоты    | 3 x 1 мл                     |   |
| 06675794190 | <b>ADPtest, 3 x 1ml</b><br>Реагент для активации тромбоцитов АДФ (ADPtest)                      | 3 x 1 мл                     |   |
| 06675883190 | <b>TRAPtest, 3 x1ml</b><br>Реагент для активации рецепторов тромбина на поверхности тромбоцитов | 3 x 1 мл                     |   |

## Экспресс-тесты для бесприборного определения Тропонина Т

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка                          | Примечание                         |
|-------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 11621947196 | <b>Trop T sensitive (5 test incl syringes)</b><br>Тест-системы для определения кардиоспецифического полипептида тропонина Т «Троп Т» в венозной крови  | 5 тест-полосок и 5 шприц-пипеток | вкл. шприц-пипетки для забора проб |
| 11621904193 | <b>Trop T sensitive (10 tests w/o syringes)</b><br>Тест-системы для определения кардиоспецифического полипептида тропонина Т «Троп Т» в венозной крови | 10 тест-полосок                  | без шприц-пипеток для забора проб  |

### Расходные материалы

|             |   |        |  |
|-------------|---|--------|--|
| 11622889190 | <b>Roche CARDIAC Pipettes</b><br>Шприц-пипетки для нанесения исследуемого материала на тест-полоску (нестерильн., гепариниз.) | 20 шт. |  |
|-------------|---|--------|--|





## Иммунохимический портативный экспресс-анализатор cobas h 232

### Прибор и принадлежности

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка | Примечание                             |
|-------------|---|---------|--|
| 04901126190 | <b>cobas h 232 Kit</b><br>Экспресс-анализатор иммунохимический<br>Кобас h 232 (cobas h 232)                       | 1 шт.   |  |
| 04901142190 | <b>cobas h 232 Kit (scanner)</b><br>Экспресс-анализатор иммунохимический<br>Кобас h 232 (со сканером штрих-кодов) | 1 шт.   |  |
| 08408793190 | <b>Handheld Base Unit</b><br>Универсальная база для питания и подключения<br>к компьютеру                         | 1 шт.   | Подходит также для<br>CoaguChek Pro II |
| 05404517001 | <b>Printer (CMP-10) (EMEA)</b><br>Принтер внешний   | 1 шт.   | Подходит также для<br>CoaguChek Pro II |

### Реагенты и контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка   | Примечание  |
|-------------|--|---|---|
| 04877772190 | <b>Roche CARDIAC T Quantitative</b><br>Тест-полоски для определения тропонина Т  | 10 тест-полосок                                       | Диапазон измерений: 50-100 нг/л<br>(полуколичественный)<br>100-2000 нг/л (количественный) |
| 04890515190 | <b>Roche CARDIAC Control Troponin T</b><br>Контрольный материал по тропонину Т   | 1х1мл (низкий<br>уровень); 1х1мл<br>(высокий уровень) |   |
| 07007302190 | <b>Roche CARDIAC POC Troponin T</b><br>Тест-полоски для определения тропонина Т  | 10 тест-полосок                                       | Диапазон измерений:<br>40-2000 нг/л (количественный)                                      |
| 07089643190 | <b>Roche CARDIAC POC Troponin T Control</b><br>Контрольный материал по тропонину Т   | 1х2мл (1 уровень)                                     |   |
| 04877799190 | <b>Roche CARDIAC M Myoglobin</b><br>Тест-полоски для определения миоглобина  | 20 тест-полосок                                       |   |
| 04890469190 | <b>Roche CARDIAC Control Myoglobin</b><br>Контрольный материал по миоглобину   | 1х1мл (низкий<br>уровень); 1х1мл<br>(высокий уровень) |   |
| 04877802190 | <b>Roche CARDIAC D-Dimer</b><br>Тест-полоски для определения Д-димера  | 10 тест-полосок                                       |   |
| 04890523190 | <b>Roche CARDIAC Control D-Dimer</b><br>Контрольный материал по Д-димеру   | 1х1мл (низкий<br>уровень); 1х1мл<br>(высокий уровень) |   |
| 05533643190 | <b>Roche CARDIAC pro BNP</b><br>Тест-полоски для определения proBNP<br>(увеличенный диапазон)  | 10 тест-полосок                                       |   |
| 04890493190 | <b>Roche CARDIAC Control pro BNP</b><br>Контрольный материал по pro BNP Кардиак  | 1х1мл (низкий<br>уровень); 1х1мл<br>(высокий уровень) |   |
| 04877900190 | <b>Roche CARDIAC CK-MB</b><br>Тест-полоски для определения СКМВ  | 10 тест-полосок                                       |   |
| 04890426190 | <b>Roche CARDIAC Control CK-MB</b><br>Контрольный материал для проверки качества<br>тест-полосок для определения концентрации<br>СК-МВ | 1х1мл (низкий<br>уровень); 1х1мл<br>(высокий уровень) |   |
| 04880668190 | <b>Roche Cardiac IQC (cobas)</b><br>Контрольные тест-полоски для проверки<br>прибора Кобас h 232 (cobas h 232)                         | 2 тест-полоски  |   |
| 11622889190 | <b>Roche CARDIAC Pipettes</b><br>Шприц-пипетки для нанесения исследуемого<br>материала на тест-полоску (нестерильн.,<br>негепариниз.)  | 20 шт.  |   |

# Лабораторная экспресс-диагностика

## Профессиональная система для коагуляционного мониторинга CoaguChek Pro II

### Прибор и расходные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка  | Примечание                     |
|-------------|---|--|--------------------------------|
| 07210841190 | <b>CoaguChek Pro II</b><br>Коагулометр портативный КоагуЧек Про II  | 1 шт.  |                                |
| 08408793190 | <b>Handheld Base Unit</b><br>Портативный базовый блок (док-станция) для передачи данных по локальной сети или по USB      | 1 шт.  | Подходит также для cobas h 232 |
| 05404517001 | <b>Printer (CMP-10) (EMEA)</b><br>Принтер внешний   | 1 шт.  | Подходит также для cobas h 232 |
| 06688721019 | <b>CoaguChek PT Test, 2x24 tests</b><br>Тест-полоски Коагучек РТ тест, 2 x 24 шт  | 48 тест-полосок  |                                |
| 06679684190 | <b>CoaguChek PT Controls</b><br>Материал контрольный CoaguChek PT Controls для коагулометра портативного CoaguChek Pro II | 4 флакона с лиофилизатом 1 уровня<br>4 флакона с лиофилизатом 2 уровня<br>8 дозаторов с разбавителем |                                |

## Профессиональная система для коагуляционного мониторинга «CoaguChek XS Plus»

### Расходные материалы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка   | Примечание |
|-------------|--|---|------------|
| 04625315172 | <b>CoaguChek XS PT Test</b><br>Тест-полоски КоагуЧек ИксЭс РТ тест, 2 x 24 шт.   | 48 тест-полосок                                       |            |
| 04696522190 | <b>CoaguChek XS PT Controls</b><br>Материал контрольный CoaguChek XS PT Controls для коагулометра портативного CoaguChek XS Plus | 4 флакона с лиофилизатом<br>4 дозатора с разбавителем |            |

## Экспресс-анализатор биохимический портативный Accutrend Plus

### Прибор и принадлежности

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка         | Примечание                                 |
|-------------|---|-----------------|--|
| 05050499023 | <b>Accutrend Plus</b><br>Экспресс-анализатор биохимический портативный Аккутренд Плюс | 1 шт.           |  |
| 11447475187 | <b>Accutrend Glucose</b><br>Тест-полоски Аккутренд Глюкоза                            | 25 тест-полосок | Только для профессионального использования |
| 11284878190 | <b>Accutrend Control G</b><br>Контрольный раствор Аккутренд Контроль Глюкоза          | 2 x 4 мл        |  |



| Арт.№       | Наименование   | Фасовка   | Примечание |
|-------------|--|---|------------|
| 11418262012 | <b>Accutrend Cholesterol (25 strips)</b><br>Тест-полоски Аккутренд Холестерин                                  | 25 тест-полосок                                       |            |
| 11418289190 | <b>Accutrend Control CH 1</b><br>Контрольный раствор Аккутренд Контроль Холестерин                             | 1 x 1,5 мл  |            |
| 11538144016 | <b>Accutrend Triglycerides</b><br>Тест-полоски Аккутренд Триглицериды  | 25 тест-полосок                                       |            |
| 11538152190 | <b>Accutrend Control TG 1</b><br>Контрольный раствор Аккутренд Контроль Триглицериды                           | 2 x 4 мл  |            |
| 03012654016 | <b>BM-Lactate</b><br>Тест-полоски БМ-Лактат для количественного определения уровня лактата в капиллярной крови | 25 тест-полосок                                       |            |
| 11447335190 | <b>BM-Control-Lactate</b><br>Контрольный материал для проведения проверки работы тест-полосок БМ Лактат        | 2 x 4 мл (низкий уровень); 2 x 4 мл (высокий уровень) |            |

## Система для анализа госпитальной глюкозы Accu-Chek Inform II

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка | Примечание |
|-------------|--|---------|------------|
| 05060303001 | <b>Accu-Chek Inform II Meter Kit + RF</b><br>Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для контроля уровня глюкозы крови Акку-Чек Информ II с функцией беспроводного подключения | 1 шт    |            |
| 04884671001 | <b>Accu-Chek Inform II Code Key Reader</b><br>Считыватель кода для Акку-Чек Информ II  | 1 шт    |            |
| 05060281001 | <b>Accu-Chek Inform II Accessory Box</b><br>Контейнер для хранения Акку-Чек Информ II и принадлежностей  | 1 шт    |            |
| 07671717190 | <b>Accu-Chek Inform II Base Unit Kit</b><br>Базовый модуль для подключения Акку-Чек Информ II к лабораторной информационной системе и зарядки устройства                           | 1 шт    |            |
| 08376824190 | <b>Accu-Chek Inform II Base Unit Light</b><br>Базовый модуль упрощенный для зарядки устройства   | 1 шт    |            |
| 08692432001 | <b>Handheld Power Supply FW8001M/12,12V</b><br>Блок питания  | 1 шт    |            |

## Реагенты и контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка         | Примечание |
|-------------|---|-----------------|------------|
| 05942861044 | <b>ACCU-CHEK INFORM II EU2</b><br>Тест-полоски Акку-Чек Информ II, 50 шт. | 50 тест-полосок |            |

# Анализаторы газов крови и электролитов

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка | Примечание                            |
|-------------|--|---------|---------------------------------------|
| 03274799001 | <b>AIR FILTER cobas b 221</b><br>Воздушный фильтр      | 4 штуки |                                       |
| 03309754001 | <b>Fill port cobas b 221</b><br>Входной порт           | 1 штука |                                       |
| 03086879001 | <b>THB Cuvette</b><br>Кювета для измерения гемоглобина | 1 штука | Замена проводится сервисным инженером |

## Анализаторы критических состояний cobas b 123

### Приборы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка | Примечание               |
|-------------|---|---------|--------------------------|
| 05122244001 | <b>cobas b 123 &lt; 1 &gt; POC system</b><br>Анализатор критических состояний cobas b 123, вариант исполнения 1 | 1 штука | Без COOX модуля и МАКК   |
| 05122252001 | <b>cobas b 123 &lt; 2 &gt; POC system</b><br>Анализатор критических состояний cobas b 123, вариант исполнения 2 | 1 штука | С МАКК, без COOX модуля  |
| 05122279001 | <b>cobas b 123 &lt; 3 &gt; POC system</b><br>Анализатор критических состояний cobas b 123, вариант исполнения 3 | 1 штука | С COOX модулем, без МАКК |
| 05122287001 | <b>cobas b 123 &lt; 4 &gt; POC system</b><br>Анализатор критических состояний cobas b 123, вариант исполнения 4 | 1 штука | С МАКК и COOX модулем    |
| 05414555001 | <b>CART cobas b 123 POC system</b><br>Тележка для анализатора cobas b 123                                       | 1 штука |                          |

### Реагенты, расходные и контрольные материалы к анализаторам cobas b 123

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка | Примечание       |
|-------------|--|---------|------------------|
| 05170460001 | <b>cobas b 123 SENSOR CART. BG/ISE</b><br>Картридж сенсорный, BG/ISE                 | 1 штука |                  |
| 05170478001 | <b>cobas b 123 SENSOR CART. BG/ISE/GLU/LAC</b><br>Картридж сенсорный, BG/ISE/GLU/Lac | 1 штука |                  |
| 05403308001 | <b>cobas b 123 FLUID PACK 200</b><br>Контейнер реагентный, 200 тестов                | 1 штука | Для версий 1 и 2 |
| 05403154001 | <b>cobas b 123 FLUID PACK 400</b><br>Контейнер реагентный, 400 тестов                | 1 штука | Для версий 1 и 2 |
| 05403286001 | <b>cobas b 123 FLUID PACK 700</b><br>Контейнер реагентный, 700 тестов                | 1 штука | Для версий 1 и 2 |
| 05169992001 | <b>cobas b 123 FLUID PACK COOX 200</b><br>Контейнер реагентный COOX, 200 тестов      | 1 штука | Для версий 3 и 4 |



| Арт.№       | Наименование   | Фасовка  | Примечание       |
|-------------|--|--|------------------|
| 05170036001 | <b>cobas b 123 FLUID PACK COOX 400</b><br>Контейнер реагентный COOX 400 тестов                             | 1 штука  | для версий 3 и 4 |
| 05170052001 | <b>cobas b 123 FLUID PACK COOX 700</b><br>Контейнер реагентный COOX, 700 тестов                            | 1 штука  | для версий 3 и 4 |
| 05169933001 | <b>cobas b 123 AUTOQC PACK, TRI-LEVEL</b><br>Кассета автоматического контроля качества, три уровня, 24 шт. | 24 ампулы<br>(8 ампул по 3-м уровням по 1.0 мл каждая) | для версий 2 и 4 |
| 03321193001 | <b>COMBITROL PLUS B, LEVEL 1 (COOX)</b><br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 1 (30x1.7мл)     | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая                           |                  |
| 03321207001 | <b>COMBITROL PLUS B, LEVEL 2 (COOX)</b><br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 2 (30x1.7мл)     | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая                           |                  |
| 03321215001 | <b>COMBITROL PLUS B, LEVEL 3 (COOX)</b><br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 3 (30x1.7мл)     | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая                           |                  |
| 05082595001 | <b>cobas b 123 PRINTER PAPER</b><br>Бумага принтера cobas b 123  |  |                  |

## Реагенты и контрольные материалы к анализаторам cobas b 121, OMNI C

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка                      | Примечание |
|-------------|---|------------------------------|------------|
| 03144046001 | <b>Calibration Solution C1</b><br>Калибровочный раствор Си 1                              | 1 контейнер                  |            |
| 03144020001 | <b>Calibration Solution C2</b><br>Калибровочный раствор Си 2                              | 1 контейнер                  |            |
| 03144038001 | <b>Fluid Pack C3</b><br>Контейнер с реагентами Си 3                                       | 1 контейнер                  |            |
| 03321258001 | <b>COMBITROL TS+, LEVEL 1</b><br>Контрольный материал Комбитрол ТС+, уровень 1 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая |            |
| 03321266001 | <b>COMBITROL TS+, LEVEL 2</b><br>Контрольный материал Комбитрол ТС+, уровень 2 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая |            |
| 03321274001 | <b>COMBITROL TS+, LEVEL 3</b><br>Контрольный материал Комбитрол ТС+, уровень 3 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая |            |
| 03321223001 | <b>AUTO-TROL TS+, LEVEL 1</b><br>Контрольный материал АВТО-трол ТС+, уровень 1 (40x1.7мл) | 40 ампул<br>по 1,7 мл каждая | Для МАКК   |

# Анализаторы газов крови и электролитов

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка                   | Примечание |
|-------------|---|---------------------------|------------|
| 03321231001 | <b>AUTO-TROL TS+, LEVEL 2</b><br>Контрольный материал АВТО-трол ТС+, уровень 2 (40x1.7мл) | 40 ампул по 1,7 мл каждая | Для МАКК   |
| 03321240001 | <b>AUTO-TROL TS+, LEVEL 3</b><br>Контрольный материал АВТО-трол ТС+, уровень 3 (40x1.7мл) | 40 ампул по 1,7 мл каждая | Для МАКК   |

## Расходные материалы и принадлежности к анализаторам cobas b 121, OMNI C

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание |
|-------------|---|------------|------------|
| 03111598180 | <b>Electrode Sodium (Na+)</b><br>Натриевый микроэлектрод                            | 1 штука    |            |
| 03111628180 | <b>Potassium Electrode (K+)</b><br>Калиевый микроэлектрод                           | 1 штука    |            |
| 03111644180 | <b>Calcium Electrode (Ca++)</b><br>Кальциевый микроэлектрод                         | 1 штука    |            |
| 03111571180 | <b>AVL Micro Electrode - Cl-</b><br>Хлорный микроэлектрод                           | 1 штука    |            |
| 03111679180 | <b>PCO2 Electrode</b><br>pCO <sub>2</sub> -микроэлектрод                            | 1 штука    |            |
| 03111695180 | <b>PO2 Electrode</b><br>pO <sub>2</sub> -микроэлектрод                              | 1 штука    |            |
| 03111717180 | <b>pH Electrode</b><br>pH-микроэлектрод   | 1 штука    |            |
| 03111873180 | <b>Ref. Electrode</b><br>Референсный микроэлектрод                                  | 1 штука    |            |
| 03144062001 | <b>MCON OMNI C</b><br>Соединительный контакт M                                      | 1 штука    |            |
| 03111849035 | <b>Electrode Dummy</b><br>Микроэлектрод-заглушка                                    | 1 штука    |            |
| 03144054001 | <b>W Waste Container</b><br>Контейнер для отходов                                   | 2 штуки    |            |
| 03026434001 | <b>FILL PORT OMNI C</b><br>Пробозаборник в комплекте (cobas b 121)                  | 1 комплект |            |
| 03056295001 | <b>PUMP TUBE OMNI C</b><br>Набор трубок для перистальтического насоса (cobas b 121) | 1 комплект |            |
| 03112098035 | <b>CLEANING KIT FOR CL-ELECTRODE</b><br>Набор для чистки хлорного электрода         | 1 штука    |            |



| Арт.№       | Наименование  | Фасовка                    | Примечание |
|-------------|---|----------------------------|------------|
| 03110435180 | <b>Deproteinizer</b><br>Раствор для антисептики   | 1 флакон<br>емкость 125 мл |            |
| 03113353180 | <b>PAPER ROLL f. printer STP211-144 (10pcs)</b><br>Бумага для принтера stp211-144 (Компакт) | 10 роликов                 |            |

## Анализаторы электролитов серии 91XX

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка    | Примечание |
|-------------|---|------------|------------|
| 03157334001 | <b>Electrolyte Analyzer</b><br>Анализатор электролитов 9180 | 1 комплект |            |

### Реагенты и контрольные материалы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка                               | Примечание |
|-------------|--|---------------------------------------|------------|
| 03112349180 | <b>Snap Pack (9180, 9181)</b><br>Контейнер с реагентами СнэпПак (9180, 9181)                         | 1 штука                               |            |
| 03110362180 | <b>Sodium Electrode Conditioner</b><br>Кондиционер натриевого электрода                              | 125 мл                                |            |
| 03111555180 | <b>Cleaning Solution (for electrolyte systems)</b><br>Чистящий раствор для анализаторов электролитов | 125 мл                                |            |
| 03112888180 | <b>ISETROL, level 1, 2, 3</b><br>Материал контрольный ISE-трол, уровень 1, 2, 3                      | 3 уровня по 10 ампул по 1.0 мл каждая |            |

### Расходные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка | Примечание |
|-------------|---|---------|------------|
| 03110338180 | <b>Potassium Electrode, maintenance free</b><br>Электрод калиевый, необслуживаемый                | 1 штука |            |
| 03110354180 | <b>Calcium Electrode, maintenance free</b><br>Электрод кальциевый, необслуживаемый                | 1 штука |            |
| 03110419180 | <b>Sodium Electrode, maintenance free</b><br>Электрод натриевый, необслуживаемый                  | 1 штука |            |
| 03110451180 | <b>Chloride Electrode, maintenance free</b><br>Электрод хлорный, необслуживаемый                  | 1 штука |            |
| 03110664180 | <b>Lithium Electrode, maintenance free</b><br>Электрод литиевый, необслуживаемый                  | 1 штука |            |
| 03112284180 | <b>Reference Electrode Housing for AVL 91xx instruments</b><br>Мембранна референсная для AVL 91xx | 1 штука |            |
| 03112306180 | <b>Reference Electrode (for AVL 91XX instruments)</b><br>Референсный электрод (91xx)              | 1 штука |            |

# Анализаторы газов крови и электролитов

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка                    | Примечание |
|-------------|--|----------------------------|------------|
| 03110192035 | <b>DUMMY ELECTRODES COMPLETE (1 PC)</b><br>Электрод-заглушка для 9180                      | 1 штука                    |            |
| 03110249180 | <b>Urine Diluent</b><br>Разбавитель мочи   | 1 флакон<br>емкость 500 мл |            |
| 03112292018 | <b>Printer paper for AVL 9100/9110</b><br>Термобумага для анализаторов электролитов (91xx) | 5 роликов                  |            |
| 03087697001 | <b>TUBE SET, PERISTALTIC PUMP, EA</b><br>Набор трубок (Трубки перистальтического насос)    | 1 комплект                 |            |

## Системы взятия крови для анализа электролитов и газов крови

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка                    | Примечание  |
|-------------|--|----------------------------|---|
| 03112101180 | <b>Adapters for Sample Containers</b><br>Адаптеры для пробирки с образцом                                | 150 штук                   | Для проведения ручного контроля качества (взятие образца из ампул) или для взятия образца из пробирки |
| 05772583001 | <b>Roche MICROSAMPLER PROTECT STERILE</b><br>Микросэмплер гепаринизированный (с иглой, стерильн.)        | 50 штук                    | Для взятия артериальной крови   |
| 05772494001 | <b>Roche MICROSAMPLER PROTECT NON-STERILE</b><br>Микросэмплер гепаринизированный (с иглой, не стерильн.) | 200 штук                   | Для взятия артериальной крови   |
| 03112152180 | <b>CAPS FOR ROCHE MICROSAMPLER</b><br>Заглушки для микросэмплеров  | 300 штук                   | Для взятия артериальной крови   |
| 03113507035 | <b>Glass Capillary Tubes, min. 115 µL</b><br>Стеклянные капилляры (115мкл) (4 x 250 шт.)                 | 4 тубуса<br>по 250 штук    |   |
| 03113477180 | <b>Glass Capillary Tubes, min. 200 µL</b><br>Стеклянные капилляры, 200 мкл (4 x 250 шт.)                 | 4 тубуса<br>по 250 штук    |   |
| 03112012180 | <b>Clot Catcher, disposable</b><br>Уловитель сгустков (однораз.)   | 250 штук                   |   |
| 05689856001 | <b>Clot Catcher PRO</b><br>Уловитель сгустков PRO (однораз.)   | 100 штук                   |   |
| 03113493035 | <b>BS2 Blood Sampler, 2 ml</b><br>Шприцы гепаринизированные BS2 производства Roche, 2 мл (20 x 50 шт.)   | 20 блистеров<br>по 50 штук | Для взятия венозной и артериальной крови. Без иглы  |



# Решения для самомониторинга



## Коагулометр портативный КоагуЧек ИксЭс (CoaguChek XS)

### Прибор и расходные материалы

| Арт.№       | Наименование  | Фасовка                             | Примечание |
|-------------|---|-------------------------------------|------------|
| 04625412019 | <b>CoaguChek XS</b><br>Набор для мониторинга лечения оральными антикоагулянтами: Коагулометр портативный КоагуЧек ИксЭс / Устройство для прокалывания пальца КоагуЧек Софткликс / Ланцеты КоагуЧек Софткликс XL для прокалывания пальца | 1 шт. / 1 шт. / 20 шт.              |            |
| 04625358172 | <b>CoaguChek XS PT Test, 24 tests</b><br>Тест-полоски «КоагуЧек ИксЭс PT тест, 24 шт.   | 24 тест-полоски<br>один кодовый чип |            |
| 03506509001 | <b>CoaguChek Softclix Lancet XL, 50</b><br>Ланцеты КоагуЧек Софткликс XL, 50 шт.<br>одноразовые, стерильные   | 50 ланцетов                         |            |

## Экспресс-анализатор биохимический портативный Accutrend Plus

### Прибор и расходные материалы

| Арт.№       | Наименование   | Фасовка   | Примечание |
|-------------|--|---|------------|
| 05050499023 | <b>Accutrend Plus</b><br>Экспресс-анализатор биохимический портативный Аккутренд Плюс                          | 1 шт.   |            |
| 11418254223 | <b>Accutrend Cholesterol (5 strips)</b><br>Тест-полоски Аккутренд Холестерин                                   | 5 тест-полосок  |            |
| 11418289190 | <b>Accutrend Control CH 1</b><br>Контрольный раствор Аккутренд Контроль Холестерин                             | 1 x 1,5 мл  |            |
| 11538144016 | <b>Accutrend Triglycerides</b><br>Тест-полоски Аккутренд Триглицериды  | 25 тест-полосок                                       |            |
| 11538152190 | <b>Accutrend Control TG 1</b><br>Контрольный раствор Аккутренд Контроль Триглицериды                           | 2 x 4 мл  |            |
| 03012654016 | <b>BM-Lactate</b><br>Тест-полоски БМ-Лактат для количественного определения уровня лактата в капиллярной крови | 25 тест-полосок                                       |            |
| 11447335190 | <b>BM-Control-Lactate</b><br>Контрольный материал для проведения проверки работы тест-полосок БМ-Лактат        | 2 x 4 мл (низкий уровень); 2 x 4 мл (высокий уровень) |            |



