Меркурий-Интер-Лаб

НАШ ОПЫТ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

ГОД ОСНОВАНИЯ 1994 ГОД

отдел продаж+7 (831) 215-00-98
горячая линия 8-800-200-10-16
nn@mil-nn.ru
www. mil-nn.ru

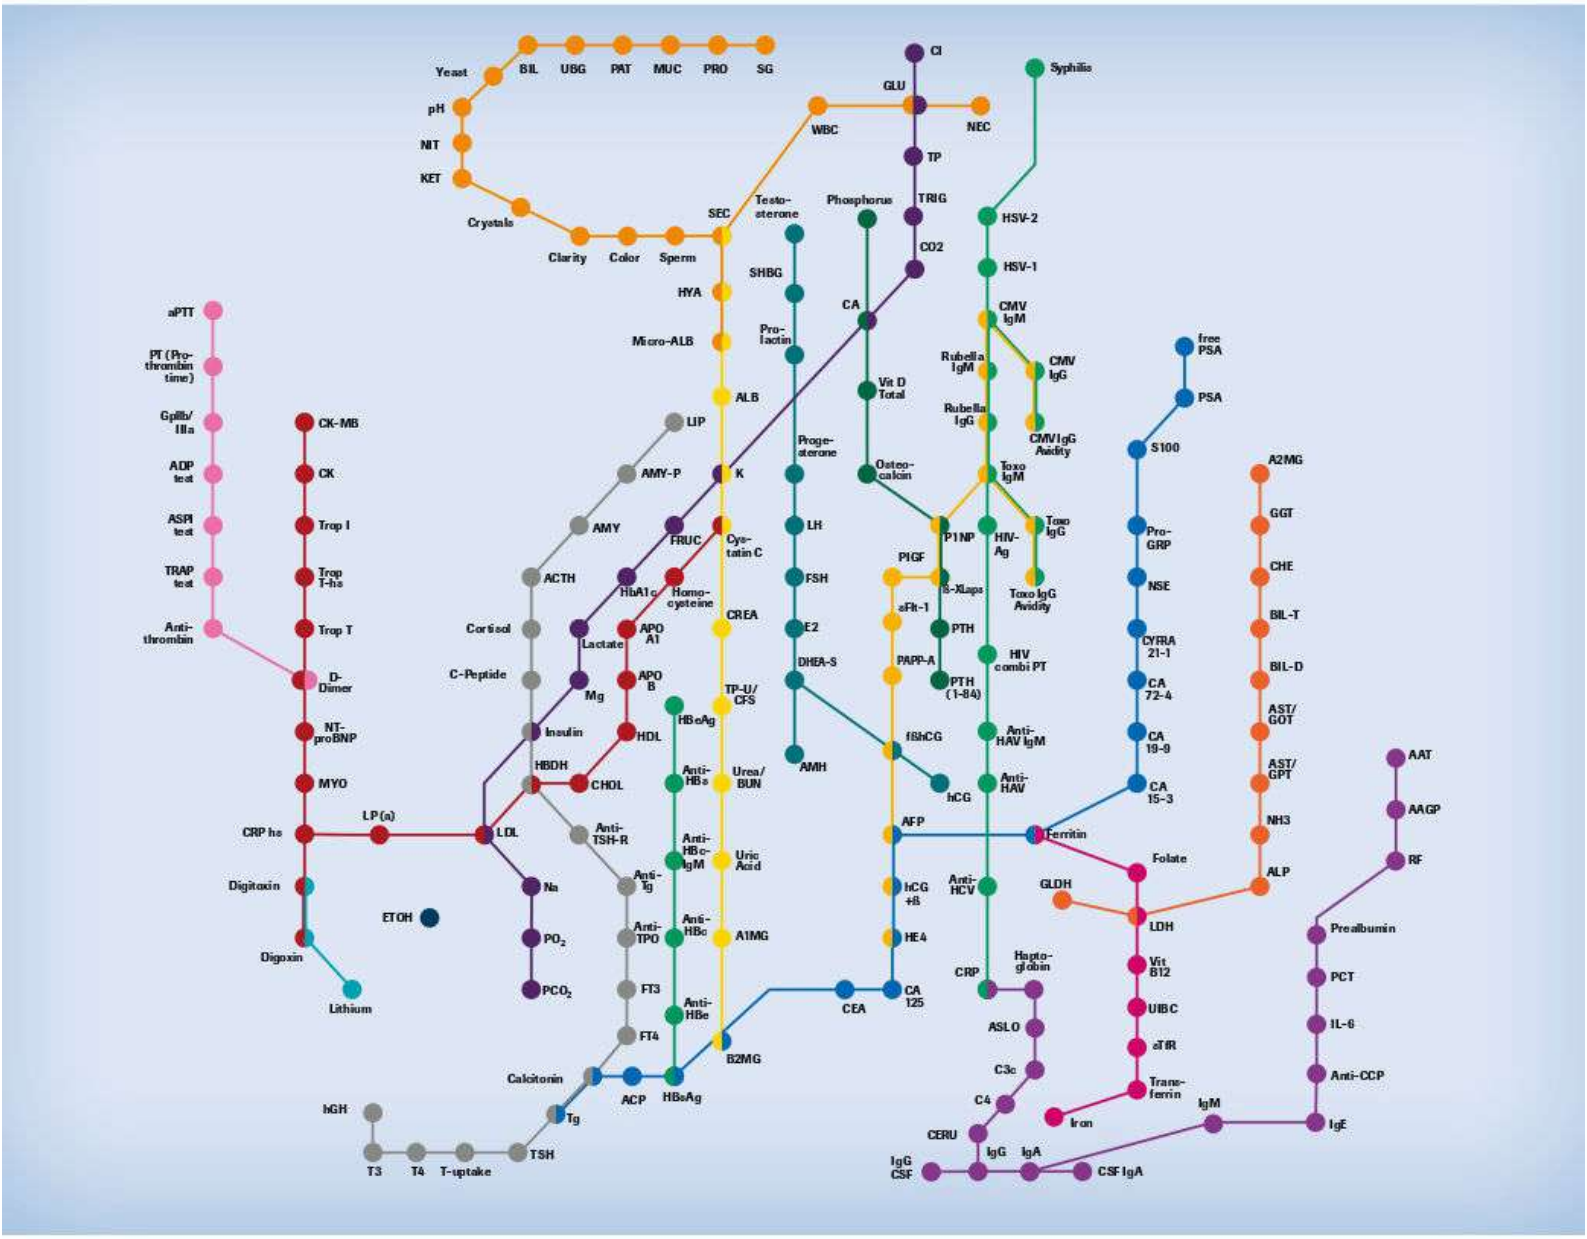


Меркурий-Интер-Лаб

# Содержание

**Сывороточная рабочая зона** ..... 3
Реагенты для биохимического модуля **cobas** c702 ..... 3
Расходные материалы для биохимического модуля **cobas** c702 ..... 6
Реагенты для биохимического модуля **cobas** c501/502, и анализатора **cobas** c 311 ..... 8
Расходные материалы для биохимического модуля **cobas** c501/502 и анализатора **cobas** c 311 ..... 12
Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора **Integra** 400plus ..... 14
Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора **cobas** c111 ..... 20
Калибраторы и контрольные материалы для биохимических анализаторов **cobas** ..... 23
Таблица соответствия калибраторов и контрольных материалов для биохимических анализаторов **cobas** ..... 25
Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля **cobas** e601/602, анализатора **cobas** e411 ..... 27
- Диагностика нарушений функции щитовидной железы ..... 27
- Диагностика нарушений функции паращитовидной железы ..... 28
- Диагностика эндокринных нарушений репродуктивной функции ..... 28
- Диагностика и мониторинг беременности ..... 30
- Диагностика нарушений роста ..... 31
- Диагностика нарушений эндокринной функции поджелудочной железы ..... 32
- Диагностика нарушений эндокринной функции надпочечников ..... 32
- Диагностика онкологических заболеваний ..... 33
- Диагностика инфекционных заболеваний ..... 35
- Диагностика сердечно-сосудистой патологии ..... 38
- Диагностика анемий ..... 40
- Диагностика аллергических состояний ..... 40
- Маркеры костного обмена ..... 41
- Диагностика ревматоидного артрита ..... 42
- Диагностика сепсиса ..... 42
- Дополнительные растворы и разбавители проб ..... 43
- Расходные материалы для анализатора **cobas** e411 ..... 43
- Расходные материалы для анализаторов **cobas** e601, **Modular** E170 ..... 44

Таблица соответствия иммунохимических контрольных материалов ..... 45

**Расходные материалы для преаналитических систем cobas p312, p512, p612** ..... 49

**Реагенты и расходные материалы для анализаторов мочи** ..... 50
Реагенты и расходные материалы для **cobas** u 601 ..... 50
Реагенты и расходные материалы для **cobas** u 701 ..... 50
Реагенты и расходные материалы для **Urisys** 2400 ..... 50
Реагенты и расходные материалы для **cobas** u 411 ..... 50
Реагенты и расходные материалы для **Urisys** 1100 ..... 51
Реагенты и расходные материалы для анализаторов серии «Мидитрон» ..... 51
Визуальные тест-полоски ..... 51

**Лабораторная экспресс-диагностика** ..... 52
Биохимический экспресс-анализатор Reflotron Plus ..... 52
Анализатор функции тромбоцитов Multiplate Analyzer ..... 53
Экспресс-тесты для беспрборного определения Тропонина Т ..... 54
Иммунохимический портативный экспресс-анализатор cobas h 232 ..... 55
Профессиональная система для коагуляционного мониторинга CoaguChek Pro II ..... 56
Профессиональная система для коагуляционного мониторинга CoaguChek XS Plus ..... 56
Экспресс-анализатор биохимический портативный Accutrend Plus ..... 56
Система для анализа госпитальной глюкозы Accu-Chek Inform II ..... 57

**Анализаторы газов крови и электролитов** ..... 59
Анализатор критических состояний **cobas** b 221 ..... 59
Анализаторы критических состояний **cobas** b 123 ..... 61
Анализаторы критических состояний **cobas** b 121 ..... 64
Анализаторы электролитов серии 91XX ..... 62
Системы взятия крови для анализа электролитов и газов крови ..... 64

**Решения для самомониторинга** ..... 66
Коагулометр портативный КоагуЧек ИксЭс (CoaguChek XS) ..... 66
Экспресс-анализатор биохимический портативный Accutrend Plus ..... 66

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты для биохимического модуля cobas c702

### Ферменты

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05975905190 | **Acid Phosphatase**<br>Кислая/простатическая фосфатаза | 4 x 200 тестов | |
| 05166888190 | **Alkaline Phosphatase acc. to IFCC**<br>Щелочная фосфатаза | 1050 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05850797190 | **ALT IFCC**<br>АЛТ | 1100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05531462190 | **ALT IFCC with pyridoxal phosphate activation**<br>АЛТ с пиридоксальфосфатом | 780 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05167027190 | **alpha-Amylase Gen.2**<br>а-амилаза | 750 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05167035190 | **alpha-Amylase Pancreatic**<br>Панкреатическая амилаза | 600 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05850819190 | **AST IFCC**<br>АСТ | 1100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168503190 | **Cholinesterase Gen.2**<br>Холинэстераза | 650 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168511190 | **Dibucaine**<br>Дибукаиновое число | 13 мл<br>(400 тестов) | |
| 05168546190 | **Creatine Kinase**<br>Креатинкиназа | 800 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168562190 | **Creatine Kinase-MB**<br>Креатинкиназа МВ | 600 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168775190 | **Glutamyltransferase**<br>ГГТ | 1200 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05975956190 | **GLDH Gen.3**<br>Глутаматдегидрогеназа | 3 x 120 тестов | |
| 05480175190 | **Hydroxybutyrate Dehydrogenase Gen.2**<br>ГБДГ (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 500 тестов | |
| 05169330190 | **Lactate Dehydrogenase acc. to IFCC**<br>ЛДГ | 750 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 07041918190 | **Lipase colorimetric**<br>Липаза | 580 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты для биохимического модуля cobas c702

### Субстраты

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05975573190 | **Albumin BCP**<br>Альбумин в сыворотке | 400 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05166861190 | **Albumin BCG Gen.2**<br>Альбумин | 750 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168384190 | **Bilirubin Direct Gen.2**<br>Билирубин прямой | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05795419190 | **Bilirubin Total Gen.3**<br>Билирубин общий | 600 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168449190 | **Calcium Gen.2**<br>Кальций | 2250 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168538190 | **Cholesterol Gen.2**<br>Холестерин | 2100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 06407137190 | **Creatinine Jaffe Gen. 2**<br>Креатинин Яффе | 1500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05168589190 | **Creatinine plus Gen.2**<br>Креатинин плюс | 600 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171962190 | **Fructosamine**<br>Фруктозамин | 250 тестов | |
| 05168791190 | **Glucose HK Gen.3**<br>Глюкоза | 2200 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05882095190 | **Glucose HK Gen.2**<br>Глюкоза в гемолизате | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 07528582190 | **HDL-Cholesterol Gen.4**<br>ЛПВП холестерин | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05169291190 | **Iron Gen.2**<br>Железо | 750 тестов | |
| 06407358190 | **Magnesium Gen 2**<br>Магний | 200 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171881190 | **Lactate Gen.2**<br>Лактат | 225 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 07005768190 | **LDL-Cholesterol Gen.3**<br>ЛПНП холестерин | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05975581190 | **Ammonia**<br>Аммиак | 150 тестов | |
| 05171377190 | **Phosphate (Inorganic) Gen.2**<br>Фосфаты | 600 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171385190 | **Total Protein Gen.2**<br>Общий белок | 700 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171954190 | **Total Protein Urine/CSF Gen.3**<br>Общий белок в моче/ЦСЖ | 600 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171407190 | **Triglycerides**<br>Триглицериды | 800 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05171857190 | **Uric Acid Gen.2**<br>Мочевая кислота | 1000 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05975808190 | **Unsaturated Iron-Binding Capacity**<br>НЖСС | 300 тестов | |
| 05171873190 | **Urea BUN**<br>Мочевина | 1900 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05967104190 | **Ethanol Gen.2**<br>Этанол | 300 тестов | |
| 05841941190 | **Lithium**<br>Литий | 100 тестов | |

### Специфические белки

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05167043190 | **Albumin Gen.2**<br>Альбумин в моче | 750 тестов | 05168376190 Antigen Excess Reagent (START)<br>05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05991960190 | **a1-Acid Glycoprotein Gen.2**<br>alpha 1-кислый гликопротеин | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05991978190 | **a1-Antitrypsin Gen.2**<br>alpha 1-антитрипсин | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05950686190 | **Apolipoprotein A Gen.2**<br>Аполипопротеин А | 100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05950694190 | **Apolipoprotein B Gen.2**<br>Аполипопротеин В | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05219191190 | **Antistreptolysin O**<br>Антистрептолизин О | 400 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05950708190 | **Antithrombin**<br>Антитромбин | 100 тестов | |
| 05950783190 | **b2-Microglobulin**<br>beta2-микроглобулин | 140 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05991986190 | **Complement C3c Gen.2**<br>Комплемент С3с | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05991994190 | **Complement C4 Gen.2**<br>Комплемент С4 | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05950848190 | **Ceruloplasmin**<br>Церулоплазмин | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05950864190 | **C-Reactive Protein (Latex) High Sensitive**<br>С-реактивный белок высокой чувствительности | 250 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05172373190 | **C-Reactive Protein Gen.3**<br>С-реактивный белок | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05172381190 | **D-Dimer Gen.2**<br>Д-Димер | 100 тестов | |
| 05172390190 | **Ferritin Gen.4**<br>Ферритин | 650 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05992001190 | **Haptoglobin Gen.2**<br>Гаптоглобин | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05219205190 | **IgA Gen.2**<br>Иммуноглобулин А | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05220718190 | **IgG Gen.2**<br>Иммуноглобулин G | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05220726190 | **IgM Gen.2**<br>Иммуноглобулин М | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05992010190 | **Kappa Gen.2**<br>Каппа цепи | 100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты для биохимического модуля cobas c702

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05992028190 | **Lambda Gen.2**<br>Лямбда цепи | 100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05950759190 | **Myoglobin Gen.2**<br>Миоглобин | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05950902190 | **Prealbumin**<br>Преальбумин | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05480167190 | **Rheumatoid Factors II**<br>Ревматоидный фактор II | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05950821190 | **Soluble Transferrin Receptor**<br>Растворимые рецепторы трансферрина | 150 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05852633190 | **Lipoprotein (a) Gen.2**<br>Липопротеин(а) | 100 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 05588855190 | **Transferrin Gen.2**<br>Трансферрин | 500 тестов | 05172152190 Diluent NaCl 9% |
| 06600263190 | **Cystatin C Gen.2**<br>Цистатин С | 225 тестов | |

## Расходные материалы для биохимического модуля cobas c702

### Дополнительные растворы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05907543190 | **EcoTergent, cobas c 701/702**<br>Экотергент | 96 мл (с-раск) | |
| 04880285190 | **NaOH-D cell wash solution 1**<br>Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки | 2 x 1800 мл | |
| 04880307190 | **Acid wash cell wash solution 2**<br>Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки | 2 x 1800 мл | |
| 05352991190 | **Sample Cleaner 1**<br>Промывочный раствор 1 | 12 x 20 мл | для c702, c502 |
| 05968828190 | **Sample Cleaner 2**<br>Промывочный раствор 2 | 12 x 20 мл | для c702, c502 |
| 05172128190 | **NAOHD Detergent 1**<br>Промывочный раствор 1 | 102 мл (с-раск) | |
| 05172136190 | **SMS Detergent 2**<br>Промывочный раствор 2 | 119 мл (с-раск) | |
| 05172152190 | **NaCl Diluent Cobas c pack**<br>Дилюент NaCl 9% | 119 мл (с-раск) | |
| 05168376190 | **Antigen Excess Reagen (START)**<br>Старт (избыток антигена) | 11 мл | |
| 05172179190 | **Serum Index Gen.2**<br>Сывороточные индексы | 3000 тестов (c-pack) | |

## Аксессуары

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 10394246001 | **cobas sample cups (2 ml)**<br>Пробирки для образцов (2 мл) | 5000 шт. | |
| 05085713001 | **Sample cups micro**<br>Микропробирки | 900 шт. | |
| 04740955001 | **cobas false bottom tube**<br>Пробирки с фальшдном | 2000 шт. | |
| 05353025190 | **cobas c pack MULTI**<br>Контейнер реагентный для открытых каналов | 1 шт. | |
| 05463190001 | **Cup-adaptor for STD Rack**<br>Адаптор для пробирок | 260 шт. | |
| 04939719001 | **Reaction Cell Set for c701/c702 module**<br>Реакционные кюветы для модулей c701/c702 | 4 x 406 кювет | |

## Растворы и электроды для ион-селективного блока (ISE)

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03246353001 | **Cl Electrode**<br>Cl-электрод | 1 шт. | |
| 10825441001 | **K Electrode**<br>K-электрод | 1 шт. | |
| 10825468001 | **Na Electrode**<br>Na-электрод | 1 шт. | |
| 03149501001 | **Reference Electrode**<br>Электрод референсный | 1 шт. | |
| 04880480190 | **ISE Diluent Gen.2**<br>ISE Дилюент | 2 x 2000 мл | |
| 04880455190 | **ISE Internal Standard Gen.2**<br>ISE Внутренний стандарт | 2 x 2000 мл | |
| 10820652216 | **ISE Reference Electrode solution**<br>Раствор для электрода референсного | 500 мл | |
| 11183982216 | **ISE Std High**<br>Стандарт Высокий | 10 x 3 мл | |
| 11183974216 | **ISE Std Low**<br>Стандарт Низкий | 10 x 3 мл | |
| 11298500316 | **ISE Cleaning Solution**<br>Раствор моющий | 5 x 100 мл | |
| 04663632190 | **Activator**<br>Активатор | 9 x 12 мл | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты для биохимического модуля cobas c501/502 и анализатора cobas c 311

### Ферменты

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04375351190 | **Acid Phosphotase**<br>Фосфотаза кислая | 8 x 17 мл,<br>8 x 17 мл, 4 x 17 мл,<br>2 x 10 мл | Multi pack 04593138190<br>на «открытом канале» |
| 03333701190 | **ALP IFCC Large**<br>Щелочная Фосфотаза (большая упаковка) | 400 тестов | |
| 03333752190 | **ALP IFCC Small**<br>Щелочная Фосфотаза (малая упаковка) | 200 тестов | |
| 20764957322 | **ALT IFCC**<br>Аланиновая трансаминаза | 500 тестов | |
| 04467388190 | **ALT IFCC with pyridoxal phosphate activation**<br>АЛТ с активацией пиридоксальфосфатом | 275 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03183742122 | **alfa-Amylase EPS**<br>Амилаза | 300 тестов | |
| 20766623322 | **alfa-Amylase EPS Pancreatic**<br>Амилаза панкреатическая | 200 тестов | |
| 20764949322 | **AST IFCC**<br>Аспарагиновая трансаминаза | 500 тестов | |
| 04467493190 | **AST IFCC with pyridoxal phosphate activation 425**<br>АСТ с активацией пиридоксальфосфатом | 425 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 04498577190 | **Cholinesterase Gen.2**<br>Холинэстераза | 200 тестов | |
| 07190794190 | **Creatine Kinase**<br>Креатинкиназа | 200 тестов | |
| 07190808190 | **Creatine Kinase-MB**<br>Кретинкиназа-МВ | 100 тестов | |
| 03002721122 | **GGT IFCC**<br>Гамма-Глютамилтрансфераза | 400 тестов | |
| 03004732122 | **LDH IFCC**<br>Лактатдегидрогеназа | 300 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03029590322 | **Lipase**<br>Липаза | 200 тестов | |
| 05385415190 | **Homocysteine**<br>Гомоцистеин | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |

## Субстраты

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03183688122 | **Albumin BCG**<br>Альбумин в сыворотке | 300 тестов | |
| 20766682322 | **NH3L / Ammonia**<br>Аммоний | 150 тестов | |
| 05795397190 | **Bilirubin Total Gen.3**<br>Общий билирубин | 250 тестов | |
| 05589061190 | **Bilirubin Direct Gen.2**<br>Прямой билирубин | 350 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03289923190 | **CO2-L / Bicarbonate**<br>Двуокись углерода | 250 тестов | |
| 05061482190 | **Calcium Gen.2**<br>Кальций | 300 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 04810716190 | **Creatinine Jaffe Gen.2**<br>Креатинин Яффе | 700 тестов | |
| 03263991190 | **Creatinin PAP**<br>Креатинин энзиматический | 250 тестов | |
| 03039773190 | **Cholesterol**<br>Холестерин | 400 тестов | |
| 07528566190 | **HDL-Cholesterol Gen.4**<br>ЛПВП холестерин | 350 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 07005717190 | **LDL-Cholesterol Gen.3**<br>ЛПНП холестерин | 200 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03183777190 | **Ethanol**<br>Этанол | 100 тестов | |
| 04537939190 | **Fructosamine**<br>Фруктозамин | 150 тестов | |
| 04404483190 | **Glucose HK**<br>Глюкоза | 800 тестов | |
| 20767131322 | **Glucose HK**<br>Глюкоза в гемолизате | 200 тестов | Для гемолизата: Glucose Hemolyzing Reagent Gen. 2 05067235191 |
| 05067235191 | **Hemolyzing reagent Gen.2**<br>Реагент лизирующий для глюкозы | 1000 мл | |
| 03183700190 | **Lactate**<br>Лактат | 100 тестов | |
| 04679598190 | **Lithium**<br>Литий | 100 тестов | |
| 03183696122 | **Iron Gen.2**<br>Железо | 200 тестов | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты для биохимического модуля cobas c501/502 и анализатора cobas c 311

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 06481647190 | **Magnesium Gen.2**<br>Магний | 250 тестов | |
| 03183793122 | **Phosphate Gen.2**<br>Фосфор | 250 тестов | |
| 03183734190 | **Total Protein Gen.2**<br>Общий белок | 300 тестов | |
| 20767107322 | **Triglycerides**<br>Триглицериды | 250 тестов | |
| 04536355190 | **Unsaturated Iron Binding Capacity**<br>Ненасыщенная железосвязывающая способность | 100 тестов | |
| 04460715190 | **UREAL**<br>Мочевина | 500 тестов | |
| 03183807190 | **Uric Acid**<br>Мочевая кислота | 400 тестов | |
| 03333825190 | **Total protein in Urine Gen.3**<br>Общий белок в моче | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |

### Специфические белки

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04469658190 | **Albumin**<br>Альбумин в моче | 100 тестов | |
| 03005771322 | **Alfa1 Antitripsin Gen.2**<br>Альфа-1-антитрипсин | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03333795190 | **Alfa1 acid glicoprotein Gen.2**<br>Альфа-1- кислый гликопротеин | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 04489403190 | **Antistreptolisin O**<br>Антистрептолизин О | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03032566122 | **Apo A1**<br>Аполипопротеин А | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03032574122 | **Apo B**<br>Аполипопротеин В | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03036081122 | **Antitrombin III**<br>Антитромбин III | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 11660551216 | **b2-Microglobulin**<br>beta2-микроглобулин | 2 x 70 тестов | Калибратор входит в набор Multi pack 04593138190 на «открытом канале»<br>Diluent NaCl 9% 04489357190 |
| 04956842190 | **C-Reactive Protein Gen.3**<br>С-реактивный белок | 250 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 20764930322 | **C-Reactive Proteine Latex**<br>С-реактивный белок (латекс) (не для c502) | 300 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 04628918190 | **CPR High Sensitive**<br>С-реактивный белок высокочувствительный | 300 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03001938322 | **Complement C3c Gen.2**<br>Комплемент С3 | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03001962322 | **Complement C4 Gen.2**<br>Комплемент С4 | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 20764663322 | **Ceruloplasmin**<br>Церулоплазмин | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 04912551190 | **D-Dimer Gen.2**<br>Д-Димер | 100 тестов | |
| 04885317190 | **Ferritin Gen.4**<br>Ферритин | 250 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03005593322 | **Haptoglobin Gen.2**<br>Гаптоглобин | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 05336163190 | **Hemoglobin A1c Gen.3**<br>Гликированный гемоглобин ген.3 | 150 тестов | Hemolyzing Reagent Gen.<br>04528182190 HbA1c<br>Для ручной пробоподготовки<br>Hemolyzing Reagent<br>11488457122 |
| 04528182190 | **HbA1c Tina-Quant hemolyzing reagent**<br>Лизирующий реагент (в кассете) | 51 мл | |
| 11488457122 | **Hemolysing reagent HbA1c**<br>Реагент гемолизирующий для HbA1c | 1000 мл | |
| 03507343190 | **IgA Gen.2**<br>Иммуноглобулин А | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03507432190 | **IgG Gen.2**<br>Иммуноглобулин G | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 03507190190 | **IgM Gen.2**<br>Иммуноглобулин М | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 05852625190 | **Lipoprotein (a) Gen.2**<br>Липопротеин(а) | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 04580010190 | **Myoglobin Gen.2**<br>Миоглобин | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 20764655322 | **Prealbumin**<br>Преальбумин | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 20764574322 | **Reumatoid Factors**<br>Ревматоидный фактор | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты для биохимического модуля cobas c501/502 и анализатора cobas c 311

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03015050122 | **Transferrin Gen.2**<br>Трансферрин | 100 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 20763454122 | **Soluble Transferrin Reseptors**<br>Растворимые рецепторы трансферрина | 80 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |
| 06600239190 | **Cystatin C Gen.2**<br>Цистатин С | 225 тестов | |

## Расходные материалы для биохимического модуля cobas c501/502 и анализатора cobas c 311

### Дополнительные растворы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 06544410190 | **EcoTergent, cobas c 501/502**<br>Экотергент, cobas c501/502 | 12 x 59 мл | |
| 05422485190 | **EcoTergent, cobas c 311**<br>Экотергент, cobas c 311 | 60 мл (c-pack) | |
| 04880285190 | **NaOH-D cell wash solution 1**<br>Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки | 2 x 1800 мл | |
| 04880307190 | **Acid wash - cell wash solution 2**<br>Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки | 2 x 1800 мл | |
| 04708725190 | **Sample Cleaner 1 NaOH Multiclean**<br>(не для 502) Промывочный раствор 1 | 12 x 59 мл | для c502 05352991190 Sample Cleaner 1 |
| 05958024190 | **Sample Cleaner 2**<br>(не для 502) Промывочный раствор 2 | 12 x 68 мл | для c502 05968828190 Sample Cleaner 2 |
| 04489241190 | **NAOHD Detergent 1**<br>Промывочный раствор 1 | 66 мл | |
| 04489225190 | **SMS Detergent 2**<br>Промывочный раствор 2 | 50 мл (c-pack) | |
| 04489357190 | **NaCl Diluent Cobas c pack**<br>Дилюент NaCl 9% | 50 мл (c-pack) | |
| 04880994190 | **SCCS**<br>Раствор для спец. промывки кювет | 50 мл (c-pack) | |
| 05168376190 | **Antigen Excess Reagen (START)**<br>Старт (избыток антигена) | 11 мл | |
| 04489365190 | **Serum Index**<br>Сывороточные индексы | 2750 тестов (c-pack) | |

## Аксессуары

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 10394246001 | **cobas sample cups (2 ml)**<br>Пробирки для образцов (2 мл) | 5000 шт. | |
| 05085713001 | **Sample cups micro**<br>Микропробирки | 900 шт. | |
| 04740955001 | **cobas false bottom tube,**<br>Пробирки с фальшдном | 2000 шт. | |
| 04593138190 | **cobas c pack MULTI**<br>Контейнер реагентный для открытых каналов | 1 шт. | |
| 05463190001 | **Cup-adaptor for STD Rack**<br>Адаптор для пробирок | 260 шт. | |
| 04854241001 | **Reaction Cell Set for c 501/502**<br>Реакционные кюветы для модулей c501/502 | 24 сегмента | |
| 04555040001 | **Reaction Cell Set c 311**<br>Реакционные кюветы для c 311 | 18 сегментов | |

## Растворы и электроды для ион-селективного блока (ISE)

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03246353001 | **Cl Electrode**<br>Cl-электрод | 1 шт. | |
| 10825441001 | **K Electrode**<br>K-электрод | 1 шт. | |
| 10825468001 | **Na Electrode**<br>Na-электрод | 1 шт. | |
| 03149501001 | **Reference Electrode**<br>Электрод референсный | 1 шт. | |
| 04522630190 | **ISE Diluent**<br>Дилюент | 5 x 300 мл | |
| 04522320190 | **ISE Internal standard**<br>Стандарт внутренний | 5 x 600 мл | |
| 11360981216 | **ISE Reference Electrode solution**<br>Раствор для электрода референсного | 5 x 300 мл | |
| 11183982216 | **ISE Std High**<br>Стандарт Высокий | 10 x 3 мл | |
| 11183974216 | **ISE Std Low**<br>Стандарт Низкий | 10 x 3 мл | |
| 11298500316 | **ISE Cleaning Solution**<br>Раствор моющий | 5 x 100 мл | |
| 04663632190 | **Activator**<br>Активатор | 9 x 12 мл | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Integra 400 Plus

### Ферменты

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04375351190 | **ACP (Acid Phosphotase)**<br>Фосфатаза кислая | 8 x 17 мл,<br>8 x 17 мл, 4 x 17 мл, 2 x 10 мл | необходима кассета Multi pack 04593138190,<br>на «открытом канале» |
| 03333752190 | **ALP IFCC Small**<br>Щелочная фосфатаза (малая упаковка) | 200 тестов | |
| 03333701190 | **ALP IFCC Large**<br>Щелочная фосфатаза (большая упаковка) | 400 тестов | |
| 20764957322 | **ALT IFCC**<br>АЛТ | 500 тестов | |
| 03183742122 | **alfa-Amylase EPS**<br>альфа-Амилаза | 300 тестов | |
| 20766623322 | **alfa-Amylase EPS Pancreatic**<br>альфа-Амилаза панкреатическая | 200 тестов | |
| 20764949322 | **AST IFCC**<br>АСТ | 500 тестов | |
| 04498577190 | **Cholinesterase Gen. 2**<br>Холинэстераза | 200 тестов | |
| 07190794190 | **Creatine Kinase**<br>Креатинкиназа | 200 тестов | |
| 07190808190 | **Creatine Kinase MB**<br>Креатинфосфокиназа МВ | 100 тестов | |
| 03002721122 | **GGT**<br>Гамма-глютамилтрансфераза | 400 тестов | |
| 03004732122 | **LDH IFCC**<br>Лактатдегидрогеназа (лактат->пируват) | 300 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 03029590322 | **Lipase**<br>Липаза (колориметрический метод) | 200 тестов | |
| 05385415190 | **Homocysteine**<br>Гомоцистеин | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |

### Субстраты

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03183688122 | **Albumin BCG**<br>Альбумин (в сыворотке) | 300 тестов | |
| 20766682322 | **Ammonia**<br>Аммоний | 150 тестов | |
| 03289923190 | **Bicarbonate**<br>Бикарбонат | 250 тестов | |
| 05795397190 | **Bilirubin Total Gen.3**<br>Билирубин общий | 250 тестов | |
| 05589061190 | **Bilirubin Direct**<br>Билирубин прямой | 350 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 05061482190 | **Calcium Gen. 2**<br>Кальций | 300 тестов | |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04810716190 | **Creatinine Jaffe Gen. 2**<br>Креатинин Яффе | 700 тестов | |
| 03263991190 | **Creatinine PAP**<br>Креатинин (энзиматический) | 250 тестов | |
| 03039773190 | **Cholesterol**<br>Холестерин | 400 тестов | |
| 03183777190 | **Ethanol**<br>Этанол | 100 тестов | |
| 07528566190 | **HDL-Cholesterol Gen. 4**<br>ЛПВП холестерин | 350 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 07005717190 | **LDL-Cholesterol Gen. 3**<br>ЛПНП холестерин | 200 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 04537939190 | **Fructosamine**<br>Фруктозамин | 150 тестов | |
| 04404483190 | **Glucose HK 800**<br>Глюкоза | 800 тестов | |
| 20767131322 | **Glucose HK 200**<br>Глюкоза (в гемолизате) | 200 тестов | Для гемолизата: Glucose Hemolyzing Reagent Gen. 2<br>05067235 191 |
| 05067235191 | **Hemolyzing reagent**<br>Реагент лизирующий (для глюкозы) | 1000 мл | |
| 03183700190 | **Lactate**<br>Лактат | 100 тестов | |
| 03183696122 | **Iron Gen. 2**<br>Железо | 200 тестов | |
| 04536355190 | **Unsaturated Iron Binding Capacity**<br>Ненасыщенная железосвязывающая способность | 100 тестов | |
| 06481647190 | **Magnesium Gen.2**<br>Магний | 250 тестов | |
| 03183793122 | **Phosphate Gen. 2**<br>Фосфор | 250 тестов | |
| 03333825190 | **Total protein in Urine Gen. 3**<br>Общий белок (в моче) | 150 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 03183734190 | **Total Protein Gen. 2**<br>Общий белок | 300 тестов | |
| 20767107322 | **Triglycerides**<br>Триглицериды | 250 тестов | |
| 04460715190 | **UREAL**<br>Мочевина | 500 тестов | |
| 03183807190 | **Uric Acid**<br>Мочевая кислота | 400 тестов | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Integra 400 Plus

### Специфические белки

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04469658190 | **Tina-Quant Albumin Gen. 2**<br>Альбумин в моче | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 03005771322 | **Tina-Quant alfa1 Antitripsin Gen. 2**<br>Альфа-1-антитрипсин | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 03333795190 | **Tina-Quant alfa1 acid glicoprotein Gen. 2**<br>Альфа-1-кислый гликопротеин | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 03032566122 | **Tina-Quant Apo A1**<br>Аполипопротеин А | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 03032574122 | **Tina-Quant Apo B**<br>Аполипопротеин В | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 20750948322 | **Antistreptolisin O**<br>Антистрептолизин О | 100 тестов | |
| 03036081122 | **Antitrombin III**<br>Антитромбин | 100 тестов | |
| 04912551190 | **Tina-Quant D-Dimer Gen.2**<br>Д-димер | 100 тестов | |
| 03005593322 | **Tina-Quant Haptoglobin Gen.2**<br>Гаптоглобин | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 05336163190 | **Tina-Quant Hemoglobin A1c Gen.3**<br>Гликированный гемоглобин ген. 3 | 150 тестов | Hemolyzing Reagent Gen. 2<br>04528328190, для ручной пробоподготовки Hemolyzing Reagent 11488457122 |
| 04528328190 | **Hemolyzing reagent HbA1c**<br>Реагент лизирующий (для HbA1c) | 6 x 10 мл | |
| 11488457122 | **Hemolysing reagent HbA1c**<br>Реагент гемолизирующий для HbA1c | 1000 мл | |
| 20737755322 | **IGA**<br>Иммуноглобулин А | 100 тестов | Калибровка Serumproteins T Standard 20737267 322, NaClDiluent 9% 20756350322, Accelerator I 20721867 322 (для педиатрии) |
| 20766631322 | **IGG**<br>Иммуноглобулин G | 100 тестов | Калибровка Serumproteins T Standard 20737267 322, NaClDiluent 9% 20756350322, Accelerator I 20721867 322 (для педиатрии) |
| 20737771322 | **IGM**<br>Иммуноглобулин М | 100 тестов | Калибровка Serumproteins T Standard 20737267 322, NaClDiluent 9% 20756350322, Accelerator I 20721867 322 (для педиатрии) |
| 05852625190 | **Lipoprotein (a) Gen.2**<br>Липопротеин(а) | 150 тестов | 04489357190 Diluent NaCl 9% |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 20721867322 | **Accelerator I**<br>Акселератор | 100 мл | |
| 03001938322 | **Tina-Quant Complement C3c Gen. 2**<br>Комплемент С3 | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 03001962322 | **Tina-Quant Complement C4 Gen. 2**<br>Комплемент С4 | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 11820176316 | **Tina Quant KAPPA**<br>Тина-Квант Каппа | 150 тестов | Multi pack 04593138190, на «открытом канале» Diluent NaCl 9% 20756350322 |
| 11820184316 | **Tina Quant LAMBDA**<br>Тина-Квант Лямбда | 100 тестов | Multi pack 04593138190, на «открытом канале» Diluent NaCl 9% 20756350322 |
| 04580010190 | **Myoglobin Gen. 2**<br>Миоглобин | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 20764655322 | **Prealbumin**<br>Преальбумин | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 20764574322 | **Reumatoid Factors**<br>Ревматоидные факторы | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 20764930322 | **C-Reactive Proteine**<br>С-реактивный белок (латекс) | 300 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 04628918190 | **CPR High Sensitive**<br>С-реактивный белок (высокочувствительный) | 300 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 03528995190 | **Tina Quant Ferritin Gen. 2**<br>Ферритин | 200 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 20763454122 | **Soluble Transferrin Reseptors**<br>Растворимые рецепторы трансферрина | 80 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 03015050122 | **Transferrin Gen. 2**<br>Трансферрин | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 20764663322 | **Ceruloplasmin**<br>Церулоплазмин | 100 тестов | Diluent NaCl 9%<br>20756350322 |
| 04489365190 | **Serum Index Gen.2**<br>Реагент для определения сывороточных индексов | 2750 тестов | |
| 06600239190 | **Cystatin C Gen.2**<br>Цистатин С | 225 тестов | |

### Лекарственный мониторинг

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04340892190 | **CSA2 / Cyclosporin A-2**<br>Набор реагентов для определения циклоспорина А | 100 тестов | |
| 20766305122 | **Cyclosporine Calibrators**<br>Калибратор циклоспорина | 1 x 2.5мл,<br>5 x 2 мл | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Integra 400 Plus

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 20766399122 | **Cyclosporine Calibrators 0 ng/ml**<br>Нулевой калибратор Циклоспорина | 3 x 2.5 мл | |
| 20766364122 | **COBAS INTEGRA Cyclosporine Sample Pretreatment**<br>Реагент для обработки проб на циклоспорин | 4 x 40 мл | |

### Растворы и расходные материалы для ион-селективного блока (ISE)

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 21029355001 | **K electrode**<br>K электрод | 1 шт. | |
| 21029371001 | **Na electrode**<br>Na электрод | 1 шт. | |
| 03003523001 | **Cl electrode**<br>Cl электрод | 1 шт. | |
| 21044303001 | **Li electrode**<br>Li электрод | 1 шт. | |
| 21029398001 | **Reference Electrode**<br>Референсный электрод | 1 шт. | |
| 20763055122 | **ISE Calibrator direct**<br>Калибратор прямой | 250 мл | |
| 20738050122 | **ISE Solution 1**<br>Стандартный раствор № 1 | 6 x 17,5 мл | |
| 20738069122 | **ISE Solution 2**<br>Стандартный раствор № 2 | 6 x 9,5 мл | |
| 20738077122 | **ISE Solution 3**<br>Стандартный раствор № 3 (Li-электрод) | 6 x 9,5 мл | |
| 20738085122 | **ISE REF. Electrolyte**<br>Референсный раствор | 250 мл | |
| 20763098122 | **ISE Etcher**<br>Чистящий раствор | 6 x 11 мл | |
| 20763063122 | **ISE Calibrator indirect urine**<br>Калибратор непрямой (для мочи) | 1 x 250 мл | |

### Растворы и расходные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04663632190 | **Activator**<br>Активатор | 9 x 12 мл | |
| 20764337322 | **INTEGRA CLEAN 150**<br>Кассета с моющим раствором | 1 шт. | |
| 20763071122 | **Deproteinizer**<br>Чистящий раствор | 6 x 21 мл | |
| 20756350322 | **cobas INTEGRA NaCl Diluent 9%**<br>NaCl 9% дилюент | 6 x 22 мл | |
| 20754765322 | **Cleaner Interga**<br>Раствор моющий | 1000 мл | |

### Аксесуары

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 21045318001 | **cobas cups white with hole**<br>Чашечки для проб белые с отверстием | 1000 шт. | |
| 21044869001 | **cobas cups blue with hole**<br>Чашечки для проб голубые с отверстием | 1000 шт. | |
| 11902997001 | **BM/HIT Standert Racks 5001-5050 Standart**<br>Штативы для проб | 50 шт. | |
| 21043862001 | **Microcuv / INTEGRA**<br>Измерительные кюветы | 20 x 1000 шт. | |
| 21046179001 | **Waste Conteiner INTEGRA 400**<br>Сливной контейнер | 20 шт. | |
| 28086834001 | **Adapter for cup sample**<br>Адаптеры для проб к анализатору Integra 400 | 1 x 30 шт. | |
| 28048762001 | **Rack 15 Sample Assay**<br>Штатив для проб к анализатору Integra 400 | 1 шт. | |
| 28073929001 | **Reagent cassette rack INTEGRA 400**<br>Штатив для реагентов к анализатору Integra 400 | 1 шт. | |

## Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора c111

### Ферменты

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04657373190 | **ALP IFCC**<br>Щелочная фосфотаза | 4 x 50 тестов | Chimneys 11930630001 |
| 05401496190 | **a- Amylase**<br>а-Амилаза | 2 x 100 тестов | |
| 05401771190 | **a-Amylase Pancreatic**<br>а-Амилаза панкреатическая | 2 x 50 тестов | |
| 04657543190 | **ASTL IFCC**<br>АСТ | 4 x 100 тестов | |
| 04718569190 | **ALTL IFCC**<br>АЛТ | 4 x 100 тестов | |
| 07442017190 | **Creatine Kinase**<br>Креатинкиназа | 2 x 100 тестов | |
| 07442050190 | **Creatine Kinase MB**<br>Креатинкиназа МВ | 2 x 50 тестов | |
| 05401461190 | **GGT2**<br>Гамма-глютамилтрансфераза | 2 x 100 тестов | |
| 05401674190 | **LDH**<br>Лактатдегидрогеназа | 2 x 50 тестов | Chimneys 11930630001 |
| 05401704190 | **Lipase**<br>Липаза | 2 x 50 тестов | Cleaner 04774248190 |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора c111

### Субстраты

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04657357190 | **Albumin**<br>Альбумин | 4 x 100 тестов | Cleaner 04774248190 |
| 05401739190 | **Ammonia (NH3)**<br>Аммоний | 2 x 50 тестов | |
| 05455308190 | **Bicarbonate (CO2-L)**<br>Бикарбонат | 2 x 100 тестов | |
| 05589134190 | **Bilirubin Direct Gen.2**<br>Прямой билирубин | 2 x 50 тестов | NaCl Diluent 9%<br>04774230190 |
| 05795648190 | **Bilirubin Total Gen.3**<br>Общий билирубин | 4 x 100 тестов | |
| 05061504190 | **Calcium Gen.2**<br>Кальций | 4 x 100 тестов | NaCl Diluent 9%<br>04774230190 |
| 04718917190 | **Cholesterol**<br>Холестерол | 4 x 100 тестов | |
| 05401755190 | **Creatinine Jaffe Gen.2**<br>Креатинин Яффе | 4 x 100 тестов | |
| 05401470190 | **Creatinine Plus Gen.2**<br>Креатинин Плюс, энзиматический метод | 2 x 100 тестов | |
| 04657527190 | **Glucose HK**<br>Глюкоза (гексокиназный метод) | 4 x 100 тестов | |
| 05067235191 | **Hemolyzing reagent**<br>Реагент лизирующий для глюкозы | 1000 мл | |
| 07528604190 | **HDL-Cholesterol Gen.4**<br>ЛПВП холестерин | 2 x 100 тестов | NaCl Diluent 9%<br>04774230190 |
| 07005806190 | **LDL-Cholesterol Gen.3**<br>ЛПНП холестерин | 2 x 50 тестов | NaCl Diluent 9%<br>04774230190 |
| 05401658190 | **Iron Gen.2**<br>Железо | 2 x 50 тестов | |
| 05401666190 | **Lactate**<br>Лактат | 2 x 50 тестов | |
| 05401712190 | **Magnesium**<br>Магний | 2 x 50 тестов | Cleaner 04774248190 |
| 05401780190 | **Phosphorus**<br>Фосфор | 2 x 50 тестов | |
| 04657586190 | **Total Protein Gen.2**<br>Общий белок | 4 x 100 тестов | Chimneys 11930630001 |
| 04657594190 | **Triglicerides**<br>Триглицериды | 4 x 50 тестов | |
| 04657616190 | **Urea**<br>Мочевина | 4 x 100 тестов | Chimneys 11930630001<br>NaCl Diluent 9%<br>04774230190 |
| 04657608190 | **Uric Acid Gen.2**<br>Мочевая кислота | 4 x 100 тестов | Cleaner 04774248190 |

## Специфические белки

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05401500190 | **Albumin in Urine**<br>Альбумин в моче | 2 x 100 тестов | Chimneys 11930630001<br>Cleaner 04774248190<br>NaCl Diluent 9% 04774230190 |
| 05401615190 | **C-reactive protein (latex)**<br>С-реактивный белок (латексное усиление) | 2 x 100 тестов | Chimneys 11930630001<br>NaCl Diluent 9%<br>04774230190 |
| 05401607190 | **C-reactive protein (High sensitive)**<br>С-реактивный белок высокочувствительный | 2 x 50 тестов | NaCl Diluent 9%<br>04774230190 |
| 05077753190 | **D-Dimer Gen.2**<br>Д-димер | 4 x 50 тестов | NaCl Diluent 9%<br>04774230190 |
| 05336180190 | **HbA1c TQ Gen.3**<br>Гликированный гемоглобин | 2 x 100 тестов | Hemolyzing reagent Gen.<br>05007232190<br>Для ручной пробоподготовки HbA1c<br>Hemolyzing Reagent<br>11488457122 |
| 11488457122 | **Hemolysing reagent HbA1c**<br>Реагент гемолизирующий для HbA1c (для ручного разведения) | 1000 мл | |
| 05007232190 | **Hemolyzing Reagent cobas c systems**<br>Гемолизирующий реагент | 8 x 6,3 мл | |

## Дополнительные растворы для c111

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04663632190 | **Activator**<br>Активатор | 9 x 12 мл | |
| 04774248190 | **Detergent I (NAOH-D)**<br>Детергент 1 | 4 x 21 мл | |
| 04774230190 | **Diluent NACL 9%**<br>Дилюент NACL 9% | 4 x 12 мл | |
| 20754765322 | **Cleaner acid Integra**<br>Моющий раствор кислый (для Интегра) | 1000 мл | |

## Аксессуары и расходные материалы для c111

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 10394246001 | **cobas sample cups (2 ml)**<br>Пробирки для образцов (2 мл) | 5000 шт. | |
| 04357108001 | **Cuvette segments cobas c 111**<br>Измерительные кюветы в сегментах | 168 x 10 шт. | |
| 04352483001 | **Paper Thermoprinter**<br>Бумага для термопринтера | 5 шт. | |
| 11930630001 | **Chimneys**<br>Вкладыш для реагента | 3 x 32 шт. | |
| 04793811001 | **Reagent Disk**<br>Дополнительный реагентный ротор | 1 шт. | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора c111

### Растворы и расходные материалы для ион-селективного блока (ISE)

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04834925001 | **K electrode**<br>K электрод | 1шт. | |
| 04838084001 | **Na electrode**<br>Na электрод | 1шт. | |
| 04834909001 | **Cl electrode**<br>Cl электрод | 1шт. | |
| 04838092001 | **Reference Electrode**<br>Референсный электрод | 1шт. | |
| 04842367001 | **Dummy Electrode**<br>Электрод-заглушка | 1шт. | |
| 04838106001 | **ISE Calibration kit**<br>Набор калибраторов ISE | 6 x 8 мл | |
| 04838157001 | **ISE REF. SOLUTION c 111**<br>Раствор для референсного электрода | 2 x 115 мл | |
| 04838165001 | **ISE Etcher**<br>Чистящий раствор | 2 x 11 мл | |
| 04838149001 | **ISE Calibrator indirect (urine)**<br>Калибратор непрямой / для мочи ISE | 2 x 230 мл | |
| 04838181001 | **ISE Deproteinizer**<br>Депротеинизатор cobas c 111 | 2 x 11 мл | |

## Калибраторы и контрольные материалы для биохимических анализаторов cobas

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 10759350190 | **Calibrator for automated systems (C.f.a.s.)**<br>Калибратор для автоматизированных систем | 12 x 3 мл | |
| 12172623122 | **C.f.a.s. Lipids**<br>Калибратор липидов | 3 x 1 мл | |
| 11355279216 | **C.f.a.s. Protein**<br>Калибратор белков для автоматизированных систем | 5 x 1 мл | |
| 11447394216 | **C.f.a.s. CK-MB**<br>Калибратор для автоматизированных систем CK-MB | 3 x 1 мл | |
| 12146401216 | **Fe Standard**<br>Калибратор для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности (UIBC) | 1 x 75 мл | |
| 05117003190 | **PreciControl ClinChem Multi 1**<br>Контроль универсальный I | 20 x 5 мл | |
| 05947626190 | **PreciControl ClinChem Multi 1**<br>Контроль универсальный I | 4 x 5 мл | |
| 05117216190 | **PreciControl ClinChem Multi 2**<br>Контроль универсальный II | 20 x 5 мл | |
| 05947774190 | **PreciControl ClinChem Multi 2**<br>Контроль универсальный II | 4 x 5 мл | |
| 10557897122 | **Precinorm Protein**<br>Прецинорм Протеин | 3 x 1 мл | |
| 11333127122 | **Precipath Protein**<br>Преципат Протеин | 3 x 1 мл | |
| 11098993122 | **Precimat Fructosamine**<br>Прецимат Фруктозамин | 3 x 1 мл | |
| 11098985122 | **Precinorm Fructosamine**<br>Прецинорм Фруктозамин | 3 x 1 мл | |
| 11174118122 | **Precipath Fructosamine**<br>Преципат Фруктозамин | 3 x 1 мл | |
| 20751995190 | **AMMONIAK / ETHANOL / CO2 CALIBRATOR**<br>Аммоний/этанол/CO2 калибратор | 2 x 4 мл | |
| 20752401190 | **AMMONIAK / ETHANOL / CO2 CONTROL N**<br>Аммоний/Этанол/CO2 контроль норма | 5 x 4 мл | |
| 20753009190 | **AMMONIAK / ETHANOL / CO2 CONTROL P**<br>Аммоний/Этанол/CO2 контроль патология | 5 x 4 мл | |
| 05142423190 | **Homocysteine Control Kit**<br>Контроль Гомоцистеина | 2 x 2 x 3 мл | |
| 05385504190 | **Homocysteine Calibrator Kit**<br>Калибратор Гомоцистеина | 2 x 3 мл | |
| 20766321322 | **CRP Control N**<br>Контроль С-реактивного белка (норма) | 5 x 0,5 мл | |
| 03121305122 | **C.f.a.s. PUC**<br>Калибратор белков мочи | 5 x 1 мл | |

# Сывороточная рабочая зона

## Калибраторы и контрольные материалы для биохимических анализаторов cobas

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03121313122 | **Precinorm PUC**<br>Преципорм белки мочи | 4 x 3 мл | |
| 03121291122 | **Precipath (PUC)**<br>Преципат белки мочи | 4 x 3 мл | |
| 03555941190 | **C.f.a.s. PAC**<br>Калибратор ПАЦ (преальбумин, антистрептолизин, церулоплазмин) | 3 x 1 мл | |
| 04528417190 | **C.f.a.s. HbA1c**<br>Калибратор HbA1c | 3 x 2 мл | |
| 05479207190 | **PreciControl HbA1c normal**<br>Гликозилированный гемоглобин контроль норма | 4 x 1 мл | |
| 05912504190 | **PreciControl HbA1c pathological**<br>Гликозилированный гемоглобин контроль патология | 4 x 1 мл | |
| 05852641190 | **Preciset Lp (a) Gen.2**<br>Калибратор Lp(a) | 5 x 1 мл | |
| 05852650190 | **PreciControl Lp(a) Gen.2 Roche systems**<br>Контроль Lp(a) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 12172828322 | **PRECISET RF**<br>Набор калибраторов РФ | 5 x 1 мл | |
| 03005496122 | **Control Set RF**<br>Набор контролей РФ | 2 x 2 x 1 мл | |
| 12148331122 | **Preciset sTfR**<br>Набор калибраторов рецепторов трансферрина | 5 x 1 мл | |
| 12148340122 | **Control Set sTfR**<br>Набор контролей рецепторов трансферрина | 2 x 2 x 3 мл | |
| 04580044190 | **C.f.a.s. Myoglobin**<br>Стандарт миоглобина | 3 x 1 мл | |
| 11730835216 | **Control Set Myoglobin**<br>Набор контролей Миоглобина | 2 x 2 x 3 мл | |
| 05050901190 | **D-Dimer Calibrator Gen.2**<br>Д-Димер Калибратор | 6 x 0,5 мл | |
| 05050936190 | **D-Dimer Control I/II Gen.2**<br>D-Димер контроль I/II | 2 x 2 x 1 мл | |
| 11012002122 | **PreciChrom I / II**<br>Контрольная плазма для определения показателей свертывания крови | 12 x 1 мл | |
| 11012045122 | **Precimat Chromogen**<br>Калибровочная плазма для определения показателей свертывания крови | 6 x 0,5 мл | |
| 11729683216 | **b2-MICROGLOBULIN Control-Set Serum**<br>Контроль b2-микроглобулина | 2 x 2 x 1 мл | |
| 20737267322 | **Serumproteins T-Standard**<br>Стандарт белков сыворотки | 5 x 0,5 мл | для Integra 400 plus |
| 04975901191 | **C.f.a.s. Cystatin C**<br>Калибратор цистатин С | 4 x 1.0 мл | |
| 06729371190 | **Cystatin C Control Set**<br>Контроль цистатин С | 3 x 3 x 1.0 мл | |

## Таблица соответствия калибраторов и контрольных материалов для биохимических анализаторов cobas

| | Калибратор | Контроль норма | Контроль патология |
|---|---|---|---|
| **Ферменты** | | | |
| Acid Phosphatase | Cfas | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Alkaline phosphatase | | | |
| ALT | | | |
| a-Amylase | | | |
| Pancreatic a-Amylase | | | |
| AST | | | |
| Cholinesterase | | | |
| Cholinesterase Dibucain | | | |
| CK | | | |
| CK - MB | Cfas CK-MB | | |
| GLDH Gen.3 | Cfas | | |
| HBDH Gen.2 | | | |
| GGT | | | |
| LDHI2 IFCC | | | |
| Lipase | | | |
| Homocysteine | HCYS Calib Kit | HCYS Control Kit | |
| **Субстраты** | | | |
| Albumin ( BCG) | Cfas | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Bilirubin Total Gen.3 | | | |
| Bilirubin Direct Gen.2 | | | |
| Ammonia | NH3/Etho/CO2 Std. | NH3/Etho/CO2 Cont. N | NH3/Etho/CO2 Cont. P |
| Bicarbonate | | | |
| Ethanol Gen.2 | | | |
| Calcium | Cfas | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Creatinine Jaffe | | | |
| Creatinine Jaffe (моча) | | PN PUC | PP PUC |
| Creatinine enzymatic | | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Creatinine enzymatic (моча) | | PN PUC | PP PUC |
| Cholesterol | Cfas | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| HDL - Cholesterol direct | Cfas Lipid | | |
| LDL - Cholesterol direct | | | |
| Fructosamine | Precimat Fructo | PN Fructo | PP Fructo |
| Glucose HK | Cfas | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Lactate | | | |
| Iron | | | |
| Magnesium | | | |
| Phosphate Inorganic | | | |
| Total Protein | | | |

# Сывороточная рабочая зона

## Калибраторы и контрольные материалы для биохимических анализаторов cobas

| | Калибратор | Контроль норма | Контроль патология |
|---|---|---|---|
| Total Protein in Urine + CSF (TPUC3) | Cfas PUC | PN PUC | PP PUC |
| Triglycerides | Cfas | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Urea *** | | | |
| Uric Acid | | | |
| Un. Iron Bind Capacity (UIBC) | Fe Standard | | |
| **Специфические белки** | | | |
| Albumin turbidimetric | Cfas PUC | PreciControl Multi 1<br>PN PUC (для Integra 400 Plus) | PreciControl Multi 2<br>PP PUC (для Integra 400 Plus) |
| alpa 1 Antitrypsin | Cfas Proteins | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| AAGP | | | |
| Apolipoprotein A-1 | Cfas Lipid | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Apolipoprotein B | | | |
| Antistreptolysin O | Cfas PAC | | |
| Antitrombine | Precimat Chrom. | Precichrom I/II | |
| b-2 Microglobulin | входит в состав набора | Beta2-microglobulin Control Set Serum | |
| D-Dimer | D-Dimer Calib. | D-Dimer Control Set I/II | |
| Haptoglobin | Cfas Proteins | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Glycated Hemoglobin A1C Gen.3 | Cfas HbA1c | PreciControl HbA1c norm | PreciControl HbA1c norm |
| Immunoglobulin A** | Cfas Proteins*; Serumproteins T Standards (для cobas Integra) | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Immunoglobulin G** | | | |
| Immunoglobulin M** | | | |
| Complement C3c | Cfas Proteins | | |
| Complement C4 | | | |
| Kappa light | | PreciControl Multi 1* | PreciControl Multi 2* |
| Lambda light | | | |
| Lp(a) | Cfas Lp(a) | Lp(a) Control Set I/II | |
| Myoglobin | Cfas Myo | Myo Control Set I/II | |
| Prealbumin | Cfas PAC | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Rheumatoid Factor | Preciset RF | RF Control Set I/II0 | |
| C - Reactive Protein Gen.3* | Cfas Proteins | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| C - Reactive Protein LX | | | |
| C - Reactive Protein HS | | CRP Control N | PreciControl Multi 1 |
| Ferritin Gen.2 | | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Ferritin Gen.4* | | | |
| STrF | Preciset sTfR | sTfR Control Set I/II | |
| Transferrin | Cfas Proteins | PreciControl Multi 1 | PreciControl Multi 2 |
| Ceruloplasmin | Cfas PAC | | |
| Cystatin C | Cfas Cystatin C | Cystatin C Control Set I/II | |

*не для cobas Integra
**для стандартной аппликации
*** для аппликации мочи используется сторонний контроль

# Реагенты и расходные материалы для иммунохимического анализатора cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

### Диагностика нарушений функции щитовидной железы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11731459122 | **TSH**<br>Тиреотропнный гормон (ТТГ) | 200 тестов | 0,005-100 мкМЕ/мл |
| 11731360122 | **T3**<br>Трийодтиронин (Т3) | 200 тестов | 0,3-10 нмоль/л |
| 06437206190 | **FT3 III**<br>Свободный трийодтиронин (СТ3) | 200 тестов | 0,4-50 пмоль/л |
| 12017709122 | **T4**<br>Тироксин (Т4) | 200 тестов | 5.4-320 нмоль/л |
| 07976836190 | **FT4 III**<br>Свободный тироксин (СТ4) | 200 тестов | 0.5-100 пмоль/л |
| 11731394122 | **T-Uptake**<br>Т-захват | 200 тестов | Индекс связанного тироксина 0,2-1,9 |
| 06445896190 | **Tg II**<br>Тиреоглобулин (ТГ) | 100 тестов | 0,04-500 нг/мл |
| 06513107190 | **Tg II Confirmatory Test**<br>ТГ подтверждающий | 50 тестов | |
| 06368590190 | **Anti-TPO**<br>Антитела к тиреопероксидазе | 100 тестов | 5-600 МЕ/мл |
| 06368697190 | **Anti-TG**<br>Антитела к тиреоглобулину | 100 тестов | 10-4000 МЕ/мл |
| 04388780190 | **Anti-TSHR***<br>Антитела к рецепторам ТТГ | 100 тестов | 0,3-40 МЕ/л |

* Калибраторы входят в состав набора.

### Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04738551190 | **TSH CalSet**<br>Калибратор для ТТГ | 2 x 2 x 1,3 мл | |
| 11731548122 | **T3 CalSet**<br>Калибратор для Т3 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 06437222190 | **FT3 III CalSet**<br>Калибратор для СТ3 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 12017717122 | **T4 CalSet**<br>Калибратор для Т4 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 07976879190 | **FT4 III CalSet**<br>Калибратор для СТ4 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 06472931190 | **Anti-TPO CalSet**<br>Калибратор для антител к ТПО | 2 x 2 x 1,5 мл | |
| 06368603190 | **Anti-TG CalSet**<br>Калибратор для антител к ТГ | 2 x 2 x 1,5 мл | |
| 06528309190 | **T-uptake CalSet**<br>Калибратор для Т-захвата | 2 x 2 x 1 мл | |
| 06445900190 | **Tg II CalSet**<br>Калибратор для тиреоглобулина | 2 x 2 x 1 мл | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05618860190 | **PreciControl Varia**<br>Контрольная сыворотка Вариа для определения: витамина B12, ферритина, фолатов, β-CrossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина Д | 2 x 2 x 3 мл | |

### Диагностика ревматоидного артрита

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05031656190 | **Anti-CCP***<br>Анти- ЦЦП | 100 тестов | 7-500 Е/мл |
| * Калибраторы входят в состав набора. | | | |

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05031664190 | **PreciControl Anti-CCP**<br>Контрольная сыворотка по анти-ЦЦП | 2 x 2 x 2 мл | |

### Диагностика сепсиса

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05056888200 | **BRAHMS PCT***<br>Прокальцитонин | 100 тестов | 0,02-100 нг/мл |
| 05109442190 | **IL6**<br>IL-6 (интерлейкин-6) | 100 тестов | 1,5-5000 пг/мл |
| * Калибраторы и контроль входят в состав набора. | | | |

### Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05109469190 | **IL6 CalSet**<br>Калибратор для IL-6 (интерлейкина-6) | 2 x 2 x 2 мл | |

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05341787190 | **PreciControl MultiMarker**<br>Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt-1), плацентарного фактора роста (PlGF), АКТГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина | 2 x 3 x 2 мл | |

## Дополнительные растворы и разбавители проб

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11732277122 | **Diluent Universal**<br>Универсальный разбавитель проб | 2 x 16 мл | |
| 03183971122 | **Diluent Universal**<br>Универсальный разбавитель проб | 2 x 36 мл | |
| 05192943190 | **Diluent Universal 2**<br>Универсальный разбавитель проб 2 | 2 x 36 мл | Совместим с реагентами 07957190190 AMH Plus и 06687733190 Cortisol II, для автоматического и ручного разведения образцов. |
| 03004864122 | **NSE Diluent**<br>Разбавитель проб при определении NSE | 4 x 3 мл | |
| 03028542122 | **Diluent Estradiol/Progesteron**<br>Разбавитель только для прогестерона | 2 x 22 мл | |
| 03609987190 | **Diluent MultiAssay**<br>Разбавитель проб Мультитест при определении: С-пептида (сыворотка и моча), СГСГ (SHBG), ТТГ, эстрадиола | 2 x 16 мл | |
| 11361252122 | **Diluent Hepatitis A**<br>Разбавитель проб при определении: Анти-ВГА-антител | 2 x 15 мл | |
| 11298500316 | **ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean**<br>Чистящий раствор | 5 x 100 мл | |

## Расходные материалы для анализатора cobas e411

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание<br>Кол-во тестов** |
|---|---|---|---|
| 11662988122 | **Procell Elecsys**<br>Субстрат-реагент Procell | 6 x 380 мл | ~900-1000 тестов |
| 08243875190 | **Cleancell Elecsys**<br>Промывающий буфер Cleancell | 6 x 380 мл | ~900-1000 тестов |
| 08243930190 | **Assay Cup Elecsys**<br>Реакционные пробирки | 60 x 60 шт. | 3500-3600 тестов |
| 11706799001 | **Assay Tip Elecsys**<br>Наконечники для дозатора | 30 x 120 шт. | 1700-1800 тестов |
| 11800507001 | **Clean Liner Elecsys 2010/cobas e 411**<br>Пластиковые контейнеры для твердых отходов | 1 уп. x 14 шт. | |
| 05151643001 | **Measuring Cell with reference electrode**<br>Измерительная ячейка с референсным электродом | 1 шт. | |
| 11729306122 | **BlankCell Elecsys**<br>Реагент для проведения фоновой пробы | 2 x 50 мл | |

# Анализаторы газов крови и электролитов

## Анализатор критических состояний cobas b 221

### Приборы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03337111001 | **cobas b 221<2> (BG/COOX)**<br>Анализатор критических состояний cobas b 221 мод. 2 (Газы крови/Оксиметрия) | 1 штука | |
| 03337138001 | **cobas b 221<4> (BG/ISE/COOX)**<br>Анализатор критических состояний cobas b 221 мод. 4 (Газы крови/Электролиты/ Оксиметрия) | 1 штука | |
| 03337154001 | **cobas b 221<6> (BG/ISE/MSS/COOX)**<br>Анализатор критических состояний cobas b 221 мод. 6 (Газы_крови/Электролиты/ Метаболиты/ Оксиметрия) | 1 штука | |
| 03313522001 | **AUTO QC MODUL cobas**<br>Модуль автоматического контроля качества | 1 штука | МАКК. Устанавливается инженером |

### Реагенты и контрольные материалы к анализаторам cobas b 221, OMNI S

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03260917184 | **S1 Rinse Solution**<br>Промывочный раствор Эс 1 | 2 контейнера | |
| 03260925184 | **S2 Fluid Pack**<br>Контейнер с реагентами Эс 2 | 1 контейнер | |
| 03260933184 | **S3 Fluid Pack A**<br>Контейнер с реагентами Эс 3А | 1 контейнер | |
| 03321193001 | **COMBITROL PLUS B, LEVEL 1 (COOX)**<br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 1 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая | |
| 03321207001 | **COMBITROL PLUS B, LEVEL 2 (COOX)**<br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 2 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая | |
| 03321215001 | **COMBITROL PLUS B, LEVEL 3 (COOX)**<br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 3 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая | |
| 03321169001 | **AUTO-TROL PLUS B, LEVEL 1 (COOX)**<br>Контрольный материал АВТО-трол Плюс Б, уровень 1 (40x1.7мл) | 40 ампул<br>по 1,7 мл каждая | Для МАКК |
| 03321177001 | **AUTO-TROL PLUS B, LEVEL 2 (COOX)**<br>Контрольный материал АВТО-трол Плюс Б, уровень 2 (40x1.7мл) | 40 ампул<br>по 1,7 мл каждая | Для МАКК |
| 03321185001 | **AUTO-TROL PLUS B, LEVEL 3 (COOX)**<br>Контрольный материал АВТО-трол Плюс Б, уровень 3 (40x1.7мл) | 40 ампул<br>по 1,7 мл каждая | Для МАКК |

### Расходные материалы и принадлежности к анализаторам cobas b 221, OMNI S

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03111598180 | **Electrode Sodium (Na+)**<br>Натриевый микроэлектрод | 1 штука | |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03111628180 | **Potassium Electrode (K+)**<br>Калиевый микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111644180 | **Calcium Electrode (Ca++)**<br>Кальциевый микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111571180 | **AVL Micro Electrode - Cl-**<br>Хлорный микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111679180 | **PCO2 Electrode**<br>pCO2-микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111695180 | **PO2 Electrode**<br>pO2-микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111717180 | **pH Electrode**<br>pH-микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111873180 | **Ref. Electrode**<br>Референсный микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111849035 | **Electrode Dummy**<br>Микроэлектрод-заглушка | 1 штука | Позиция обязательна для инсталляции прибора |
| 03261085184 | **GLU/LAC/UREA (BUN) Cassette**<br>Кассета Глюкоза/ Лактат/ Мочевина | 1 штука | |
| 03260887184 | **GLU/LAC Cassette**<br>Картридж Глюкоза/Лактат | 1 штука | |
| 03260895184 | **GLU Cassette**<br>Картридж Глюкоза | 1 штука | |
| 03351262001 | **MSS Dummy Sensor cobas b 221**<br>Заглушка для метаболитного контакта | 1 штука | Позиция обязательна для инсталляции прибора |
| 03260909184 | **Sensor contact (SCON)**<br>Сенсорный контакт SCON | 1 штука | Позиция обязательна для инсталляции прибора |
| 03112071180 | **Reference contact (RCON), OMNI/cobas b221**<br>Референсный контакт | 1 штука | Позиция обязательна для инсталляции прибора |
| 03113361180 | **Termo Printer Paper**<br>Термобумага, 6шт. | 6 роликов | |
| 03110435180 | **Deproteinizer**<br>Раствор для антисептики | 1 флакон<br>емкость 125 мл | |
| 03110923035 | **Hb-Calibrator**<br>Калибратор гемоглобина (5x1.2 мл) | 5 ампул<br>по 1.2 мл каждая | |
| 03112098035 | **CLEANING KIT FOR CL-ELECTRODE**<br>Набор для чистки хлорного электрода | 1 штука | |
| 03144054001 | **W Waste Container**<br>Контейнер для отходов W, 2 шт. | 2 штуки | |
| 03112071180 | **Reference Contact (RCon)**<br>Референсный контакт | 1 штука | |
| 03087603001 | **Tube holder (cobas b 221)**<br>Держатель трубок | 1 штука | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11731416190 | **Precicontrol Universal**<br>Универсальная контрольная сыворотка | 2 x 2 x 3 мл | |
| 06445918190 | **PreciControl Thyro Sensitive**<br>Контрольная сыворотка для ТТГ и ТГ | 4 x 2 мл | |
| 05042666191 | **PreciControl ThyroAB**<br>Контрольная сыворотка для антител к рецепторам ТТГ, антител к ТГ и ТПО | 4 x 2 мл | |

### Диагностика нарушений функции паращитовидной железы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11972103122 | **PTH**<br>Паратгормон | 100 тестов | 0,127-530 пмоль/л<br>18 минут |
| 04892470190 | **PTH STAT**<br>Паратгормон - экспресс-метод | 100 тестов | 0,127-530 пмоль/л<br>9 минут<br>Нельзя использовать на анализаторе MODULAR E170! |
| 05608546190 | **PTH (1-84)**<br>Паратгормон 1-84 | 100 тестов | 0,583-244 пмоль/л<br>18 минут |

### Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 08243875190 | **PTH CalSet**<br>Калибратор для паратгормона | 2 x 2 x 1 мл | |
| 08243930190 | **PTH STAT CalSet**<br>Калибратор для паратгормона экспресс-метод | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05608554190 | **PTH (1-84) CalSet**<br>Калибратор для паратгормона (1-84) | 2 x 2 x 1 мл | |

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05618860190 | **PreciControl Varia**<br>Контрольная сыворотка Вариа для: витамина B12, ферритина, фолатов, β-CrossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина D | 2 x 2 x 3 мл | |

### Диагностика эндокринных нарушений репродуктивной функции

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 07957190190 | **AMH Plus**<br>Антимюллеров гормон (АМГ) | 100 тестов | 0.01-23 нг/мл |
| 11732234122 | **LH**<br>Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 100 тестов | 0,1-200 мМЕ/мл |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11775863122 | **FSH**<br>Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 100 тестов | 0,1-200 мМЕ/мл |
| 06656021190 | **Estradiol III**<br>Эстрадиол | 100 тестов | 18,4-11010 пмоль/л |
| 03203093190 | **Prolactin II**<br>Пролактин | 100 тестов | 1,0-10000 мкМЕ/мл |
| 07092539190 | **Progesterone III**<br>Прогестерон | 100 тестов | 0,159-191 нмоль/л |
| 05200067190 | **Testosterone II**<br>Тестостерон | 100 тестов | 0,087-52 нмоль/л |
| 03052001190 | **SHBG**<br>Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 100 тестов | 0,35-200 нмоль/л |

### Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 07957203190 | **CalSet AMH Plus**<br>Калибратор для антимюллерова гормона (АМГ) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03561097190 | **LH CalSet II**<br>Калибратор для лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03032680122 | **FSH CalSet II**<br>Калибратор для фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 06656048190 | **Estradiol III CalSet II**<br>Калибратор для эстрадиола | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03277356190 | **Prolactin II CalSet**<br>Калибратор для пролактина | 2 x 2 x 1 мл | |
| 07092547190 | **Progesterone III CalSet**<br>Калибратор для прогестерона | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05202230190 | **Testosterone II CalSet II**<br>Калибратор для тестостерона | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03052028190 | **SHBG CalSet**<br>Калибратор для глобулина связывающего половые гормоны (ГСПГ) | 2 x 2 x 1 мл | |

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 07957211190 | **PreciControl AMH Plus**<br>Контрольная сыворотка для антимюллерова гормона (АМГ) | 2 x 2 x 2 мл | |
| 11731416190 | **Precicontrol Universal**<br>Универсальная контрольная сыворотка | 2 x 2 x 3 мл | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

### Диагностика и мониторинг беременности

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03300811190 | **HCG Stat**<br>Хорионический гонадотропин (ХГЧ) экспресс-метод | 100 тестов | 0,5-10 000 мМЕ/мл<br>9 минут<br>Нельзя использовать на анализаторе MODULAR E170! |
| 03271749190 | **HCG+β**<br>Суммарный хорионический гонадотропин (ХГЧ + β-ХГЧ) | 100 тестов | 0,1-10 000 мМЕ/мл |
| 04481798190 | **AFP**<br>Альфа- фетопротеин (АФП) | 100 тестов | 0,5-1000 МЕ/мл |
| 04491742190 | **AFP**<br>Альфа- фетопротеин (АФП) | 200 тестов | 0,5-1000 МЕ/мл<br>Для анализаторов cobas e 601 / 602 и MODULAR E170 |
| 04854071200 | **Free βHCG**<br>Свободный β-хорионический гонадотропин | 100 тестов | 0,1-190 МЕ/л<br>пренатальный скрининг I триместра |
| 04854098200 | **PAPP-A**<br>Ассоциированный с беременностью плазменный протеин А (PAPP-A) | 100 тестов | 4-10000 мМЕ/л<br>пренатальный скрининг I триместра |
| 05109523190 | **sFlt-1**<br>Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 100 тестов | 10-85 000 пг/мл<br>Диагностика и прогнозирование развития преэклампсии – тест используется в паре с PlGF Elecsys (арт.№05144671190) |
| 05144671190 | **PlGF**<br>Плацентарный фактор роста (PlGF) | 100 тестов | 3-10 000 пг/мл<br>Расчет риска развития преэклампсии в I триместре. Диагностика и прогнозирование развития преэклампсии – тест используется в паре с sFlt-1 Elecsys (арт.№05109523190) |

### Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03303071190 | **HCG Stat CalSet**<br>Калибратор для хорионического гонадотропина (ХГЧ) экспресс-метод | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03302652190 | **HCG+b CalSet**<br>Калибратор для суммарного хорионического гонадотропина (ХГЧ + β-ХГЧ) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 04487761190 | **AFP CalSet**<br>Калибратор для альфа-фетопротеина (АФП) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 04854080200 | **Free βHCG CalSet**<br>Калибратор для свободного β-хорионического гонадотропина | 2 x 2 x 1 мл | |
| 04854101200 | **PAPP-A CalSet**<br>Калибратор для ассоциированного с беременностью плазменного протеина А (PAPP-A) | 2 x 2 x 1 мл | |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05109531190 | **sFlt-1 CalSet**<br>Калибратор для растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt-1) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05144701190 | **PlGF CalSet**<br>Калибратор для определения плацентарного фактора роста (PlGF) | 2 x 2 x 1 мл | |

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11731416190 | **Precicontrol Universal**<br>Универсальная контрольная сыворотка (HCG Stat, HCG+b, AFP) | 2 x 2 x 3 мл | |
| 11776452122 | **Precicontrol Tumormarker**<br>Контрольная сыворотка для онкомаркеров (HCG+b, AFP) | 2 x 2 x 3 мл | |
| 04899881200 | **PreciControl Maternal Care**<br>Контрольная сыворотка для маркеров материнского скрининга (free b-HCG и PAPP-A) | 3 x 2 x 2 мл | |
| 05341787190 | **PreciControl MultiMarker**<br>Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt-1), плацентарного фактора роста (PlGF), АКТГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина | 2 x 3 x 2 мл | |

### Программа расчета риска синдрома Дауна у плода

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05126193001 | **SSdwLab Software (single-userlicense)**<br>Программа для расчета риска синдрома Дауна у плода, монолицензионная | 1 шт. | |

### Диагностика нарушений роста

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05390125190 | **hGH**<br>Гормон роста человека | 100 тестов | 0,030-50,0 нг/мл |

### Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05390133190 | **hGH CalSet**<br>Калибратор для гормона роста человека | 2 x 2 x 1 мл | |

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05341787190 | **PreciControl MultiMarker**<br>Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt 1), плацентарного фактора роста (PlGF), АКТГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина | 2 x 3 x 2 мл | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

### Диагностика нарушений эндокринной функции поджелудочной железы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 12017547122 | **Insulin**<br>Инсулин | 100 тестов | 0,2–1000 мкМЕ/мл |
| 03184897190 | **C-peptide**<br>С-пептид | 100 тестов | 0,01–40 нг/мл |

### Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 12017504122 | **Insulin CalSet**<br>Калибратор для инсулина | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03184919190 | **C-peptide CalSet**<br>Калибратор для С-пептида | 2 x 2 x 1 мл | |

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05341787190 | **PreciControl MultiMarker**<br>Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt 1), плацентарного фактора роста (PlGF), АКТГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина | 2 x 3 x 2 мл | |

### Диагностика нарушений эндокринной функции надпочечников

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 06687733190 | **Cortisol II**<br>Кортизол (для слюны, сыворотки и плазмы крови) | 100 тестов | 1,5–1750 нмоль/л |
| 11875116122 | **Cortisol**<br>Кортизол (для мочи, слюны, сыворотки и плазмы крови) | 100 тестов | 0,5–1750 нмоль/л |
| 03000087122 | **DHEAs**<br>Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАс) | 100 тестов | 0,003–27 мкмоль/л |
| 03255751190 | **ACTH**<br>Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 100 тестов | 0,220–440 пмоль/л |

### Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 06687750190 | **Cortisol II CalSet**<br>Калибратор для кортизола (для аппликаций слюны, сыворотки и плазмы крови) | 2 x 2 x 1 мл | Совместим с реагентом Cortisol II Elecsys<br>Кортизол (для аппликаций слюны, сыворотки и плазмы крови), арт№ 06687733190 |
| 11875124122 | **Cortisol CalSet**<br>Калибратор для кортизола (для аппликаций мочи, слюны, сыворотки и плазмы крови) | 2 x 2 x 1 мл | Совместим с реагентом Cortisol Elecsys<br>Кортизол (для аппликаций мочи, слюны, сыворотки и плазмы крови), арт№ 11875116122 |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03000095122 | **DHEAs CalSet**<br>Калибратор для Дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭАс) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03255760190 | **ACTH CalSet**<br>Калибратор для адренокортикотропного гормона (АКТГ) | 2 x 2 x 1 мл | |

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11731416190 | **Precicontrol Universal**<br>Универсальная контрольная сыворотка | 2 x 2 x 3 мл | |
| 05341787190 | **PreciControl MultiMarker**<br>Контрольная сыворотка для: растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt 1), плацентарного фактора роста (PlGF), АКТГ, ИЛ-6, ХГЧ, С-пептида, инсулина | 2 x 3 x 2 мл | |

### Диагностика онкологических заболеваний

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03271749190 | **HCG+β**<br>Суммарный хорионический гонадотропин (ХГЧ + β-ХГЧ) | 100 тестов | 0,1-10 000 мМЕ/мл |
| 04481798190 | **AFP**<br>Альфа- фетопротеин (АФП) | 100 тестов | 0,5-1000 МЕ/мл |
| 04491742190 | **AFP**<br>Альфа- фетопротеин (АФП) | 200 тестов | 0,5-1000 МЕ/мл<br>Для анализаторов cobas e 601 / 602 и MODULAR E170 |
| 11731629322 | **CEA**<br>Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 100 тестов | 0,2-1000 нг/мл |
| 04491777190 | **CEA**<br>Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 200 тестов | 0,2-1000 нг/мл<br>Для анализаторов cobas e 601 / 602 и MODULAR E170 |
| 04641655190 | **Total PSA**<br>Общий простато-специфический антиген (ПСА) | 100 тестов | 0,003-100 нг/мл |
| 04491734190 | **Total PSA**<br>Общий простато-специфический антиген (ПСА) | 200 тестов | 0,003-100 нг/мл<br>Для анализаторов cobas e 601 / 602 и MODULAR E170 |
| 03289788190 | **Free PSA**<br>Свободный простато-специфический антиген (ПСА) | 100 тестов | 0,01-50 нг/мл |
| 11776223190 | **CA 125 II**<br>Онкомаркер CA 125 | 100 тестов | 0,6-5000 МЕ/мл |
| 05950929190 | **HE4**<br>Онкомаркер HE4 | 100 тестов | 15,0-1500 пмоль/л |
| 11776193122 | **CA 19-9**<br>Онкомаркер CA 19-9 | 100 тестов | 0,6-1000 МЕ/мл |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03045838122 | **CA 15-3 II**<br>Онкомаркер CA 15-3 | 100 тестов | 1-300 МЕ/мл<br>Дополнительно требуется дилюент № 03183971122 (1 уп. на 3 набора) |
| 11820966122 | **CYFRA 21-1**<br>Онкомаркер Cyfra 21-1 | 100 тестов | 0,1-500 нг/мл |
| 03737551190 | **Ferritin**<br>Ферритин | 100 тестов | 0,5-2000 нг/мл |
| 04491785190 | **Ferritin**<br>Ферритин | 200 тестов | 0,5-2000 нг/мл |
| 11776258122 | **CA 72-4**<br>Онкомаркер CA 72-4 | 100 тестов | 0,2-300 МЕ/мл |
| 12133113122 | **NSE**<br>Онкомаркер нейроспецифическая энолаза (NSE) | 100 тестов | 0,05-370 нг/мл |
| 03175243190 | **S100**<br>Онкомаркер S100 | 100 тестов | 0,005-39 мкг/л |
| 06445853190 | **Calcitonin**<br>Кальцитонин | 100 тестов | 0,5-2000 пг/мл |
| 06445896190 | **Tg II**<br>Тиреоглобулин (ТГ) | 100 тестов | 0,04-500 нг/мл |
| 06513107190 | **Tg II Confirmatory Test**<br>ТГ подтверждающий | 50 тестов | 0,1-1000 мкг/л |
| 06505961190 | **ProGRP**<br>Прогастрин рилизинг пептид | 100 тестов | 3.00-5000 пг/мл |

### Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03302652190 | **HCG+b CalSet**<br>Калибратор для суммарного хорионического гонадотропина (ХГЧ + β-ХГЧ) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 04487761190 | **AFP CalSet**<br>Калибратор для альфа- фетопротеина (АФП) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 11731645322 | **CEA CalSet**<br>Калибратор для раково-эмбрионального антигена (РЭА) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 04485220190 | **Total PSA CalSet**<br>Калибратор для общего простато-специфического антигена (ПСА) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03289796190 | **Free PSA CalSet**<br>Калибратор для свободного простато-специфического антиген (ПСА) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 07030207190 | **CA 125 II CalSet**<br>Калибратор для онкомаркера CA 125 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05950945190 | **HE4 CalSet**<br>Калибратор для онкомаркера HE4 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 11776215122 | **CA 19-9 CalSet**<br>Калибратор для онкомаркера CA 19-9 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03045846122 | **CA 15-3 II CalSet**<br>Калибратор для онкомаркера CA 15-3 | 2 x 2 x 1 мл | |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11820974322 | **CYFRA 21-1 CalSet**<br>Калибратор для онкомаркера Cyfra 21-1 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03737586190 | **Ferritin CalSet**<br>Калибратор для ферритина | 2 x 2 x 1 мл | |
| 11776274122 | **CA 72-4 CalSet**<br>Калибратор для онкомаркера CA 72-4 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 12133121122 | **NSE CalSet**<br>Калибратор для онкомаркера нейроспецифической энолазы (NSE) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03289834190 | **S100 CalSet**<br>Калибратор для онкомаркера S100 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 06445861190 | **Calcitonin CalSet**<br>Калибратор для кальцитонина | 2 x 2 x 1 мл | |
| 06445900190 | **Tg II CalSet**<br>Калибратор для тиреоглобулина | 2 x 2 x 1 мл | |
| 06505970190 | **ProGRP CalSet**<br>Калибратор для прогастрин рилизинг пептида | 2 x 2 x 1 мл | |

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11776452122 | **Precicontrol Tumormarker**<br>Контрольная сыворотка для определения онкомаркеров | 2 x 2 x 3 мл | |
| 11731416190 | **Precicontrol Universal**<br>Универсальная контрольная сыворотка (включены онкомаркеры: HCG+b, CEA, AFP, Total PSA, Tg, S100) | 2 x 2 x 3 мл | |
| 05950953190 | **PreciControl HE4**<br>Контрольная сыворотка для онкомаркера HE4 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05618860190 | **PreciControl Varia**<br>Контрольная сыворотка Вариа для кальцитонина | 2 x 2 x 3 мл | |
| 06505988190 | **PreciControl ProGRP**<br>Контрольная сыворотка для прогастрин рилизинг пептида | 2 x 2 x 1 мл | |

### Диагностика инфекционных заболеваний

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04687787190 | **HBsAG II***<br>Поверхностный антиген гепатита B (HBsAg) | 100 тестов | Качественный тест |
| 07914482190 | **HBsAg II***<br>Поверхностный антиген гепатита B (HBsAg) | 200 тестов | Качественный тест |
| 11820648122 | **HBsAg confirmatory test**<br>Подтверждение присутствия поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) | 20 тестов | Качественный тест |
| 05894816190 | **Anti-HBs II***<br>Антитела к поверхностному антигену гепатита B (HBsAg) | 100 тестов | 2.00-1000 МЕ/л |
| 06771823190 | **Anti-HBs II***<br>Антитела к поверхностному антигену гепатита B (HBsAg) | 200 тестов | 2,0-1000 МЕ/л |
| 07374160190 | **Anti-HBc II***<br>Антитела IgM и IgG к ядерному антигену вируса гепатита B (Anti-HBc) | 100 тестов | Качественный тест |
| 07394764190 | **Anti-HBc II***<br>Антитела IgM и IgG к ядерному антигену вируса гепатита B (Anti-HBc) | 200 тестов | Качественный тест |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11820613122 | **Anti-HBe*** Антитела к антигену гепатита B (HBeAg) | 100 тестов | Качественный тест |
| 11820583122 | **HBeAg*** Поверхностный антиген гепатита B (HBeAg) | 100 тестов | Качественный тест |
| 11820567122 | **Anti-HBc IgM*** Антитела к ядерному антигену вирусу гепатита B IgM | 100 тестов | Качественный тест Дополнительно требуется дилюент №11732277122 или № 03183971122 |
| 11820591122 | **Anti-HAV IgM*** Антитела класса IgM к вирусу гепатита A (Anti-HAV IgM) | 100 тестов | Качественный тест Дополнительно требуется дилюент №11732277122 или № 03183971122 |
| 04854977190 | **Anti-HAV*** Общие антитела к вирусу гепатита A (Anti-HAV) | 100 тестов | 3,0-60 МЕ/л |
| 06368921190 | **Anti-HCV* II** Антитела к вирусу гепатита C (HCV) | 100 тестов | Качественный тест |
| 06427405190 | **Anti-HCV* II** Антитела к вирусу гепатита C (HCV) | 200 тестов | Качественный тест |
| 11971611122 | **HIV Ag*** Антиген p24 вируса иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ1, группы M и O) | 100 тестов | Качественный тест |
| 12001101122 | **HIV Ag Confirmatory Test** Подтверждение по ВИЧ-1 p24-антигену | 2 x 20 тестов | Качественный тест |
| 05390095190 | **HIV Combi PT* (включая группу O)** Скрининг на антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 p24-антигену (с предварительной обработкой образца) | 100 тестов | Качественный тест |
| 07914504190 | **HIV combi PT* (включая группу O)** Скрининг на антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 p24-антигену (с предварительной обработкой образца) | 200 тестов | Качественный тест |
| 04618793190 | **Rubella IgG*** IgG-антитела к вирусу краснухи | 100 тестов | 0,17-500 МЕ/мл |
| 04618831190 | **Rubella IgM*** IgM-антитела к вирусу краснухи | 100 тестов | Качественный тест Дополнительно требуется дилюент № 03183971122, 1 уп. на 3 набора |
| 04618815190 | **Toxo IgG*** IgG-антитела к токсоплазме | 100 тестов | 0,13-650 МЕ/мл |
| 04618858190 | **Toxo IgM*** IgM-антитела к токсоплазме | 100 тестов | Качественный тест Дополнительно требуется дилюент № 03183971122, 1 уп. на 3 набора |
| 05802571190 | **Toxo IgG Avidity*** Авидность Toxo IgG-антител | 100 тестов | Качественный тест 100 тестов соответствует 50 исследованиям для определения авидности IgG-антител к токсоплазме |
| 04784596190 | **CMV IgG*** IgG- антитела к цитомегаловирусу | 100 тестов | 0,25-500 МЕ/мл |
| 04784618190 | **CMV IgM*** IgM- антитела к цитомегаловирусу | 100 тестов | Качественный тест Дополнительно требуется дилюент № 03183971122, 1 уп. на 3 набора |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05909708190 | **CMV IgG* Avidity**<br>Авидность IgG-антител к ЦМВ | 100 тестов | Качественный тест<br>100 тестов соответствует 50 исследованиям для определения авидности IgG-антител к ЦМВ |
| 05572185190 | **HSV-1 IgG***<br>IgG-антитела к ВПГ 1-го типа | 100 тестов | Качественный тест |
| 05572193190 | **HSV-2 IgG***<br>IgG-антитела к ВПГ 2-го типа | 100 тестов | Качественный тест |
| 06923348190 | **Syphilis***<br>Суммарные антитела к Treponema pallidum | 100 тестов | Качественный тест |
| * Калибраторы входят в состав набора. | | | |

**Контрольные материалы**

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04687876190 | **PreciControl HBsAg II**<br>Контрольная сыворотка для HBsAg II | 2 x 8 x 1,3 мл | |
| 11876317122 | **Precicontrol anti-HBs**<br>Контрольная сыворотка для anti-HBs | 2 x 8 x 1,3 мл | |
| 04927931190 | **Precicontrol anti-HBc**<br>Контрольная сыворотка для anti-HBc | 2 x 8 x 1,3 мл | |
| 11876333122 | **Precicontrol anti-HBc IgM**<br>Контрольная сыворотка для anti-HBc IgM | 2 x 8 x 1 мл | |
| 11876376122 | **Precicontrol HBeAg**<br>Контрольная сыворотка для HBeAg | 2 x 8 x 1,3 мл | |
| 11876384122 | **Precicontrol Anti-Hbe**<br>Контрольная сыворотка для anti-HBe | 2 x 8 x 1,3 мл | |
| 11876368122 | **Precicontrol anti-HAV IgM**<br>Контрольная сыворотка для anti-HAV IgM | 2 x 8 x 0,67 мл | |
| 04855043190 | **Precicontrol anti-HAV**<br>Контрольная сыворотка по anti-HAV | 2 x 2 x 4 мл | |
| 03290379190 | **PreciControl Anti-HCV**<br>Контрольная сыворотка по anti-HCV | 2 x 8 x 1,3 мл | |
| 05162645190 | **PreciControl HIV**<br>Контрольная сыворотка для ВИЧ (при использовании тест-систем «HIV Combi», «HIV Combi PT», «HIV Ag») | 3 x 2 x 2 мл | Контрольная сыворотка только для ВИЧ HIV combi PT* (арт. № 05390095190) |
| 06924107190 | **PreciControl HIV Gen II**<br>Контрольная сыворотка для ВИЧ (при использовании тест-систем «HIV Combi», «HIV Combi PT», «HIV Ag») | 3 x 2 x 2 мл | |
| 04618807190 | **PreciControl Rubella IgG**<br>Контрольная сыворотка для Rubella IgG | 2 x 8 x 1 мл | |
| 04618840190 | **PreciControl Rubella IgM**<br>Контрольная сыворотка для Rubella IgM | 2 x 4 x 1 мл | |
| 04618823190 | **PreciControl Toxo IgG**<br>Контрольная сыворотка для Toxo IgG | 2 x 8 x 1 мл | |
| 04618866190 | **PreciControl Toxo IgM**<br>Контрольная сыворотка для Toxo IgM | 2 x 8 x 0,67 мл | |
| 05802580190 | **PreciControl Toxo IgG Avidity**<br>Контрольная сыворотка для определения авидности Toxo IgG-антител | 2 x 3 x 2 мл | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04784600190 | **PreciControl CMV IgG**<br>Контрольная сыворотка для определения антител класса IgG к цитомегаловирусу | 2 x 8 x 1 мл | |
| 04784626190 | **PreciControl CMV IgM**<br>Контрольная сыворотка для определения антител класса IgM к цитомегаловирусу | 2 x 8 x 1 мл | |
| 05942322190 | **PreciControl CMV IgG Avidity**<br>Контрольная сыворотка для определения авидности IgG- антител к ЦМВ | 2 x 3 x 1 мл | |
| 05572207190 | **PreciControl HSV**<br>Контрольная сыворотка для определения IgG-антител к ВПГ 1-го и 2-го типов | 2 x 2 x 3 мл | |
| 06923364190 | **PreciControl Syphilis**<br>Контрольная сыворотка для суммарных антител к Treponema pallidum | 2 x 2 x 2 мл | |

### Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05092728190 | **Troponin T hs STAT**<br>Тропонин Т высокочувствительный экспресс-метод | 100 тестов | 3-10000 нг/л<br>9 минут<br>Нельзя использовать на анализаторе MODULAR E170! |
| 05092744190 | **Troponin T hs**<br>Тропонин Т высокочувствительный метод | 200 тестов | 3-10000 нг/л<br>18 минут |
| 05094810190 | **Troponin I**<br>Тропонин I | 100 тестов | 0,16-25,00 нг/мл<br>Только для анализаторов MODULAR E170 и cobas e 601/602! |
| 05094798190 | **Troponin I STAT**<br>Тропонин I экспресс-метод | 100 тестов | 0,16-25 нг/мл<br>9 минут<br>Нельзя использовать на анализаторе MODULAR E170! |
| 05957648190 | **CK-MB STAT**<br>MB-изоэнзим креатинкиназы (CK-MB) экспресс-метод | 100 тестов | 0,3-300 нг/мл<br>9 минут<br>Нельзя использовать на анализаторе MODULAR E170! |
| 05894808190 | **CK-MB**<br>MB-изоэнзим креатинкиназы (CK-MB) | 100 тестов | 0,3-300 нг/мл<br>18 минут |
| 011820788122 | **Myoglobin STAT**<br>Миоглобин<br>экспресс-метод | 100 тестов | 21-3000 нг/мл<br>9 минут<br>Нельзя использовать на MODULAR E170! |
| 12178214122 | **Myoglobin**<br>Миоглобин | 100 тестов | 21-3000 нг/мл<br>18 минут |
| 04842464190 | **proBNP II**<br>N-концевой пронатрийуретический пептид B-типа (NT-proB- NP) | 100 тестов | 0,6-4130 пкмоль/л |
| 11820796190 | **Digoxin**<br>Дигоксин | 100 тестов | 0,15-5,0 нг/мл |
| 03002659122 | **Digitoxin**<br>Дигитоксин | 100 тестов | 2,62-105 нмоль/л |

## Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05092736190 | **Troponin T hs STAT CalSet**<br>Калибратор для тропонина Т высокочувствительного STAT | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05092752190 | **Troponin T hs CalSet**<br>Калибратор для тропонина Т высокочувствительного | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05094828190 | **Troponin I CalSet**<br>Калибратор для тропонина I | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05094801190 | **Troponin I STAT CalSet**<br>Калибратор для тропонина I STAT | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05957656190 | **CK-MB (STAT) CalSet**<br>Калибратор для MB-изоэнзим креатинкиназы (CK-MB) STAT | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05957664190 | **CK-MB CalSet**<br>Калибратор для MB-изоэнзим креатинкиназы (CK-MB) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 11820893122 | **Myoglobin (STAT) CalSet**<br>Калибратор для миоглобина STAT | 2 x 2 x 1 мл | |
| 12178222122 | **Myoglobin CalSet**<br>Калибратор для миоглобина | 2 x 2 x 1 мл | |
| 04842472190 | **proBNP II CalSet**<br>Калибратор для N-концевого пронатрийуретического пептида B-типа (NT-proB- NP) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 11820907322 | **Digoxin CalSet**<br>Калибратор для дигоксина | 2 x 2 x 1,5 мл | |
| 03002667122 | **Digitoxin CalSet**<br>Калибратор для дигитоксина | 2 x 2 x 1 мл | |

## Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04917049190 | **Precicontrol Cardiac**<br>Контрольная сыворотка для CK-MB, миоглобина, дигоксина, дигитоксина, NT-proB- NP | 2 x 2 x 2 мл | |
| 05095107190 | **PreciControl Troponin**<br>Контрольная сыворотка для тропонина Т высокочувствительного (экспресс-метод - 9 минут и 18 минут) и тропонина I | 2 x 2 x 2 мл | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

### Диагностика анемий

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 07212771190 | **B12**<br>Витамин B12 | 100 тестов | 36,9-1476 пмоль/л |
| 07559992190 | **Folate III**<br>Фолиевая кислота | 100 тестов | 1,45-45,4 нмоль/л |
| 05944295190 | **Folate RBC**<br>Фолиевая кислота в эритроцитах | 100 тестов | 272-1407 нмоль/л |
| 05944317190 | **Folate RBC Hemolyzing reagents**<br>Набор реагентов, гемолизирующих эритроциты | 4 x 200 мл | |
| 03737551190 | **Ferritin**<br>Ферритин | 100 тестов | 0,5-2000 нг/мл |
| 04491785190 | **Ferritin**<br>Ферритин | 200 тестов | 0,5-2000 нг/мл |

### Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 07212780190 | **B12 CalSet**<br>Калибратор для витамина B12 | 2 x 2 x 1 мл | |
| 07560001190 | **Folate III CalSet**<br>Калибратор для фолиевой кислоты | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03737586190 | **Ferritin CalSet**<br>Калибратор для ферритина | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05944309190 | **Folate RBC CalSet**<br>Калибратор для фолиевой кислоты в эритро-цитах | 2 x 2 x 1 мл | |

### Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05618860190 | **PreciControl Varia**<br>Контрольная сыворотка Вариа для: витамина B12, ферритина, фолатов, β-CrossLaps, остео-кальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина Д | 2 x 2 x 3 мл | |

### Диагностика аллергических состояний

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04827031190 | **IgE II**<br>Иммуноглобулин E (IgE) | 100 тестов | 0,1-2500 МЕ/мл |

### Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11930427122 | **IgE CalSet**<br>Калибратор для иммуноглобулина E (IgE) | 2 x 2 x 1 мл | |

## Контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11731416190 | **Precicontrol Universal**<br>Универсальная контрольная сыворотка | 2 x 2 x 3 мл | |

## Маркеры костного обмена

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 12149133122 | **N-MID Osteocalcin**<br>N-MID Остеокальцин | 100 тестов | 0,5-300 нг/мл |
| 11972103122 | **PTH**<br>Паратгормон (18 минут) | 100 тестов | 0,127-530 пмоль/л |
| 04892470190 | **PTH STAT**<br>Паратгормон экспресс-метод (9 минут) | 100 тестов | 0,127-530 пмоль/л<br>Не для Modular e170 |
| 05608546190 | **PTH (1-84)**<br>Паратгормон 1-84 (18 минут) | 100 тестов | 0,583-244 пмоль/л |
| 11972308122 | **b-CrossLaps/Serum**<br>b-CrossLaps в сыворотке крови (С концевой телопептид коллагена I типа) | 100 тестов | 0,01-6,0 нг/мл |
| 03141071190 | **Total P1NP**<br>Общий P1NP (N-терминальный пропептид коллагена I типа) | 100 тестов | 5-1200 мкг/л |
| 05894913190 | **Vitamin D Total**<br>Общий Витамин Д | 100 тестов | 3,00-70,0 нг/мл<br>или 7,50-175 нмоль/л |

## Калибраторы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11972111122 | **N-MID Osteocalcin CalSet**<br>Калибратор для N-MID остеокальцина | 2 x 2 x 1 мл | |
| 11972219122 | **PTH CalSet**<br>Калибратор для паратгормона (18 минут) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 04894138190 | **PTH STAT CalSet**<br>Калибратор для паратгормона экспресс-метод (9 минут) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05608554190 | **PTH (1-84) CalSet**<br>Калибратор для паратгормона (1-84) | 2 x 2 x 1 мл | |
| 11972316122 | **b-CrossLaps CalSet**<br>Калибратор для b-CrossLaps | 2 x 2 x 1 мл | |
| 03141080190 | **Total P1NP CalSet**<br>Калибратор для общего P1NP | 2 x 2 x 1 мл | |
| 05894921190 | **Vitamin D Total CalSet**<br>Калибратор для количественного общего витамина Д | 2 x 2 x 1 мл | |

# Сывороточная рабочая зона

## Реагенты и расходные материалы для иммунохимического модуля cobas e601/602, Modular Analytics EVO <E170>, cobas e 411

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание<br>Кол-во тестов** |
|---|---|---|---|
| 11776576322 | **CalSet Vials Elecsys**<br>Набор флаконов для аликвотирования разведенных калибраторов | 2 x 56 шт. | |
| 11930346122 | **Sys Wash Elecsys**<br>Моющий раствор для добавления в дистиллированную воду | 500 мл | 3300 тестов |
| 10394246001 | **SAMPLE CUPS (5000 pc/pack)**<br>Пробирки для образцов (5000 шт. / уп.) | 5000 шт. | |
| 11933159001 | **SysClean-Adapter**<br>Адаптер для промывки | 1 шт. | |

### Расходные материалы для анализаторов cobas e601/602, Modular E170

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание<br>Кол-во тестов** |
|---|---|---|---|
| 03004899190 | **PreClean M**<br>Буфер для предварительной промывки M | 5 x 600 мл | 3000-4000 тестов |
| 03005712190 | **ProbeWash M**<br>Буфер для промывки пробозаборника | 12 x 70 мл | 2 уп/год<br>12 уп/год если есть инф. маркеры |
| 04880340190 | **Procell M**<br>Субстрат-реагент Procell M | 2 бут. x 2 л | 1300-1500 тестов + 10 шт на ежегодное обслуживание |
| 04880293190 | **Cleancell M**<br>Промывающий буфер Cleancell M для платформы MODULAR и cobas 6000 | 2 бут. x 2 л | 1300-1500 тестов + 10 шт на ежегодное обслуживание |
| 12102137001 | **AssayCups/Tips Combi M**<br>Комплект аналитических пробирок и одноразовых наконечников | 1 уп. | 3600-4000 тестов |
| 11729306122 | **BlankCell Elecsys**<br>Реагент для проведения фоновой пробы | 2 x 50 мл | |
| 05151643001 | **Measuring Cell with reference electrode**<br>Измерительная ячейка с референсным электродом | 1 шт. | ~2 шт/год |
| 03023141001 | **PC/CC-Cups**<br>Флаконы для Procell и Cleancell | 1 уп. x 12 шт. | 4 шт/год |
| 03027651001 | **SysClean-Adapter M**<br>Адаптер для промывки ячейки | 1 шт. | 2 шт/год |
| 10394246001 | **SAMPLE CUPS**<br>Пробирки для образцов | 5000 шт./уп. | |

** Ориентировочный расход при средней загруженности прибора.

## Универсальные контроли

## Индивидуальные контроли

| | PreciControl Universal | PreciControl Thyro AB | PreciControl Tumor Marker | PreciControl Varia | PreciControl Maternal Care | PreciControl MultiMarker | PreciControl Troponin | PreciControl Cardiac | PreciControl Thyro Sensitive | PreciControl HE4 | PreciControl Anti-CCP | PreciControl AMH Plus | PreciControl ProGRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Диагностика нарушений функции щитовидной железы** | | | | | | | | | | | | | |
| TSH | • | | | | | | | | • | | | | |
| T3 | • | | | | | | | | | | | | |
| FT3 | • | | | | | | | | | | | | |
| T4 | • | | | | | | | | | | | | |
| FT4 | • | | | | | | | | | | | | |
| T-Uptake | • | | | | | | | | | | | | |
| Tg | • | | • | | | | | | • | | | | |
| Anti-TPO | | • | | | | | | | | | | | |
| Anti-TG | | • | | | | | | | | | | | |
| Anti-TSHR | | • | | | | | | | | | | | |
| **Диагностика нарушений функции паращитовидной железы** | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | | | | • | | | | | | | | | |
| PTH STAT | | | | • | | | | | | | | | |
| PTH 1-84 | | | | • | | | | | | | | | |
| **Диагностика эндокринных нарушений репродуктивной функции** | | | | | | | | | | | | | |
| AMH | | | | | | | | | | | | • | |
| LH | • | | | | | | | | | | | | |
| FSH | • | | | | | | | | | | | | |
| Estradiol III | • | | | | | | | | | | | | |
| Prolactin II | • | | | | | | | | | | | | |
| Progesterone III | • | | | | | | | | | | | | |
| Testosterone II | • | | | | | | | | | | | | |
| SHBG | • | | | | | | | | | | | | |

# Сывороточная рабочая зона

| | Универсальные контроли | | | | | | | | | Индивидуальные контроли | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PreciControl Universal | PreciControl Thyro AB | PreciControl Tumor Marker | PreciControl Varia | PreciControl Maternal Care | PreciControl MultiMarker | PreciControl Troponin | PreciControl Cardiac | PreciControl Thyro Sensitive | PreciControl HE4 | PreciControl Anti-CCP | PreciControl AMH Plus | PreciControl ProGRP |
| **Диагностика и мониторинг беременности** | | | | | | | | | | | | | |
| HCG STAT | • | | | | | | | | | | | | |
| Free b-HCG | | | | | • | | | | | | | | |
| PAPP-A | | | | | • | | | | | | | | |
| sFlt-1 | | | | | | • | | | | | | | |
| PIGF | | | | | | • | | | | | | | |
| **Диагностика нарушений роста** | | | | | | | | | | | | | |
| hGH | | | | | | • | | | | | | | |
| **Диагностика нарушений эндокринной функции поджелудочной железы** | | | | | | | | | | | | | |
| Insulin | • | | | | | • | | | | | | | |
| C-peptide | | | | | | • | | | | | | | |
| **Диагностика нарушений эндокринной функции надпочечников** | | | | | | | | | | | | | |
| Cortisol | • | | | | | | | | | | | | |
| DHEA | • | | | | | | | | | | | | |
| ACTH | | | | | | • | | | | | | | |
| **Онкомаркеры** | | | | | | | | | | | | | |
| HCG+b | • | | • | | | | | | | | | | |
| AFP | • | | • | | | | | | | | | | |
| CEA | • | | • | | | | | | | | | | |
| Total PSA | • | | • | | | | | | | | | | |
| Free PSA | | | • | | | | | | | | | | |
| CA 125 | | | • | | | | | | | | | | |
| HE4 | | | | | | | | | | • | | | |
| CA 19-9 | | | • | | | | | | | | | | |
| CA 15-3 | | | • | | | | | | | | | | |
| CYFRA 21-1 | | | • | | | | | | | | | | |
| Ferritin | | | • | • | | | | | | | | | |
| CA 72-4 | | | • | | | | | | | | | | |
| NSE | | | • | | | | | | | | | | |
| S100 | • | | | | | | | | | | | | |
| Calcitonin | | | | • | | | | | | | | | |
| proGRP | | | | • | | | | | | | | | • |

## Универсальные контроли

## Индивидуальные контроли

| | PreciControl Universal | PreciControl Thyro AB | PreciControl Tumor Marker | PreciControl Varia | PreciControl Maternal Care | PreciControl MultiMarker | PreciControl Troponin | PreciControl Cardiac | PreciControl Thyro Sensitive | PreciControl HE4 | PreciControl Anti-CCP | PreciControl AMH Plus | PreciControl ProGRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Диагностика сердечно-сосудистой патологии** | | | | | | | | | | | | | |
| Troponin I | | | | | | | • | | | | | | |
| Troponin T hs | | | | | | | • | | | | | | |
| CK-MB | | | | | | | | • | | | | | |
| Myo | | | | | | | | • | | | | | |
| proBNP | | | | | | | | • | | | | | |
| Digoxin | | | | | | | | • | | | | | |
| Digitoxin | | | | | | | | • | | | | | |
| **Диагностика анемий** | | | | | | | | | | | | | |
| B12 | | | | • | | | | | | | | | |
| Folate | | | | • | | | | | | | | | |
| **Диагностика аллергических состояний** | | | | | | | | | | | | | |
| IgE | • | | | | | | | | | | | | |
| **Маркеры костного обмена** | | | | | | | | | | | | | |
| N-MID | | | | • | | | | | | | | | |
| b-CrossLaps | | | | • | | | | | | | | | |
| Total P1NP | | | | • | | | | | | | | | |
| Vitamin D | | | | • | | | | | | | | | |
| **Диагностика ревматоидного артрита** | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-CCP | | | | | | | | | | | • | | |
| **Диагностика сепсиса** | | | | | | | | | | | | | |
| IL-6 | | | | | | • | | | | | | | |

# Сывороточная рабочая зона

## Индивидуальные контроли

| | PreciControl Anti-HAV | PreciControl Anti-HAV IgM | PreciControl Anti-HBc | PreciControl Anti-HBc IgM | PreciControl Anti-Hbe | PreciControl Anti-Hbs | PreciControl Anti-HCV | PreciControl CMV IgG | PreciControl CMV IgG Avidity | PreciControl CMV IgM | PreciControl HBeAg | PreciControl HBsAg | PreciControl HIV | PreciControl HSV | PreciControl Rubella IgG | PreciControl Rubella IgM | PreciControl Toxo IgG | PreciControl Toxo IgG Avidity | PreciControl Toxo IgM | PreciControl Syphilis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-HAV | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-HAV IgM | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-HBc | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-HBc IgM | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-Hbe | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-HBs | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| Anti-HCV II | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| CMV IgG | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| CMV IgG Avidity | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| CMV IgM | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| HBeAg | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| HBsAg | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| HIV Ag | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| HIV Combi | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| HSV-1 IgG | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| HSV-2 IgG | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| Rubella IgG | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| Rubella IgM | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| Toxo IgG | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | |
| Toxo IgG Avidity | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Toxo IgM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| Syphilis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |

# Расходные материалы для преаналитических систем

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04453999001 | **BC label 50x18mm (4x7500 pcs)**<br>Этикетки штрих-кода, 50x18мм | 4 x 7500 шт. | |
| 04454111001 | **Ribbon tape 50x18mm (2x360m)**<br>Лента красящая для принтера штрих-кода, 50x18мм | 2 x 360м | Расход 20 мм на 1 аликвоту |
| 04976274001 | **Disposable tips non-conductive 1000 ul, 10x960 pcs, in racks**<br>Наконечники одноразовые непроводящие, 1000 мкл, в лотках | 10 x 960 шт. | |
| 08785147001 | **ep Dualfilter TIPS, 50-1000ul, 10x96**<br>Изделия Eppendorf из полимерных материалов для лабораторных исследований in vitro: наконечники с фильтрами epDualfilter T.I.P.S. для дозаторов объемом от 50 мкл до 1000 мкл, в боксах, стерильные (epDualfilter T.I.P.S.), 10X96 шт | 960 шт. | |
| 04453859001 | **Sealing foil d=21 for Recapper (4500pcs)**<br>Фольга алюминиевая для запечатывания, d=21мм | 9 x 500 шт. | |

** Ориентировочный расход при средней загруженности прибора.

# Реагенты и расходные материалы для анализаторов мочи

### Реагенты и расходные материалы для автоматического анализатора мочи cobas u 601

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 06334601001 | **cobas u pack (400 strips)**<br>Кассета с тест-полосками cobas u pack для автоматического анализатора мочи cobas u 601 | 1 x 400 шт. | |
| 06390579001 | **cobas u calibration strip, 25 pcs**<br>Калибровочные тест-полоски cobas u calibration strip, 25 шт. | 1 x 25 шт. | |
| 04537211001 | **Liquichek Urinalysis Control**<br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи» | 2 x 6 x 12 мл | |
| 03110435180 | **Deproteinizer**<br>Раствор для антисептики | 1 x 125 мл | |
| 06390544001 | **Waste box carton, 30 pcs**<br>Картонная коробка, 30 шт. | 1 x 30 шт. | |

### Реагенты и расходные материалы для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 06390552001 | **cobas u cuvette**<br>Кассета cobas u cuvette для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701 | 1 x 400 шт. | |
| 04537211001 | **Liquichek Urinalysis Control**<br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи» | 2 x 6 x 12 мл | |
| 03110435180 | **Deproteinizer**<br>Раствор для антисептики | 1 x 125 мл | |
| 06390544001 | **Waste box carton, 30 pcs**<br>Картонная коробка, 30 шт. | 1 x 30 шт. | |

### Реагенты и расходные материалы для анализатора мочи Urisys 2400

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03012557061 | **Urisys 2400 Cassette 400 Str.**<br>Кассеты Urisys 2400, 400 тест-полосок | 1 x 400 шт. | |
| 03012590061 | **Urisys 2400 Calibration Strip**<br>Калибровочные тест-полоски Urisys 2400 | 1 x 25 шт. | |
| 04880285190 | **NaOH-D cell wash solution 1 (base wash Detergent 1)**<br>Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки | 2 x 1,8 л | |
| 04537211001 | **Liquichek Urinalysis Control**<br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи» | 2 x 6 x 12 мл | |

### Реагенты и расходные материалы для анализатора мочи cobas u 411

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11379208077 | Тест-полоски **Combur 10 Test M**<br>Тест-полоски Combur 10 Test M для анализа мочи на приборах по 10 параметрам: относительная плотность, кислотность (pH), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь | 1 x 100 шт. | |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11379194263 | **Control-Test M 50 tests**<br>Тест-полоски калибровочные Control-Test M | 1 x 50 шт. | |
| 04352483001 | **Printer Paper, 5 rolls**<br>Бумага для принтера | 1 x 5 шт. | |
| 04537211001 | **Liquichek Urinalysis Control**<br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи» | 2 x 6 x 12 мл | |

### Расходные материалы для анализатора мочи Urisys 1100

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11544373191 | **Combur 10 test UX 100 tests**<br>Тест полоски «Комбур 10 тест УИкс» для анализа мочи по 10 параметрам: относительная плотность, кислотность (pH), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь | 1 x 100 шт. | |
| 11379194263 | **Control-Test M 50 tests**<br>Тест-полоски калибровочные «Контрол Тест М» | 1 x 50 шт. | |
| 04409019001 | Thermo-printer paper, 57 mm<br>Термобумага для принтера, 57 мм | 1 x 1 шт. | |
| 04537211001 | **Liquichek Urinalysis Control**<br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи» | 2 x 6 x 12 мл | |

### Расходные материалы для анализаторов мочи серии «Мидитрон» (Мидитрон М+СТ, Мидитрон Юниор)

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11379208077 | Тест-полоски **Combur 10 Test M**<br>Тест-полоски Combur 10 Test M для анализа мочи на приборах по 10 параметрам: относительная плотность, кислотность (pH), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь | 1 x 100 шт. | |
| 11379194263 | **Control-Test M 50 tests**<br>Тест-полоски калибровочные Control-Test M | 1 x 50 шт. | |
| 04537211001 | **Liquichek Urinalysis Control**<br>Материал контрольный двухуровневый Ликвичек Контроль «Общий Анализ мочи» | 2 x 6 x 12 мл | |
| 04409019001 | **Thermo-printer paper, 57 mm**<br>Термобумага для принтера, 57 мм | 1 x 1 шт. | |

### Визуальные тест-полоски

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11544039172 | **Micral Test 30**<br>Тест-полоски для иммунологического полуколичественного определения микроальбуминурии Micral-Test | 1 x 30 шт. | |

# Лабораторная экспресс-диагностика

## Биохимический экспресс-анализатор Reflotron Plus

### Расходные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 10745235001 | **Printer Ribbon**<br>Картридж для матричного принтера | 5 шт, | |
| 04409043001 | **Printer paper, 57 mm (M-57)**<br>Бумага для матричного принтера (M-57) | 1 рулон | |
| 11142577196 | **Reflotron Clean + Check**<br>Набор для чистки и контроля оптической системы прибора «Рефлотрон» | 15 контр. полосок и 16 салфеток | |

### Реагенты и контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11183893196 | **Precinorm HDL for Reflotron**<br>Контрольная плазма для «Рефлотрона» со значением по холестерину ЛПВП «Преципорм HDL холестерол» | 2x2 мл (низкий уровень); 2x2 мл (высокий уровень) | |
| 10745154196 | **Precinorm U for Reflotron**<br>Универсальная контрольная плазма «Преципорм У» для «Рефлотрона» со значениями по всем определяемым параметрам, кроме гемоглобина и холестерина ЛПВП | 4x2 мл | |
| 11200658202 | **Reflotron Amylase**<br>Тест-полоски для определения Общей Амилазы | 15 тест-полосок | |
| 11622773202 | **Reflotron Alkaline Phosphatase**<br>Тест-полоски для определения Щелочной Фосфатазы | 30 тест-полосок | |
| 10905321202 | **Reflotron Bilirubin**<br>Тест-полоски для определения Билирубина | 30 тест-полосок | |
| 10745065202 | **Reflotron Cholesterol**<br>Тест-полоски для определения Общего Холестерина | 30 тест-полосок | |
| 11126695202 | **Reflotron CK**<br>Тест-полоски для определения КФК | 15 тест-полосок | |
| 10886874202 | **Reflotron Creatinin**<br>Тест-полоски для определения Креатинина | 30 тест-полосок | |
| 10745081202 | **Reflotron GammaGT**<br>Тест-полоски для определения ГГТ | 30 тест-полосок | |
| 10744948202 | **Reflotron Glucose**<br>Тест-полоски для определения Глюкозы | 30 тест-полосок | |
| 10745120202 | **Reflotron GOT**<br>Тест-полоски для определения АСТ | 30 тест-полосок | |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 10745138202 | **Reflotron GPT**<br>Тест-полоски для определения АЛТ | 30 тест-полосок | |
| 11208756202 | **Reflotron HDL-Cholesterol**<br>Тест-полоски для определения Холестерина ЛПВП | 30 тест-полосок | |
| 11126679202 | **Reflotron Pancreas Amylase**<br>Тест-полоски для определения Панкреатической Амилазы | 15 тест-полосок | |
| 11208764202 | **Reflotron Potassium**<br>Тест-полоски для определения Калия | 30 тест-полосок | |
| 10745049202 | **Reflotron Triglycerides**<br>Тест-полоски для определения Триглицеридов | 30 тест-полосок | |
| 11200666202 | **Reflotron Urea**<br>Тест-полоски для определения Мочевины | 15 тест-полосок | |
| 10745103202 | **Reflotron Uric Acid**<br>Тест-полоски для определения Мочевой Кислоты | 30 тест-полосок | |

## Анализатор функции тромбоцитов Multiplate Analyzer

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 06675069001 | **Multiplate Analyzer**<br>Анализатор функции тромбоцитов Multiplate Analyzer с принадлежностями | 1 шт. | |
| 08884366001 | **Monitor DELL TFT 19" (1280x1024)**<br>Монитор | 1 шт. | |
| 06675344300 | **Mini Keyboard**<br>Мини-клавиатура | 1 шт. | |
| 06675492001 | **Keyboard Cover**<br>Защитное покрытие для мини-клавиатуры | 1 шт. | |
| 06675506001 | **Trolley**<br>Тележка | 1 шт. | |
| 06675174001 | **PC Mouse**<br>Мышь компьютерная | 1 шт. | Входит в состав анализатора |
| 06675204001 | **Sensor Cables, 7 pcs**<br>Кабели сенсорные, 7 шт. | 7 шт. | Входит в состав анализатора |
| 06675212001 | **Reagent Holder**<br>Держатель для реагентов | 1 шт. | Входит в состав анализатора |
| 06675239001 | **Pipette Holder**<br>Pipette Holder Держатель для пипетки | 1 шт. | Входит в состав анализатора |

# Лабораторная экспресс-диагностика

## Анализатор функции тромбоцитов Multiplate Analyzer

**Расходные материалы**

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 06675590001 | **Multiplate Test Cells**<br>Диспосистемы для измерений | 60 шт. | Для анализатора функции тромбоцитов Multiplate Analyzer |
| 06675654001 | **Pre-heating tubes, 10 pcs x 1 pack**<br>Пробирки для предварительного прогрева дилюента | 10 шт. | Входит в состав анализатора |
| 06675999190 | **Liquid Control Set**<br>Набор жидких контролей | R1: 2 x 4 мл<br>R2: 1 x 1 мл | |
| 06675948190 | **GpIIbIIIa Antagonist, 3 x 0.5 ml**<br>GpII-bIIIa-антагонист | 3 x 0,5 мл | |
| 06675905190 | **Prostaglandin E1, 3 x 1ml**<br>Простагландин | 3 x 1 мл | |
| 06675816190 | **ASPItest, 3 x 1ml**<br>Реагент для активации агрегации тромбоцитов арахидоновой кислоты | 3 x 1 мл | |
| 06675794190 | **ADPtest, 3 x 1ml**<br>Реагент для активации тромбоцитов АДФ (ADPtest) | 3 x 1 мл | |
| 06675883190 | **TRAPtest, 3 x1ml**<br>Реагент для активации рецепторов тромбина на поверхности тромбоцитов | 3 x 1 мл | |

## Экспресс-тесты для бесприборного определения Тропонина Т

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11621947196 | **Trop T sensitive (5 test incl syringes)**<br>Тест-системы для определения кардиоспецифического полипептида тропонина Т «Trop T» в венозной крови | 5 тест-полосок и 5 шприц-пипеток | вкл. шприц-пипетки для забора проб |
| 11621904193 | **Trop T sensitive (10 tests w/o syringes)**<br>Тест-системы для определения кардиоспецифического полипептида тропонина Т «Trop T» в венозной крови | 10 тест-полосок | без шприц-пипеток для забора проб |

**Расходные материалы**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11622889190 | **Roche CARDIAC Pipettes**<br>Шприц-пипетки для нанесения исследуемого материала на тест-полоску (нестерильн., негепарениз.) | 20 шт. | |

# Иммунохимический портативный экспресс-анализатор cobas h 232

## Прибор и принадлежности

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04901126190 | **cobas h 232 Kit**<br>Экспресс-анализатор иммунохимический Кобас h 232 (cobas h 232) | 1 шт. | |
| 04901142190 | **cobas h 232 Kit (scanner)**<br>Экспресс-анализатор иммунохимический Кобас h 232 (со сканером штрих-кодов) | 1 шт. | |
| 08408793190 | **Handheld Base Unit**<br>Универсальная база для питания и подключения к компьютеру | 1 шт. | Подходит также для CoaguChek Pro II |
| 05404517001 | **Printer (CMP-10) (EMEA)**<br>Принтер внешний | 1 шт. | Подходит также для CoaguChek Pro II |

## Реагенты и контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04877772190 | **Roche CARDIAC T Quantitative**<br>Тест-полоски для определения тропонина Т | 10 тест-полосок | Диапазон измерений: 50-100 нг/л (полуколичественный)<br>100-2000 нг/л (количественный) |
| 04890515190 | **Roche CARDIAC Control Troponin T**<br>Контрольный материал по тропонину Т | 1х1мл (низкий уровень); 1х1мл (высокий уровень) | |
| 07007302190 | **Roche CARDIAC POC Troponin T**<br>Тест-полоски для определения тропонина Т | 10 тест-полосок | Диапазон измерений:<br>40-2000 нг/л (количественный) |
| 07089643190 | **Roche CARDIAC POC Troponin T Control**<br>Контрольный материал по тропонину Т | 1х2мл (1 уровень) | |
| 04877799190 | **Roche CARDIAC M Myoglobin**<br>Тест-полоски для определения миоглобина | 20 тест-полосок | |
| 04890469190 | **Roche CARDIAC Control Myoglobin**<br>Контрольный материал по миоглобину | 1х1мл (низкий уровень); 1х1мл (высокий уровень) | |
| 04877802190 | **Roche CARDIAC D-Dimer**<br>Тест-полоски для определения Д-димера | 10 тест-полосок | |
| 04890523190 | **Roche CARDIAC Control D-Dimer**<br>Контрольный материал по Д-димеру | 1х1мл (низкий уровень); 1х1мл (высокий уровень) | |
| 05533643190 | **Roche CARDIAC pro BNP**<br>Тест-полоски для определения proBNP (увеличенный диапазон) | 10 тест-полосок | |
| 04890493190 | **Roche CARDIAC Control pro BNP**<br>Контрольный материал по pro BNP Кардиак | 1х1мл (низкий уровень); 1х1мл (высокий уровень) | |
| 04877900190 | **Roche CARDIAC CK-MB**<br>Тест-полоски для определения CKMB | 10 тест-полосок | |
| 04890426190 | **Roche CARDIAC Control CK-MB**<br>Контрольный материал для проверки качества тест-полосок для определения концентрации CK-MB | 1х1мл (низкий уровень); 1х1мл (высокий уровень) | |
| 04880668190 | **Roche Cardiac IQC (cobas)**<br>Контрольные тест-полоски для проверки прибора Кобас h 232 (cobas h 232) | 2 тест-полоски | |
| 11622889190 | **Roche CARDIAC Pipettes**<br>Шприц-пипетки для нанесения исследуемого материала на тест-полоску (нестерильн., негепариниз.) | 20 шт. | |

# Лабораторная экспресс-диагностика

## Профессиональная система для коагуляционного мониторинга CoaguChek Pro II

### Прибор и расходные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 07210841190 | **CoaguChek Pro II**<br>Коагулометр портативный КоагуЧек Про II | 1 шт. | |
| 08408793190 | **Handheld Base Unit**<br>Портативный базовый блок (док-станция) для передачи данных по локальной сети или по USB | 1 шт. | Подходит также для cobas h 232 |
| 05404517001 | **Printer (CMP-10) (EMEA)**<br>Принтер внешний | 1 шт. | Подходит также для cobas h 232 |
| 06688721019 | **CoaguChek PT Test, 2x24 tests**<br>Тест-полоски Коагучек PT тест, 2 x 24 шт | 48 тест-полосок | |
| 06679684190 | **CoaguChek PT Controls**<br>Материал контрольный CoaguChek PT Controls для коагулометра портативного CoaguChek Pro II | 4 флакона с лиофилизатом 1 уровня<br>4 флакона с лиофилизатом 2 уровня<br>8 дозаторов с разбавителем | |

## Профессиональная система для коагуляционного мониторинга «CoaguChek XS Plus»

### Расходные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04625315172 | **CoaguChek XS PT Test**<br>Тест-полоски КоагуЧек ИксЭс PT тест, 2 x 24 шт. | 48 тест-полосок | |
| 04696522190 | **CoaguChek XS PT Controls**<br>Материал контрольный CoaguChek XS PT Controls для коагулометра портативного CoaguChek XS Plus | 4 флакона с лиофилизатом<br>4 дозатора с разбавителем | |

## Экспресс-анализатор биохимический портативный Accutrend Plus

### Прибор и принадлежности

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05050499023 | **Accutrend Plus**<br>Экспресс-анализатор биохимический портативный Аккутренд Плюс | 1 шт. | |
| 11447475187 | **Accutrend Glucose**<br>Тест-полоски Аккутренд Глюкоза | 25 тест-полосок | Только для профессионального использования |
| 11284878190 | **Accutrend Control G**<br>Контрольный раствор Аккутренд Контроль Глюкоза | 2 x 4 мл | |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 11418262012 | **Accutrend Cholesterol (25 strips)**<br>Тест-полоски Аккутренд Холестерин | 25 тест-полосок | |
| 11418289190 | **Accutrend Control CH 1**<br>Контрольный раствор Аккутренд Контроль Холестерин | 1 x 1,5 мл | |
| 11538144016 | **Accutrend Triglycerides**<br>Тест-полоски Аккутренд Триглицериды | 25 тест-полосок | |
| 11538152190 | **Accutrend Control TG 1**<br>Контрольный раствор Аккутренд Контроль Триглицериды | 2 x 4 мл | |
| 03012654016 | **BM-Lactate**<br>Тест-полоски БМ-Лактат для количественного определения уровня лактата в капиллярной крови | 25 тест-полосок | |
| 11447335190 | **BM-Control-Lactate**<br>Контрольный материал для проведения проверки работы тест-полосок БМ Лактат | 2 x 4 мл (низкий уровень); 2 x 4 мл (высокий уровень) | |

## Система для анализа госпитальной глюкозы Accu-Chek Inform II

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05060303001 | **Accu-Chek Inform II Meter Kit + RF**<br>Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для контроля уровня глюкозы крови Акку-Чек Информ II с функцией беспроводного подключения | 1 шт | |
| 04884671001 | **Accu-Chek Inform II Code Key Reader**<br>Считыватель кода для Акку-Чек Информ II | 1 шт | |
| 05060281001 | **Accu-Chek Inform II Accessory Box**<br>Контейнер для хранения Акку-Чек Информ II и принадлежностей | 1 шт | |
| 07671717190 | **Accu-Chek Inform II Base Unit Kit**<br>Базовый модуль для подключения Акку-Чек Информ II к лабораторной информационной системе и зарядки устройства | 1 шт | |
| 08376824190 | **Accu-Chek Inform II Base Unit Light**<br>Базовый модуль упрощенный для зарядки устройства | 1 шт | |
| 08692432001 | **Handheld Power Supply FW8001M/12,12V**<br>Блок питания | 1 шт | |

### Реагенты и контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05942861044 | **ACCU-CHEK INFORM II EU2**<br>Тест-полоски Акку-Чек Информ II, 50 шт. | 50 тест-полосок | |

# Анализаторы газов крови и электролитов

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03274799001 | **AIR FILTER cobas b 221**<br>Воздушный фильтр | 4 штуки | |
| 03309754001 | **Fill port cobas b 221**<br>Входной порт | 1 штука | |
| 03086879001 | **THB Cuvette**<br>Кювета для измерения гемоглобина | 1 штука | Замена проводится сервисным инженером |

## Анализаторы критических состояний cobas b 123

### Приборы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05122244001 | **cobas b 123 < 1 > POC system**<br>Анализатор критических состояний cobas b 123, вариант исполнения 1 | 1 штука | Без COOX модуля и МАКК |
| 05122252001 | **cobas b 123 < 2 > POC system**<br>Анализатор критических состояний cobas b 123, вариант исполнения 2 | 1 штука | С МАКК, без COOX модуля |
| 05122279001 | **cobas b 123 < 3 > POC system**<br>Анализатор критических состояний cobas b 123, вариант исполнения 3 | 1 штука | С COOX модулем, без МАКК |
| 05122287001 | **cobas b 123 < 4 > POC system**<br>Анализатор критических состояний cobas b 123, вариант исполнения 4 | 1 штука | С МАКК и COOX модулем |
| 05414555001 | **CART cobas b 123 POC system**<br>Тележка для анализатора cobas b 123 | 1 штука | |

### Реагенты, расходные и контрольные материалы к анализаторам cobas b 123

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05170460001 | **cobas b 123 SENSOR CART. BG/ISE**<br>Картридж сенсорный, BG/ISE | 1 штука | |
| 05170478001 | **cobas b 123 SENSOR CART. BG/ISE/GLU/LAC**<br>Картридж сенсорный, BG/ISE/GLU/Lac | 1 штука | |
| 05403308001 | **cobas b 123 FLUID PACK 200**<br>Контейнер реагентный, 200 тестов | 1 штука | Для версий 1 и 2 |
| 05403154001 | **cobas b 123 FLUID PACK 400**<br>Контейнер реагентный, 400 тестов | 1 штука | Для версий 1 и 2 |
| 05403286001 | **cobas b 123 FLUID PACK 700**<br>Контейнер реагентный, 700 тестов | 1 штука | Для версий 1 и 2 |
| 05169992001 | **cobas b 123 FLUID PACK COOX 200**<br>Контейнер реагентный COOX, 200 тестов | 1 штука | Для версий 3 и 4 |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05170036001 | **cobas b 123 FLUID PACK COOX 400**<br>Контейнер реагентный COOX 400 тестов | 1 штука | для версий 3 и 4 |
| 05170052001 | **cobas b 123 FLUID PACK COOX 700**<br>Контейнер реагентный COOX, 700 тестов | 1 штука | для версий 3 и 4 |
| 05169933001 | **cobas b 123 AUTOQC PACK, TRI-LEVEL**<br>Кассета автоматического контроля качества, три уровня, 24 шт. | 24 ампулы<br>(8 ампул по 3-м уровням по 1.0 мл каждая) | для версий 2 и 4 |
| 03321193001 | **COMBITROL PLUS B, LEVEL 1 (COOX)**<br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 1 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая | |
| 03321207001 | **COMBITROL PLUS B, LEVEL 2 (COOX)**<br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 2 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая | |
| 03321215001 | **COMBITROL PLUS B, LEVEL 3 (COOX)**<br>Контрольный материал Комбитрол Плюс Б, уровень 3 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая | |
| 05082595001 | **cobas b 123 PRINTER PAPER**<br>Бумага принтера cobas b 123 | | |

## Реагенты и контрольные материалы к анализаторам cobas b 121, OMNI C

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03144046001 | **Calibration Solution C1**<br>Калибровочный раствор Си 1 | 1 контейнер | |
| 03144020001 | **Calibration Solution C2**<br>Калибровочный раствор Си 2 | 1 контейнер | |
| 03144038001 | **Fluid Pack C3**<br>Контейнер с реагентами Си 3 | 1 контейнер | |
| 03321258001 | **COMBITROL TS+, LEVEL 1**<br>Контрольный материал Комбитрол ТС+, уровень 1 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая | |
| 03321266001 | **COMBITROL TS+, LEVEL 2**<br>Контрольный материал Комбитрол ТС+, уровень 2 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая | |
| 03321274001 | **COMBITROL TS+, LEVEL 3**<br>Контрольный материал Комбитрол ТС+, уровень 3 (30x1.7мл) | 30 ампул<br>по 1,7 мл каждая | |
| 03321223001 | **AUTO-TROL TS+, LEVEL 1**<br>Контрольный материал АВТО-трол ТС+, уровень 1 (40x1.7мл) | 40 ампул<br>по 1,7 мл каждая | Для МАКК |

# Анализаторы газов крови и электролитов

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03321231001 | **AUTO-TROL TS+, LEVEL 2**<br>Контрольный материал АВТО-трол ТС+, уровень 2 (40x1.7мл) | 40 ампул<br>по 1,7 мл каждая | Для МАКК |
| 03321240001 | **AUTO-TROL TS+, LEVEL 3**<br>Контрольный материал АВТО-трол ТС+, уровень 3 (40x1.7мл) | 40 ампул<br>по 1,7 мл каждая | Для МАКК |

**Расходные материалы и принадлежности к анализаторам cobas b 121, OMNI C**

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03111598180 | **Electrode Sodium (Na+)**<br>Натриевый микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111628180 | **Potassium Electrode (K+)**<br>Калиевый микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111644180 | **Calcium Electrode (Ca++)**<br>Кальциевый микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111571180 | **AVL Micro Electrode - Cl-**<br>Хлорный микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111679180 | **PCO2 Electrode**<br>pCO2-микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111695180 | **PO2 Electrode**<br>pO2-микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111717180 | **pH Electrode**<br>pH-микроэлектрод | 1 штука | |
| 03111873180 | **Ref. Electrode**<br>Референсный микроэлектрод | 1 штука | |
| 03144062001 | **MCON OMNI C**<br>Соединительный контакт M | 1 штука | |
| 03111849035 | **Electrode Dummy**<br>Микроэлектрод-заглушка | 1 штука | |
| 03144054001 | **W Waste Container**<br>Контейнер для отходов | 2 штуки | |
| 03026434001 | **FILL PORT OMNI C**<br>Пробозаборник в комплекте (cobas b 121) | 1 комплект | |
| 03056295001 | **PUMP TUBE OMNI C**<br>Набор трубок для перистальтического насоса (cobas b 121) | 1 комплект | |
| 03112098035 | **CLEANING KIT FOR CL-ELECTRODE**<br>Набор для чистки хлорного электрода | 1 штука | |

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03110435180 | **Deproteinizer**<br>Раствор для антисептики | 1 флакон<br>емкость 125 мл | |
| 03113353180 | **PAPER ROLL f. printer STP211-144 (10pcs)**<br>Бумага для принтера stp211-144 (Компакт) | 10 роликов | |

## Анализаторы электролитов серии 91XX

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03157334001 | **Electrolyte Analyzer**<br>Анализатор электролитов 9180 | 1 комплект | |

### Реагенты и контрольные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03112349180 | **Snap Pack (9180, 9181)**<br>Контейнер с реагентами СнэпПак (9180, 9181) | 1 штука | |
| 03110362180 | **Sodium Electrode Conditioner**<br>Кондиционер натриевого электрода | 125 мл | |
| 03111555180 | **Cleaning Solution (for electrolyte systems)**<br>Чистящий раствор для анализаторов электролитов | 125 мл | |
| 03112888180 | **ISETROL, level 1, 2, 3**<br>Материал контрольный ISE-трол, уровень 1, 2, 3 | 3 уровня по 10 ампул по 1.0 мл каждая | |

### Расходные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03110338180 | **Potassium Electrode, maintenance free**<br>Электрод калиевый, необслуживаемый | 1 штука | |
| 03110354180 | **Calcium Electrode, maintenance free**<br>Электрод кальцивый, необслуживаемый | 1 штука | |
| 03110419180 | **Sodium Electrode, maintenance free**<br>Электрод натриевый, необслуживаемый | 1 штука | |
| 03110451180 | **Chloride Electrode, maintenance free**<br>Электрод хлорный, необслуживаемый | 1 штука | |
| 03110664180 | **Lithium Electrode, maintenance free**<br>Электрод литиевый, необслуживаемый | 1 штука | |
| 03112284180 | **Reference Electrode Housing for AVL 91xx instruments**<br>Мембранна референсная для AVL 91xx | 1 штука | |
| 03112306180 | **Reference Electrode (for AVL 91XX instruments)**<br>Референсный электрод (91xx) | 1 штука | |

# Анализаторы газов крови и электролитов

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03110192035 | **DUMMY ELECTRODES COMPLETE (1 PC)**<br>Электрод-заглушка для 9180 | 1 штука | |
| 03110249180 | **Urine Diluent**<br>Разбавитель мочи | 1 флакон<br>емкость 500 мл | |
| 03112292018 | **Printer paper for AVL 9100/9110**<br>Термобумага для анализаторов электролитов (91xx) | 5 роликов | |
| 03087697001 | **TUBE SET, PERISTALTIC PUMP, EA**<br>Набор трубок (Трубки перестальтического насос) | 1 комплект | |

## Системы взятия крови для анализа электролитов и газов крови

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 03112101180 | **Adapters for Sample Containers**<br>Адаптеры для пробирки с образцом | 150 штук | Для проведения ручного контроля качества (взятие образца из ампул) или для взятия образца из пробирки |
| 05772583001 | **Roche MICROSAMPLER PROTECT STERILE**<br>Микросэмплер гепаринизированный (с иглой, стерильн.) | 50 штук | Для взятия артериальной крови |
| 05772494001 | **Roche MICROSAMPLER PROTECT NON-STERILE**<br>Микросэмплер гепаринизированный (с иглой, не стерильн.) | 200 штук | Для взятия артериальной крови |
| 03112152180 | **CAPS FOR ROCHE MICROSAMPLER**<br>Заглушки для микросэмплеров | 300 штук | Для взятия артериальной крови |
| 03113507035 | **Glass Capillary Tubes, min. 115 µL**<br>Стеклянные капилляры (115мкл) (4 x 250 шт.) | 4 тубуса<br>по 250 штук | |
| 03113477180 | **Glass Capillary Tubes, min. 200 µL**<br>Стеклянные капилляры, 200 мкл ( 4 x 250 шт.) | 4 тубуса<br>по 250 штук | |
| 03112012180 | **Clot Catcher, disposable**<br>Уловитель сгустков (одноразовый) | 250 штук | |
| 05689856001 | **Clot Catcher PRO**<br>Уловитель сгустков PRO (одноразовый) | 100 штук | |
| 03113493035 | **BS2 Blood Sampler, 2 ml**<br>Шприцы гепаринизированные BS2 производства Roche, 2 мл (20 x 50 шт.) | 20 блистеров<br>по 50 штук | Для взятия венозной и артериальной крови. Без иглы |

# Решения для самомониторинга

## Коагулометр портативный КоагуЧек ИксЭс (CoaguChek XS)

### Прибор и расходные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 04625412019 | **CoaguChek XS**<br>Набор для мониторинга лечения оральными антикоагулянтами: Коагулометр портативный КоагуЧек ИксЭс / Устройство для прокалывания пальца КоагуЧек Софткликс / Ланцеты КоагуЧек Софткликс XL для прокалывания пальца | 1 шт. / 1 шт. / 20 шт. | |
| 04625358172 | **CoaguChek XS PT Test, 24 tests**<br>Тест-полоски «КоагуЧек ИксЭс PT тест, 24 шт. | 24 тест-полоски<br>один кодовый чип | |
| 03506509001 | **CoaguChek Softclix Lancet XL, 50**<br>Ланцеты КоагуЧек Софткликс XL, 50 шт. одноразовые, стерильные | 50 ланцетов | |

## Экспресс-анализатор биохимический портативный Accutrend Plus

### Прибор и расходные материалы

| Арт.№ | Наименование | Фасовка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05050499023 | **Accutrend Plus**<br>Экспресс-анализатор биохимический портативный Аккутренд Плюс | 1 шт. | |
| 11418254223 | **Accutrend Cholesterol (5 strips)**<br>Тест-полоски Аккутренд Холестерин | 5 тест-полосок | |
| 11418289190 | **Accutrend Control CH 1**<br>Контрольный раствор Аккутренд Контроль Холестерин | 1 x 1,5 мл | |
| 11538144016 | **Accutrend Triglycerides**<br>Тест-полоски Аккутренд Триглицериды | 25 тест-полосок | |
| 11538152190 | **Accutrend Control TG 1**<br>Контрольный раствор Аккутренд Контроль Триглицериды | 2 x 4 мл | |
| 03012654016 | **BM-Lactate**<br>Тест-полоски БМ-Лактат для количественного определения уровня лактата в капиллярной крови | 25 тест-полосок | |
| 11447335190 | **BM-Control-Lactate**<br>Контрольный материал для проведения проверки работы тест-полосок БМ-Лактат | 2 x 4 мл (низкий уровень); 2 x 4 мл (высокий уровень) | |

# Заметки